

METTLER TOLEDO



# 目录

<b>1</b>	<b>简介</b>	<b>7</b>
1.1	更多文档和信息	7
1.2	所用约定与符号说明	7
1.3	缩略语	8
1.4	产品系列	9
1.4.1	XPR26PC天平	9
1.5	合规性信息	9
<b>2</b>	<b>安全须知</b>	<b>10</b>
2.1	警示语与警告标志的定义	10
2.2	特定产品的安全信息	10
<b>3</b>	<b>设计和功能</b>	<b>12</b>
3.1	功能说明	12
3.2	天平概述	13
3.3	组件说明	13
3.3.1	移液容器	13
3.3.2	盛水盘	14
3.3.3	防蒸发阱	14
3.3.4	光栅板	14
3.3.5	水平调节脚	14
3.3.6	显示终端	15
3.4	显示操作终端概述	15
3.5	产品铭牌概述	16
3.6	用户界面	16
3.6.1	主界面概述	16
3.6.2	主称重屏幕	17
3.6.3	面板“天平菜单”	18
3.6.4	面板“方法”	18
3.6.5	面板“结果”	19
3.6.6	图标和符号	20
3.6.6.1	系统状态图标	20
3.6.6.2	称重状态图标	20
3.6.6.3	过程状态图标	21
<b>4</b>	<b>安装并投入使用</b>	<b>22</b>
4.1	选择位置	22
4.2	开箱取出天平	22
4.3	交货清单	24
4.3.1	天平	24
4.3.2	文档记录	24
4.3.3	校准套件	24
4.4	安装	25
4.4.1	连接显示终端	25
4.4.2	组装天平	26
4.5	使用天平	27

4.5.1	连接天平 .....	27
4.5.2	打开天平 .....	28
4.5.3	登录 .....	28
4.5.4	调节天平水平 .....	29
4.5.5	进行内部校正 .....	29
4.5.6	执行功能检查 .....	29
4.5.6.1	使用小号秤盘 .....	30
4.5.6.2	使用大号秤盘 .....	30
4.5.7	进入 / 退出待机模式 .....	30
4.5.8	关闭天平 .....	31
4.6	执行移液循环 .....	31
4.6.1	填充防蒸发阱容器 .....	31
4.6.2	天平归零 .....	32
4.6.3	去皮 .....	32
4.6.4	执行移液循环循环 .....	32
4.6.5	完成称量 .....	32
4.6.6	清空移液容器 .....	32
4.7	运输、包装和存储 .....	33
4.7.1	短距离运输天平 .....	33
4.7.2	远距离运输天平 .....	33
4.7.3	包装和存储 .....	33
<hr/>		
<b>5</b>	<b>操作</b> .....	<b>34</b>
5.1	触控式屏幕 .....	34
5.1.1	选择或激活条目 .....	34
5.1.2	滚动 .....	34
5.1.3	使用飞入式面板 .....	34
5.1.4	输入字符和数字 .....	35
5.1.5	修改日期和时间 .....	35
5.2	方法 .....	36
5.2.1	方法概述 .....	36
5.2.2	方法"一般称重" .....	36
5.2.2.1	创建方法"一般称重" .....	37
5.2.2.2	执行"一般称重" .....	38
5.2.3	编辑方法 .....	38
5.2.4	复制方法 .....	39
5.2.5	删除方法 .....	39
5.2.6	删除任务 .....	39
5.2.7	使用多个称量品方法（逐项排列） .....	40
5.2.7.1	创建多个称量品的全新方法（逐项排列） .....	40
5.2.7.2	从已完成任务中创建逐项排列方法 .....	40
5.2.7.3	执行逐项排列方法 .....	40
5.3	测试砝码 .....	41
5.3.1	定义单个校验砝码 .....	41
5.3.2	定义组合砝码测试 .....	41
5.4	测试 .....	41
5.4.1	日常测试概述 .....	42
5.4.1.1	重复性测试 .....	42

5.4.1.2	灵敏度测试 .....	42
5.4.2	创建一个新测试 .....	42
5.4.3	准备天平以执行测试 .....	43
5.4.3.1	准备天平 .....	43
5.4.3.2	安装小号秤盘 .....	43
5.4.3.3	安装大号秤盘 .....	44
5.4.4	执行测试 .....	45
5.4.4.1	执行"重复性测试" .....	45
5.4.4.2	执行"灵敏度测试" .....	46
5.4.5	编辑测试 .....	48
5.4.6	打印测试结果 .....	48
5.4.7	删除测试 .....	48
5.4.8	查询测试历史记录 .....	48
5.5	校正 .....	49
5.5.1	内部校正 .....	49
5.5.1.1	编辑"内部校正" .....	49
5.5.1.2	执行"内部校正" .....	49
5.5.2	外部校正 .....	49
5.5.2.1	编辑"外部校正" .....	49
5.5.2.2	执行"外部校正" .....	50
5.5.3	查询校正历史记录 .....	51
5.6	外围设备 .....	51
5.6.1	打印机 .....	51
5.6.1.1	通过USB在纸带打印机上手动打印结果 .....	51
5.6.1.2	通过蓝牙在标签打印机上自动打印结果 .....	52
5.6.2	RFID阅读器 .....	55
5.6.2.1	使用EasyScan USB从RFID智能芯片读取数据 .....	55
5.6.2.2	使用EasyScan格式化RFID智能芯片 .....	56
5.6.3	脚踏开关和ErgoSens .....	56
5.6.3.1	使用ErgoSens对天平执行去皮功能 .....	57
5.6.4	编辑设备设置 .....	57
5.6.5	删除设备 .....	57
5.7	通过服务进行远程控制 .....	58
5.7.1	LabX服务 .....	58
5.7.1.1	通过USB连接使用LabX .....	58
5.7.1.2	通过以太网连接使用LabX .....	58
5.7.2	MT-SICS服务 .....	59
5.7.2.1	通过USB连接使用MT-SICS .....	59
5.7.2.2	通过以太网连接使用MT-SICS .....	60
5.7.3	Web服务 .....	61
5.8	数据管理 .....	62
5.8.1	导出结果 .....	62
5.8.2	将单个结果发送至计算机 .....	63
5.8.3	导出和导入设置 .....	64
5.8.3.1	在天平之间传输测试砝码设置 .....	65
5.9	用户管理 .....	66
5.9.1	激活用户管理 .....	66
5.9.2	禁用用户管理 .....	66

5.9.3	管理用户和用户组.....	66
5.9.3.1	创建新用户.....	67
5.9.3.2	创建新组.....	67
5.9.3.3	删除用户或用户组.....	67
5.10	允差配置文件.....	68
5.11	密码保护和天平重置.....	68
5.11.1	密码保护.....	68
5.11.1.1	更改密码.....	68
5.11.1.2	申请重置密码.....	69
5.11.1.3	创建解锁密码.....	69
5.11.2	登录和退出.....	69
5.11.2.1	登录.....	69
5.11.2.2	退出.....	69
5.11.3	锁定和解锁天平.....	70
5.11.3.1	锁定天平.....	70
5.11.3.2	解锁天平.....	70
5.11.4	重置天平.....	70
5.12	自动加样.....	71
5.12.1	管理加样头数据.....	71
5.12.2	更改泵压力.....	72

<b>6</b>	<b>软件描述</b>	<b>73</b>
6.1	天平菜单设置.....	73
6.1.1	水平调节向导.....	73
6.1.2	历史.....	73
6.1.2.1	校正.....	73
6.1.2.2	测试.....	74
6.1.2.3	服务.....	74
6.1.2.4	变更.....	74
6.1.3	天平信息.....	75
6.1.4	用户.....	75
6.1.4.1	常规.....	76
6.1.4.2	用户.....	76
6.1.4.3	组.....	76
6.1.5	设置.....	78
6.1.5.1	天平.....	78
6.1.5.2	模块/加样.....	84
6.1.5.3	接口.....	85
6.1.5.4	设备/打印机.....	86
6.1.5.5	LabX/服务.....	88
6.1.5.6	打印设置.....	88
6.1.6	维护.....	89
6.1.6.1	服务菜单.....	89
6.2	称量方法设置.....	90
6.2.1	设置：方法"一般称重".....	90
6.2.1.1	常规.....	90
6.2.1.2	ID格式.....	91
6.2.1.3	称量.....	92

6.2.1.4	称量品 / 称量品 .....	93
6.2.1.5	自动化 .....	94
6.2.1.6	打印/导出 .....	96
6.3	测试砝码设置 .....	100
6.3.1	设置: 单个校验砝码 .....	100
6.3.2	设置: 组合测试砝码 .....	100
6.4	测试设置 .....	101
6.4.1	设置: 重复性测试 .....	101
6.4.2	设置: 灵敏度测试 .....	104
6.5	校正设置 .....	107
<b>7</b>	<b>维护</b> .....	<b>110</b>
7.1	维护任务 .....	110
7.2	清空容器 .....	111
7.2.1	组装泵 .....	111
7.2.2	清空移液容器 .....	111
7.2.3	情况防蒸发阱容器 .....	112
7.3	清洁 .....	113
7.3.1	拆卸进行清洁 .....	113
7.3.2	清洗剂 .....	114
7.3.3	清洁天平 .....	115
7.3.4	溢出后清洁 .....	115
7.3.5	清洁后投入使用 .....	116
7.4	服务 .....	116
7.5	软件升级 .....	116
7.5.1	更新软件 .....	116
7.5.2	将软件恢复至以前版本 .....	117
7.5.3	软件更新后投入使用 .....	117
<b>8</b>	<b>故障排除</b> .....	<b>118</b>
8.1	错误信息 .....	118
8.2	出错现象 .....	118
8.3	修复错误后投入使用 .....	120
<b>9</b>	<b>技术参数</b> .....	<b>121</b>
9.1	通用数据 .....	121
9.2	关于梅特勒-托利多交流/直流适配器附注 .....	122
9.3	型号——技术参数 .....	123
9.4	外形尺寸 .....	124
<b>10</b>	<b>丢弃</b> .....	<b>125</b>
<b>11</b>	<b>配件和备件</b> .....	<b>126</b>
11.1	附件 .....	126
11.2	备件 .....	131
11.2.1	天平 .....	131
11.2.2	泵 .....	132
11.2.3	杂项 .....	133
11.2.4	包装 .....	134

---

<b>12</b>	<b>附录</b>	<b>135</b>
12.1	已审批天平.....	135
12.1.1	定义.....	135
12.1.2	描述性标记.....	135
12.1.3	归零和去皮限制.....	135
12.1.4	出厂方法: General Weighing.....	135
12.1.5	称量结果表示.....	136
12.1.6	MT-SICS.....	137
12.1.7	参考文献.....	137
	<b>索引</b>	<b>139</b>

---

# 1 简介

感谢您选择METTLER TOLEDO天平。这款天平具有优质性能且易于使用。  
本文档基于软件版本V 2.0.501。

## EULA

本产品中的软件按照METTLER TOLEDO软件的最终用户许可证协议（EULA）获得授权。  
使用本产品表明您同意EULA的条款。

▶ [www.mt.com/EULA](http://www.mt.com/EULA)

## 1.1 更多文档和信息

公司网站提供本文档的其他语言版本。

▶ [www.mt.com/XPR26PC-RM](http://www.mt.com/XPR26PC-RM)

产品页：

▶ [www.mt.com/pipcal](http://www.mt.com/pipcal)

天平清洁说明，“8 Steps to a Clean Balance”：

▶ [www.mt.com/lab-cleaning-guide](http://www.mt.com/lab-cleaning-guide)

搜索软件：

▶ [www.mt.com/labweighing-software-download](http://www.mt.com/labweighing-software-download)

搜索文档：

▶ [www.mt.com/library](http://www.mt.com/library)

如有更多疑问，请与您的授权 METTLER TOLEDO 经销商或服务代表联系。

▶ [www.mt.com/contact](http://www.mt.com/contact)

## 1.2 所用约定与符号说明

### 约定和符号

按键和/或按钮名称和显示文本以图形或者加粗文本形式表示（例如：**编辑**）。

 **信息** 用于关于产品的有用信息。



请参阅外部文档。

### 说明书元素

在本手册中，分步说明如下所示。操作步骤已编号，可包含先决条件、中间结果和结果，如示例中所示。少于两个步骤的序列不编号。

■ 先决条件是指执行单个步骤之前必须满足的条件。

1 步骤 1

➔ 中间结果

2 步骤 2

➔ 结果

### 1.3 缩略语

原文	译文	说明
AC		Alternating Current (交流电)
ASTM		American Society for Testing and Materials (美国试验与材料协会)
DC		Direct Current (直流电)
EMC		Electromagnetic Compatibility (电磁兼容)
FCC		Federal Communications Commission (美国联邦通讯委员会)
GWP		Good Weighing Practice
HID		Human Interaction Device (人机交互设备)
ID		Identification (标识)
LED		Light-Emitting Diode (发光二极管)
LPS		Limited Power Source (限功率电源)
MAC		Media Access Control (媒介访问控制)
MT-SICS		METTLER TOLEDO Standard Interface Command Set (METTLER TOLEDO标准接口命令集)
NA		Not Applicable (不适用)
OIML		Organisation Internationale de Métrologie Légale (国际法制计量组织)
RAM		Random Access Memory (随机存取存储器)
RFID		Radio-frequency identification (射频识别)
RM		Reference Manual (参考手册)
SELV		Safety Extra Low Voltage (额定安全低电压)
SOP		Standard Operating Procedure (标准操作程序)

SQC	Statistical Quality Control (统计质量控制)
UM	User Manual (简明用户手册)
USB	Universal Serial Bus
USP	United States Pharmacopeia (美国药典)

## 1.4 产品系列

### 1.4.1 XPR26PC天平

天平	型号说明
	可读性: <b>0.001 mg</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>XPR26PC</li> </ul>

## 1.5 合规性信息

国家审批文档，例如FCC供应商一致性声明，可在线获取和/或包含在包装中。

▶ [www.mt.com/ComplianceSearch](http://www.mt.com/ComplianceSearch)

如有关于针对特定国家的仪器合规性问题，请联系METTLER TOLEDO。

▶ [www.mt.com/contact](http://www.mt.com/contact)

## 2 安全须知

本仪器随附《用户手册》和《参考手册》两个文档。

- 《用户手册》随本仪器打印并交付。
- 电子版《参考手册》包含本仪器及其使用的全面描述。
- 请妥善保管上述两份手册，以供将来参考。
- 将本仪器传递给其他方时应附上两个文档。

必须按照《用户手册》和《参考手册》使用本仪器。如果不按照这些文档说明使用本仪器，或者如果本仪器已改动，那么仪器的安全性就有可能受到损坏，Mettler-Toledo GmbH 我们对此将不承担任何责任。

### 2.1 警示语与警告标志的定义

安全说明中包含关于安全问题的重要信息。忽视安全说明有可能造成人员受伤、仪器损坏、故障与结果错误。安全说明标注有下列警示语与警告标志：

#### 警示语

<b>危险</b>	存在高风险的危险情况，如不加以避免，则会导致死亡或严重伤害。
<b>警告</b>	中等风险性危险情况，如不加以避免，可能会造成死亡或严重伤害。
<b>小心</b>	风险性较低的危险情况，如不规避会造成轻微或中度受伤。
<b>注意</b>	存在低风险的危险情况，有可能损坏仪器和导致其他实质性损坏、故障、错误结果或数据丢失。

#### 警告标志



一般风险



注意

### 2.2 特定产品的安全信息

#### 目标用途

本仪器供经培训人员使用。该仪器专为称量而设计。

未经 Mettler-Toledo GmbH 许可，超过 Mettler-Toledo GmbH 规定限制的任何其他类型的使用和操作均视为非目标用途。

#### 仪器所有者的责任

仪器所有者指对仪器具有合法所有权、使用仪器或授权任何人使用仪器，或者在法律上认定为仪器操作人员的个人。仪器所有者负责仪器所有使用者与第三方的安全。

Mettler-Toledo GmbH 假定仪器所有者对用户进行培训，使其了解如何在工作场所安全使用仪器和处理潜在危险。Mettler-Toledo GmbH 假定仪器所有者提供必要的防护装备。



### 警告

#### 触电会造成重伤或死亡

接触带电零件有可能造成伤亡。

- 1 仅使用仪器专用METTLER TOLEDO电源线和交流/直流适配器。
- 2 将电源线连接至接地电源插座。
- 3 将所有电缆与接头放置在远离液体和潮湿的地方。
- 4 检查电缆与电源插头有无损坏，如有损坏请更换。



### 注意

#### 因使用不合适的部件而损坏仪器或发生故障

- 仅可使用METTLER TOLEDO提供的专用于您的仪器的部件。

## 3 设计和功能

### 3.1 功能说明


XPR系列天平包含多个规格天平，它们的称量范围和分辨率各有不同。XPR系列天平具有多种称量和校正功能，操作非常方便。

XPR26PC天平具有以下特点：

- 通过内部砝码进行全自动调整。
- 内置水平传感器和水平调节辅助装置便于快速简易水平调节
- 7英寸电容式彩色TFT触控式屏幕
- 多种个性化方法的设置
- 多种个性化日常测试的设置
- 管理用户组及用户权限的功能
- 关于已执行的测试、调整以及天平设置更改的历史记录
- 马达驱动防蒸发阱门
- 易于拆卸的防蒸发阱
- 用于无接触操作防蒸发阱门的光栅

XPR26PC天平经过精心设计，专门与面向METTLER TOLEDO仪器优化的移液器校准软件Calibry配合使用，请参[附件 ▶ 第129页]。Calibry可以全自动地操作XPR26PC天平，并能够根据ISO8655标准、制造商允差或客户SOP，轻松、快速的检测单通道及多通道移液器。该软件可指导您逐步完成校准过程并生成报告。

## 3.2 天平概述

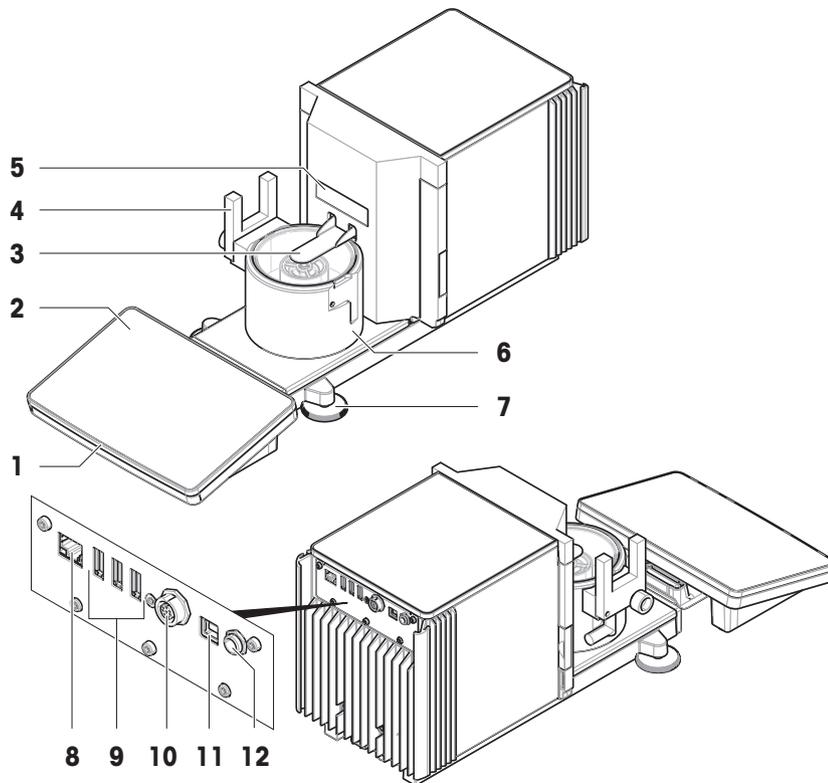


1	StatusLight	7	水平调节脚
2	显示操作终端	8	以太网端口
3	防蒸发阱门	9	USB-A端口（接设备）
4	挡光板	10	显示操作终端连接线插座
5	型号标签	11	USB-B端口（接主机）
6	移液底座	12	交流/直流适配器插座

## 3.3 组件说明


### 3.3.1 移液容器

移液容器是将水移液到其中的承载器。

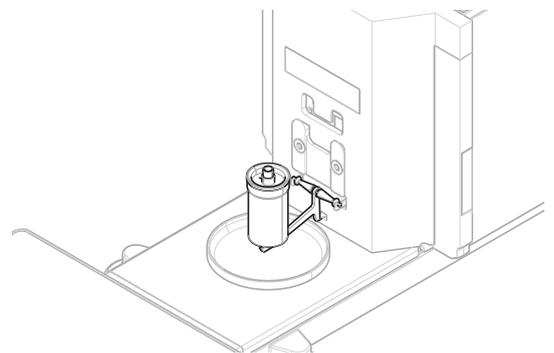


### 3.3.2 盛水盘

盛水盘位于移液容器下方，称量装置底板的上方。盛水的主要作用是确保快速清洁天平。

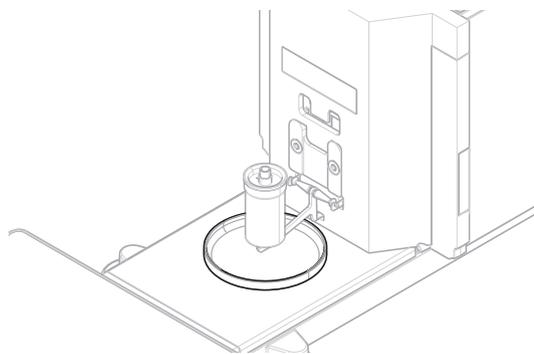


### 3.3.3 防蒸发阱

防蒸发阱包括一个装满水的容器。防蒸发阱关闭时，内部湿度增加，直至空气饱和。这可防止移液容器内的液体蒸发，确保准确的称量结果。

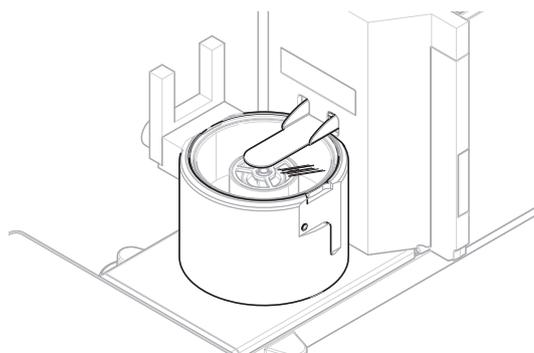


### 3.3.4 光栅板

光栅板连接在移液底座的左侧或右侧。当光栅板被激活时，防蒸发阱门打开或关闭。

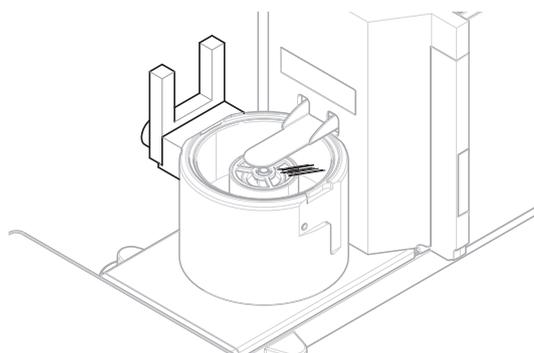


### 3.3.5 水平调节脚

天平具有两个可调节高度的支脚。这些支脚用于调节天平水平。

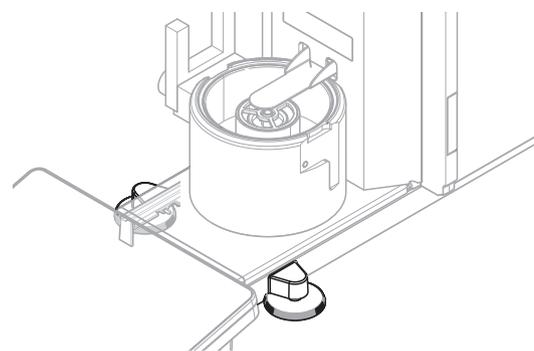


### 3.3.6 显示终端

7英寸天平终端配备触摸显示屏。此外，显示终端前侧为一个StatusLightLED灯带，用于指示天平的当前状态。

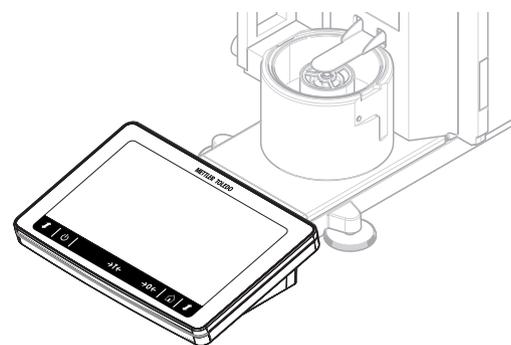

### 3.4 显示操作终端概述

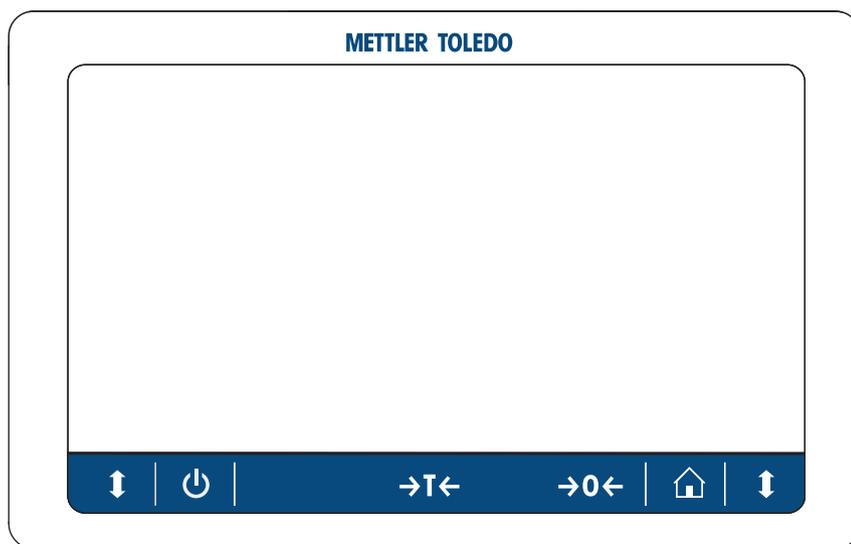


	名称	描述
	待机	通过点按，天平不会完全处于关闭状态，但可以进入待机模式。如果要完全关闭天平，则必须断开电源。 <b>信息</b> 除非长时间不使用天平，否则请勿断开天平与电源。开启仪器后，必须先进行预热，才能获得准确的结果。
	去皮	天平去皮重。 此功能用于后续测量之间。在对天平去皮之后，屏幕将显示Net，其表示所有显示的称量值均为净值。
	归零	天平置零。 在开始称量过程前，天平必须归零。在归零之后，天平将设置新的零点。
	主页	从任何菜单级返回称量主界面。
	开门/关门	打开/关闭防蒸发阱门。

### 3.5 产品铭牌概述


产品铭牌上的信息有助于识别天平和终端。

#### 终端产品铭牌



1. 显示终端类型
2. 显示终端序列号

#### 天平产品铭牌

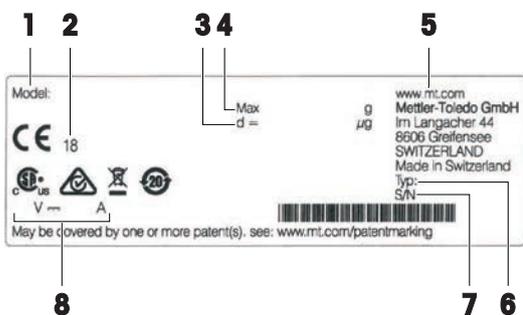


1. 天平型号
2. 生产年份
3. 可读性
4. 最大称量
5. 制造商
6. 天平类型
7. 天平序列号
8. 功耗

### 3.6 用户界面

#### 3.6.1 主界面概述

称量主界面 (1) 是中心导航点，此处可以看到所有菜单和设置。点击称量主界面两侧的选项卡时将打开天平菜单 (2)、方法 (3) 和结果 (4)。

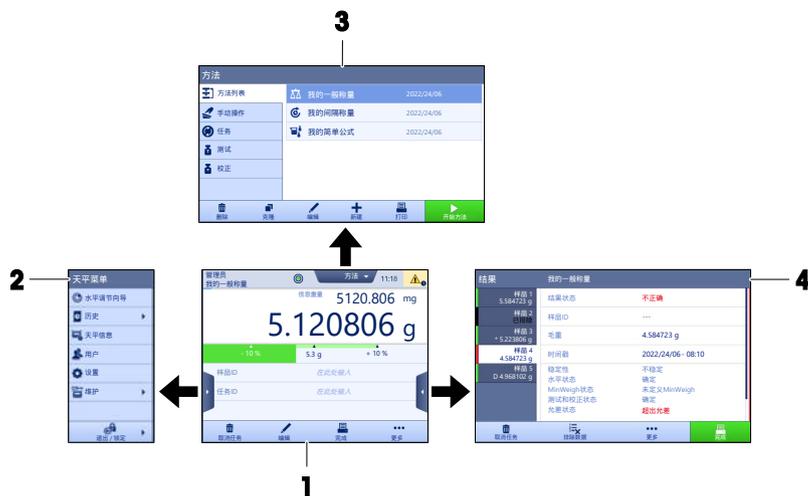

#### 可参阅

- 🔗 主称重屏幕 ▶ 第17页
- 🔗 面板“天平菜单” ▶ 第18页
- 🔗 面板“方法” ▶ 第18页
- 🔗 面板“结果” ▶ 第19页

### 3.6.2 主称重屏幕



名称	描述
1 用户名	显示当前用户的名称。
2 称量值字段	显示当前称量值。
3 水平指示器	表明天平是否调平（绿色表示调平，红色表示未调平）。
4 方法菜单	访问用户定义的方法、测试和校正列表。
5 信息重量	以另外一个单位显示当前称量值。
6 警告和错误消息区	显示当前警告和/或错误消息。
7 结果列表	显示为该任务保存的称量结果。
8 样品状态 <b>确定</b>	结果状态指示灯为绿色：表示结果符合一组条件。例如： <ul style="list-style-type: none"> <li>天平处于水平状态。</li> <li>已执行了内部校正且状态正常。</li> <li>称量结果处于定义的公差范围之内（仅适用于允差已定义的情况）。</li> </ul>
9 样品状态 <b>已排除</b>	结果状态指示灯为黑色：表示结果已从 <b>结果列表</b> 中排除。
10 样品状态 <b>不正确</b>	结果状态指示灯为红色：表示不符合结果条件，例如"称量结果超出定义的允差范围"。
11 按钮 <b>添加到结果</b>	将结果添加至 <b>结果列表</b> 。 根据选择的方法，按钮可具有不同功能。
12 操作栏	包含有关当前任务的操作。
13 <b>天平菜单</b>	访问天平属性。
14 方法信息区域	包含有关样本、方法或任务ID的信息。
15 SmartTrac	用作称量辅助装置，可定义带上下限允差的目标重量。
16 称量值区	显示当前称量过程的结果。
17 <b>方法名称</b>	显示当前方法的名称。

### 3.6.3 面板“天平菜单”



	名称	描述
1	水平调节向导	打开调平对话框。
2	历史	打开历史记录对话框。
3	天平信息	显示天平信息。
4	用户	打开用户管理。
5	设置	打开完整的设置对话框。
6	维护	打开天平维护对话框。
7	退出 / 锁定天平	打开登出/锁定天平对话框。

### 3.6.4 面板“方法”



	名称	描述
1	方法列表	列出用户已定义的方法。 可以创建、编辑、复制、启动或删除方法。
2	手动操作	对于自动称重，此菜单显示可手动执行的操作。根据可用硬件的不同，可能包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>管理加样头数据</li> </ul>
3	任务	您可以启动一个方法/任务，然后该任务就会与该方法相关联。每个方法最多可关联一个任务。

	名称	描述
4	测试	<p>列出用户已定义的测试。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>灵敏度测试</li> <li>重复性测试</li> <li>偏心载荷测试</li> </ul> <p>可以创建、编辑、启动或删除日常测试。</p> <p><b>历史</b>中列出了以前执行过的测试。</p>
5	校正	<p>显示当前选择的内部或外部校正。可以编辑或启动这些校正。</p> <p><b>历史</b>中列出了以前执行过的校正。</p>

可参阅

 历史 ▶ 第73页

### 3.6.5 面板“结果”



	名称	描述
1	结果状态	显示称量过程的状态。
2	样品ID	显示称量 <b>样品ID</b> 结果。
3	毛重	<p>显示毛重。</p> <p><b>D</b>: 表示该值不稳定。当<b>称量模式</b>设置为<b>立即</b>时可能发生这种情况。</p> <p><b>*</b>: 表示该值已计算。例如, 当把<b>去皮模式</b>设置为<b>预置皮重</b>时可能发生这种情况。</p>
4	时间戳	显示每个称量项的单个时间戳。
5	天平状态	显示稳定性、天平调平状态、最小称重量、允差状态及测试和校正状态。
6	完成	<p>打开对话框 <b>完成任务</b>。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>手动打印任务标签</li> <li>手动打印结果</li> <li>手动导出结果</li> </ul>

	名称	描述
7	更多	打开对话框 <b>更多</b> 。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>开始调整</b></li> <li>• <b>更改显示单位</b></li> <li>• <b>配置去皮</b></li> <li>• <b>配置归零</b></li> <li>• <b>另存方法（明细）</b>（仅适用于带有选项<b>称量品</b>的方法）</li> </ul>
8	排除数据	从 <b>结果列表</b> 中排除当前结果。可以为排除的结果添加备注，例如描述排除的原因。 根据结果打印输出的格式，打印或不打印排除的结果。
9	取消任务	取消当前正在运行的任务。

### 3.6.6 图标和符号

#### 3.6.6.1 系统状态图标

在用户操作、用户输入或系统运行后，可出现系统消息。一些消息由用户自行选择执行，在用户确认后，它们将消失。其他消息则一直显示，用户可推迟执行，但最终仍需要对其处理。可在位于屏幕右上方的主状态栏中查看这些消息。

图标	名称	说明
	已调平	点按水平状态时，将显示有关调平状态的更多详细信息。
	不水平	必须将天平调至水平状态。关于对天平调平的信息，请参见调节天平水平部分。
	信息	在用户操作或者系统运行后，会出现信息消息，它们会提供与操作或过程相关的机会。
	警告	在进行有可能发生可预防问题的用户操作或系统运行后，会出现警告消息。
	错误	当用户操作或系统运行失败后，会出现错误消息。在大多数情况下，依旧可处理此类问题。

#### 3.6.6.2 称重状态图标

当重量值与特定质量标准匹配时，会出现称重状态图标。可点击任何可见重量状态图标查看关于状态的信息。

图标	名称	说明
	稳定指示	当稳定指示出现时，表示天平不稳定。务必将天平放置在适合的位置。可在选择安装位置一节中查找到关于适合位置的信息。
Net	净重指示	按下皮重键以及将皮重减掉后出现。
	计算值	计算当前重量值。只有在将容器与 <b>预置皮重</b> 功能结合使用后，此标志才会在称重值区域出现。

	违反最小称量值	当前重量值小于定义的最小称量值。确保重量大于最小称量值。
	天平无效	根据GWP批准的定义，当前天平配置无效或者未达到质量标准。
	称量未准备就绪	根据GWP批准的定义，当前的重量测量未准备就绪。这可能是由于过载、欠载或违反最小称量值所致。
	砝码准备就绪	根据GWP批准的定义，当前的砝码测量准备就绪。可将其添加至 <b>结果列表</b> 中。
	外部去离子装置放电中	外部去离子装置目前正在放电。

### 3.6.6.3 过程状态图标

在天平上运行过程的状态，右下角会显示相关过程的小图标。这适用于**任务、测试和校正**。

图标	名称	描述
	正在运行	这个过程当前正在运行。
	暂停	这个过程被暂停。
	定期	这个流程已安排。
	信息	提供有关流程的信息，例如提醒。
	过期	该过程已过期。

## 4 安装并投入使用

### 4.1 选择位置

天平是灵敏的精密仪器。它所处的位置将对称重结果的准确性产生重要影响。




#### 位置要求

放在室内稳定的工作台上

确保足够的空间

将仪器调平

提供充足照明




避免阳光直射

避免震动

无强烈气流

避免温度波动




为天平留有足够的空间：与周围的仪器至少相距15 cm

考虑环境条件。请参阅"技术参数"。


### 4.2 开箱取出天平

检查包装、包装元件和交付的组件是否有损坏。如果任何组件损坏，请联系您的METTLER TOLEDO服务代表。


1 开箱，使用提带将包装抬出 (1)。

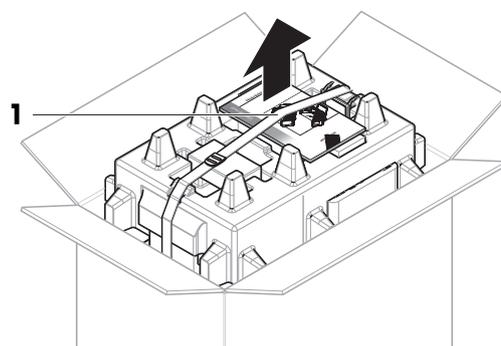


- 2 打开提带 (1)，取出用户手册 (2)。

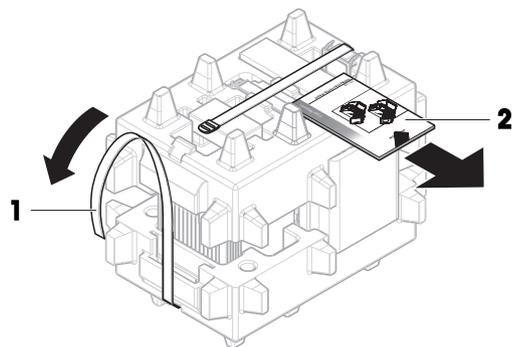


- 3 取下包装的上半部分，然后取下交流/直流适配器 (3)和电源线、泵(4)以及带有防蒸发打开/关闭 Quantos容器的移液器底座(5)。

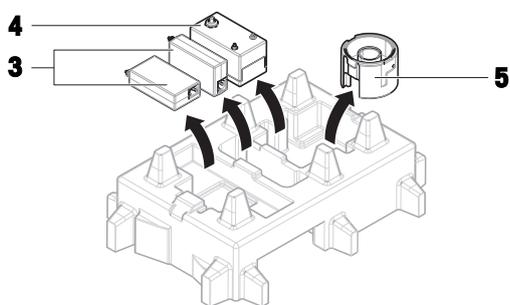

- 4 小心取出显示终端 (6)。

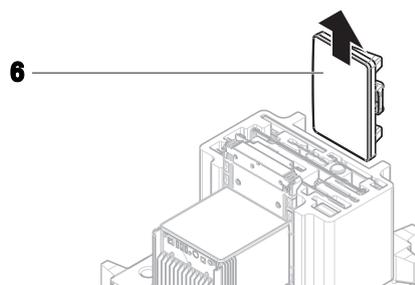

- 5 小心取出带有校准套件和其他小组件的包装套件 (7)。

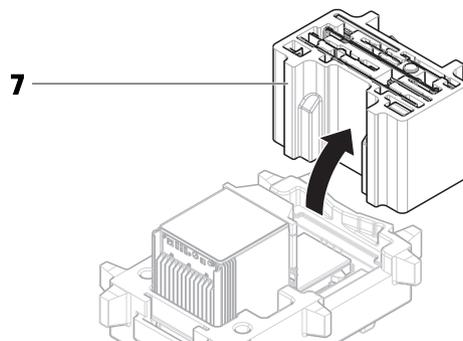

- 6 小心地将称量装置 (8) 从底部包装取出。


- 7 移除防护袋。

- 8 将所有包装部件安全存储，以便将来使用。

➔ 可以组装称量装置了。


#### 可参阅

🔗 运输、包装和存储 ▶ 第33页

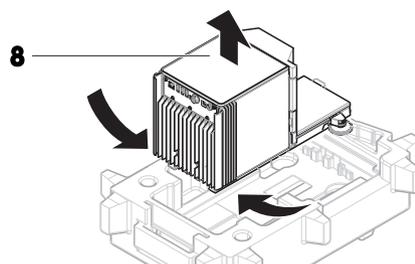

## 4.3 交货清单

### 4.3.1 天平

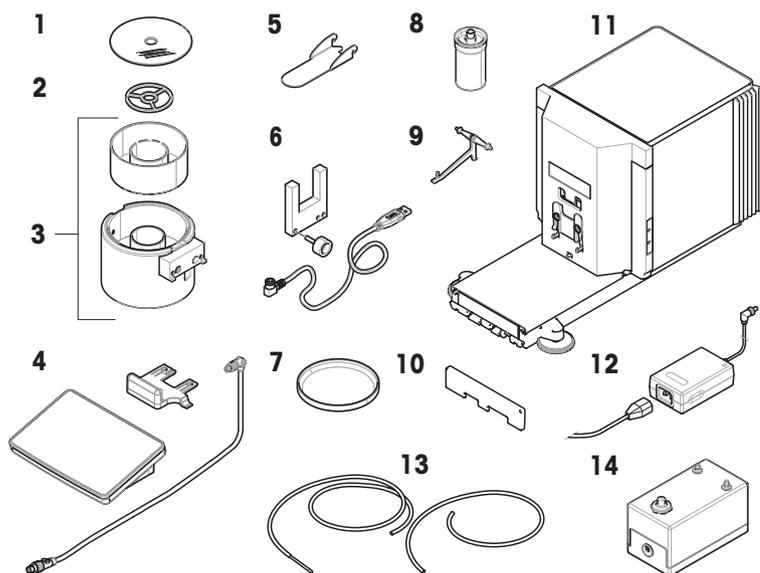


1	防蒸发阱盖	8	移液容器和金属管
2	定心环	9	用于移液容器的支架
3	带光栅板的垫片和防蒸发容器的移液器底座	10	前盖
4	带固定器和连接线缆的显示操作终端	11	称量装置
5	防蒸发阱门	12	带有国家特定电缆的交流/直流适配器，2个
6	挡光板、固定螺钉和电缆	13	泵管，2件（一条带金属管的软管）
7	盛水盘	14	泵

### 4.3.2 文档记录

- 《用户手册》
- 产品证书
- 一致性声明

### 4.3.3 校准套件

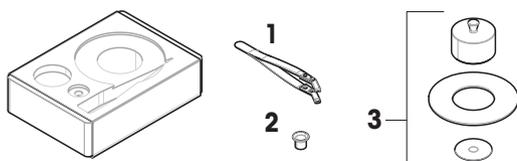

1	镊子	3	大秤盘，带盖圈和防风罩
2	小秤盘		

## 4.4 安装

### 4.4.1 连接显示终端




#### 注意


不谨慎拿放会造成线缆损坏

– 请勿弯折或缠绕线缆。


- 1 将显示屏支架（1）的滑道插入称量装置（2）的前面板中。

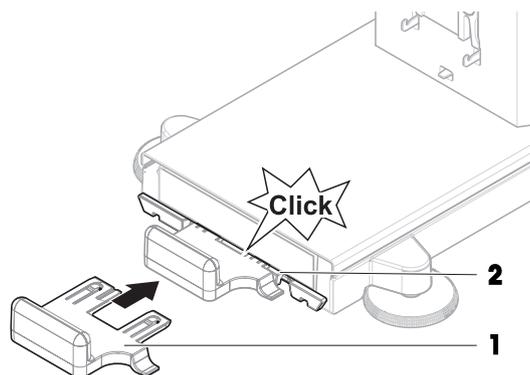


- 2 将终端线缆（3）连接至终端（4）。注意插口的角度。

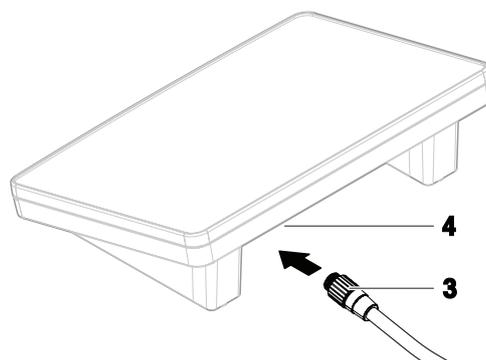


- 3 将终端（5）放在端子架（6）上。

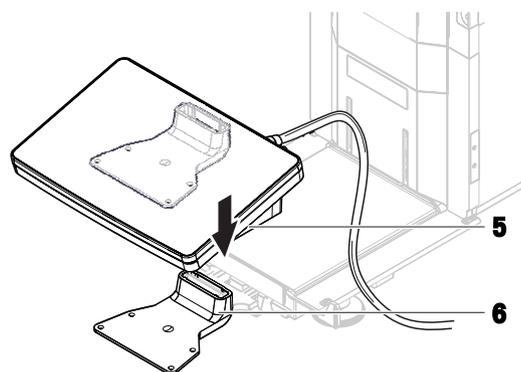

- 4 小心地将天平向侧面倾斜。
- 5 引导线缆 (7) 通过线缆槽 (8)。
- 6 将天平小心地放回到支脚上。

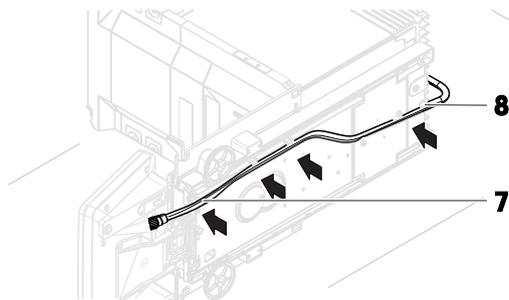


- 7 将终端线缆 (9) 插入到天平的插槽 (10) 内。注意插口的角度。
- ➔ 显示终端就绪。

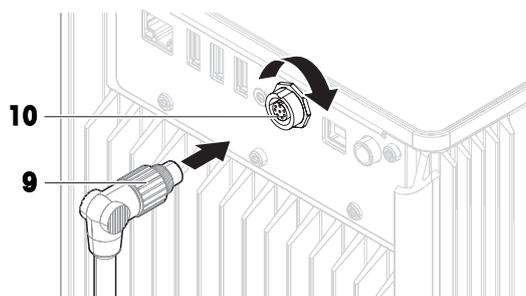


#### 4.4.2 组装天平


- 1 安装防护罩(1)。
- 2 将移液容器支架(2)小心地挂在挂钩(3)上。  
➔ 可自由悬挂移液容器支架(2)。
- 3 小心地将移液容器(4)放在移液容器支架(2)上。
- 4 将盛水盘(5)置于移液容器(4)下面的中心位置。

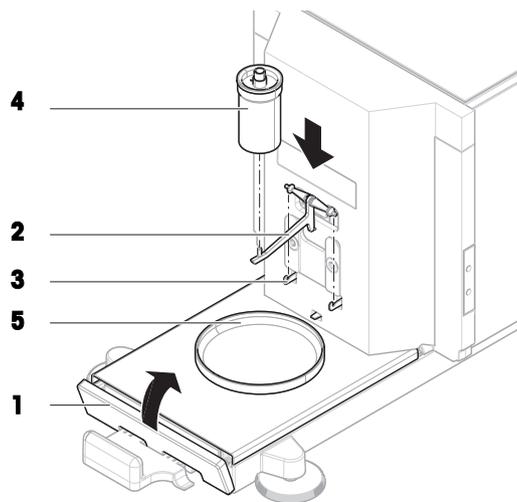

- 5 小心地沿着导轨垂直滑动带有防蒸发容器(7)的移液底座(6)，并放在滴盘上。  
➔ 将移液器底座放在盛水盘居中。移液底座不接触移液容器(5)或移液容器支架(3)。
- 6 将定心环(8)放在防蒸发阱容器(7)上。
- 7 小心地将防蒸发阱盖(9)放在防蒸发阱容器(7)上。

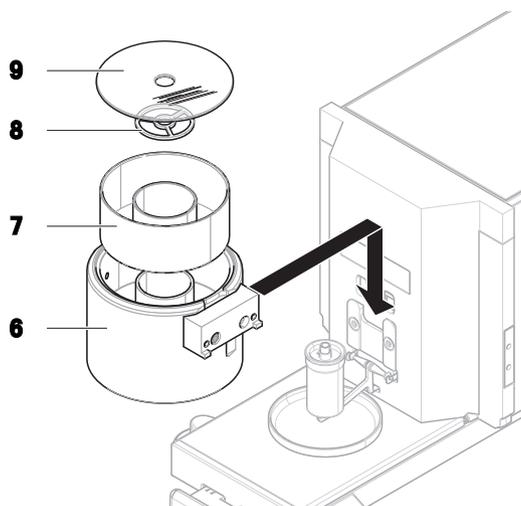

- 8 将防蒸发阱门(10)向后滑动，直至其咔哒一声推入连杆(11)。

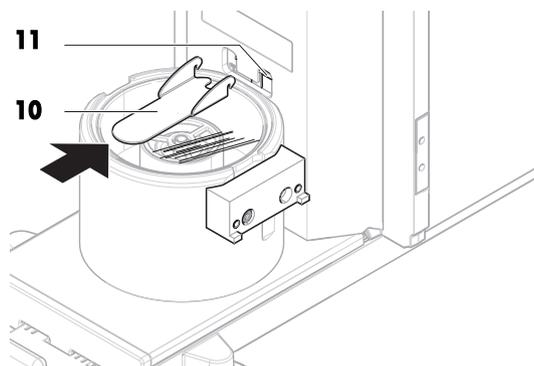


- 9 将光栅板电缆(12)连接到光栅板(13)。  
10 用固定螺钉(15)将光栅板(13)安装到光栅板垫片(14)上。

**信息**

光栅板和光栅板垫片默认安装在移液器底座右侧。另外，这些物品也可安装在移液器底座的左侧。

- 11 将光栅板电缆(12)沿着天平侧部、侧盖下方引导。  
12 将USB电缆(12)连接到仪器背面的其中一个USB端口。

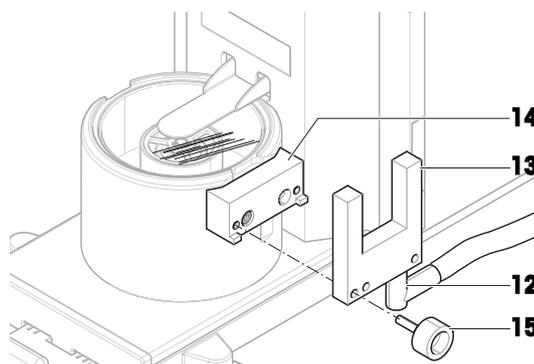

➔ 天平组装完成，可以投入使用了。

## 4.5 使用天平

### 4.5.1 连接天平




#### **警告**

##### **触电会造成重伤或死亡**

接触带电零件有可能造成伤亡。

- 1 仅使用仪器专用METTLER TOLEDO电源线和交流/直流适配器。
- 2 将电源线连接至接地电源插座。
- 3 将所有电缆与接头放置在远离液体和潮湿的地方。
- 4 检查电缆与电源插头有无损坏，如有损坏请更换。

- 1 以这种方式安装电缆，确保其不会受损或干扰操作。
  - 2 将交流/直流适配器(1)插头插入仪器的电源入口。
  - 3 用力拧紧螺母，紧固插头。
  - 4 将电源插头插入接地电源插座中。
- ➔ 天平自动开启。
- ➔ 防蒸发阱门打开和关闭以进行初始化。

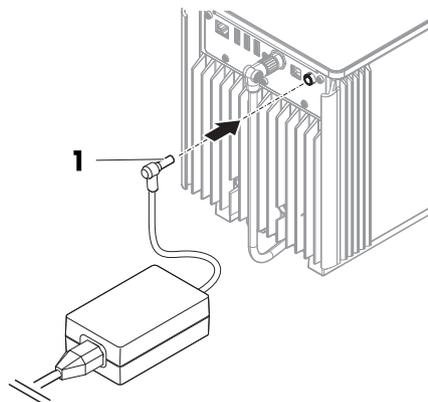

#### **i** 信息

切勿将此仪器连接至由开关控制的电源插座。开启仪器后，必须先对其进行预热，才能获得准确的结果。

#### 可参阅

[通用数据](#) ▶ 第121页

### 4.5.2 打开天平

接通电源后，天平会自动开启。

#### **EULA (最终用户许可证协议)**

首次开启天平时，屏幕上会出现EULA (最终用户许可协议) 字样。

- 1 阅读条件。
  - 2 点击**我接受许可证协议中的条款**，并通过**✓ 确定**确认。。
- ➔ 出现称量主界面。

#### **适应环境和预热**

在确保其能提供可靠结果前，天平必须：

- 适应室温条件
- 接通电源进行预热

“通用数据”中提供了天平适应环境的时间和预热时间。

#### **i** 信息

当天平退出待机状态时，将立即就绪。

#### 可参阅

[通用数据](#) ▶ 第121页

[进入 / 退出待机模式](#) ▶ 第30页

### 4.5.3 登录

如果用户管理已激活，则必须首先使用**用户名**登录，然后才能执行称量。天平启动时，将自动打开登录对话框。

- 1 选择一个用户或点击**用户名**。
- 2 点击**密码**。

- ➔ 打开输入对话框。
- 3 输入密码，然后点击**✓ 确定**。
- 4 点击**👤 登录**。
  - ➔ 此时登录对话框关闭，您已登录。您的**用户名**将显示在主屏幕上。

可以通过天平菜单激活用户管理：

**≡ 导航：** ▶ **天平菜单** > **⚙️ 设置** > **👤** > **天平** > **⚙️ 常规** > **用户管理**

#### 可参阅

- 🔗 激活用户管理 ▶ 第66页
- 🔗 用户 ▶ 第75页

### 4.5.4 调节天平水平


准确的水平和平稳定位是获得可重复且精确的称量结果的必要条件。

如果出现消息**天平不水平**：

- 1 点击▶ **调节天平水平**。
  - ➔ **水平调节向导**打开。
- 2 按显示屏上的说明转动两个水平调节脚(1)，直到电子水平泡处于指示器的中心

也可以在**天平菜单**中找到水平调节辅助装置：

**≡ 导航：** ▶ **天平菜单** > **📏 水平调节向导**

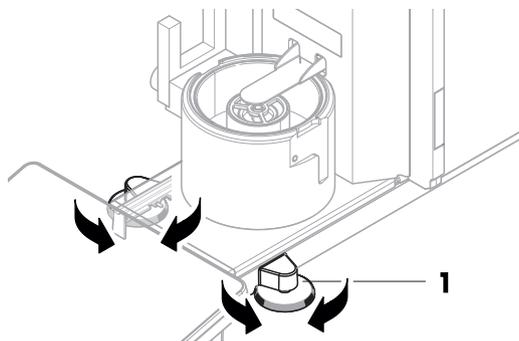

### 4.5.5 进行内部校正

**≡ 导航：** ▼ **方法** > **🔧 校正**

- 校正策略已设置为**内部校正**。
- 1 打开**方法**部分，点击**🔧 校正**，选择校正，然后点击▶ **启动**  
- 或 -  
在称量主界面，点击**⋮ 更多**然后点击**开始调整**。
  - ➔ 正在执行**内部校正**。
  - ➔ 完成校正后，屏幕上显示校正结果的概述。
- 2 如果要打印结果，则点击**🖨️ 打印**。
- 3 点击**✓ 完成校正**。
  - ➔ 天平已准备就绪。

### 4.5.6 执行功能检查


要进行功能检查，请使用天平附带的校准套件。

小号秤盘与最大直径为6 mm的测试砝码配套使用，例如1 g OIML砝码。

大秤盘与最大质量为20 g、最大直径为35 mm的测试砝码配套使用，例如20 g OIML砝码。


#### 4.5.6.1 使用小号秤盘

- 小号秤盘和防蒸发阱门已安装, 请参阅[安装小号秤盘 ▶ 第43页]。
- 打开天平。
  - 1 激活光栅板(1), 或按↓。
  - 防蒸发阱门(2)打开。
  - 2 使用镊子将测试砝码(3)放置到秤盘(4)上。
  - 3 激活光栅板(1), 或按↓。
  - 防蒸发阱门(2)关闭。
  - 显示称量结果。
- 4 如果要报告称重结果, 则点击**+** 添加到结果。
- 结果添加至**结果列表**。

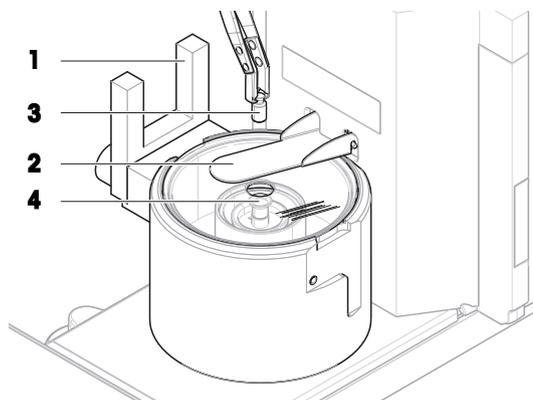


#### 4.5.6.2 使用大号秤盘

- 大号秤盘、环盖和防风罩已安装, 请参阅[安装大号秤盘 ▶ 第44页]。
- 打开天平。
  - 1 将防风罩(1)从盖环(2)上拆除。

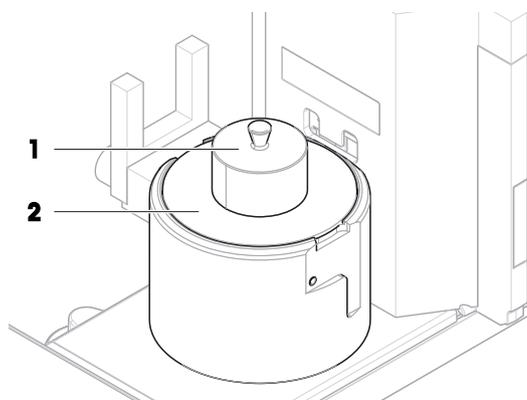

- 2 使用镊子将测试砝码(3)放置到秤盘(4)上。
- 3 将防风罩(1)放在盖环(2)上。
- 显示称量结果。
- 4 如果要报告称重结果, 则点击**+** 添加到结果。
- 结果添加至**结果列表**。

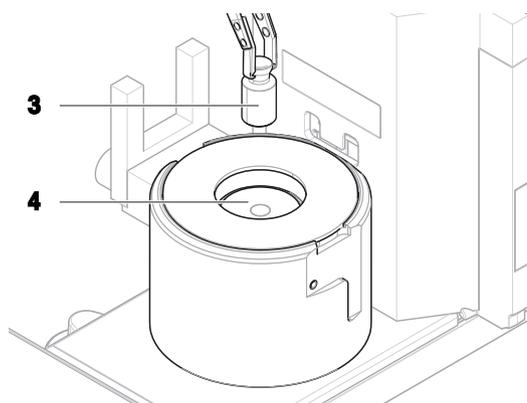

#### 4.5.7 进入 / 退出待机模式

- 1 要进入待机模式, 请按住⏻。
- 显示屏变暗。天平仍然处于开启状态。

2 要退出待机模式，请按。

➔ 显示屏打开。

### 4.5.8 关闭天平

如果要完全关闭天平，则必须断开电源。按住，天平仅进入待机模式。

#### 信息

当天平完全关闭一段时间后，必须将其预热方可使用。

#### 可参阅

 打开天平 ▶ 第28页


## 4.6 执行移液循环

要校准移液器，必须使用蒸馏水。通过重量法测试检查液体体积。


### 4.6.1 填充防蒸发阱容器

防蒸发阱包括一个装满水的容器。防蒸发阱关闭时，内部湿度增加，直至空气饱和。这可防止移液容器内的液体蒸发，确保准确的称量结果。

- 1 拆除防蒸发阱门(1)。
- 2 小心地取下防蒸发阱盖(2)。

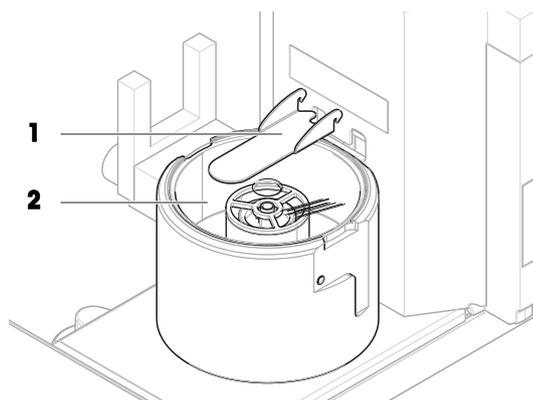

- 3 将蒸发阱容器(3)装满蒸馏水。  
➔ 防蒸发阱容器至少装满一半（最大70 ml）。
- 4 重新组装天平。  
➔ 防蒸发阱门(1)关闭。
- 5 等待至少**120分钟**，让防蒸发阱中的空气达到饱和状态。

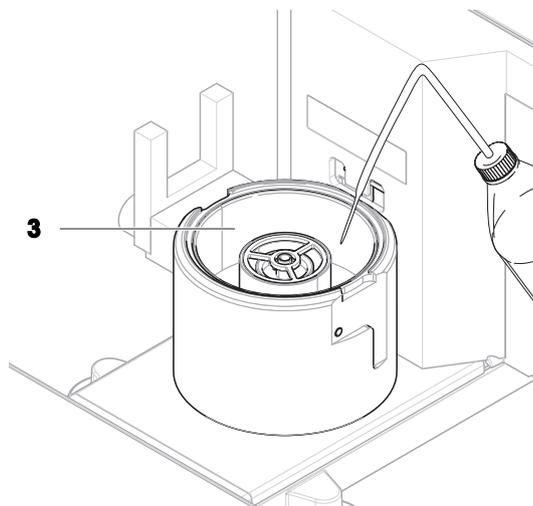

## 4.6.2 天平归零

- 按**→0←**可将天平归零。
- ➔ 天平已归零。


## 4.6.3 去皮

在随后的测量之前，必须对天平去皮。

- 短按**→T←**为天平去皮。
- ➔ 天平已去皮。此时出现Net图标。

## 4.6.4 执行移液循环循环

- 待校准的移液器已准备好，并设置为目标容量。
  - 1 使用移液器吸入蒸馏水的目标体积。
  - 2 激活挡光板(1)，或按**↓**。
    - ➔ 防蒸发阱门(2)打开。
  - 3 将液体分配至移液容器(3)中。
  - 4 激活挡光板(1)，或按**↓**。
    - ➔ 防蒸发阱门(2)关闭。
    - ➔ 显示称量结果。
  - 5 如果要报告称重结果，则点击**+**添加到结果。
    - ➔ 结果添加至**结果列表**。

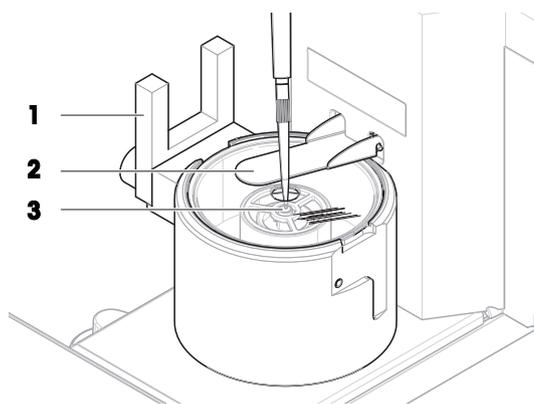

## 4.6.5 完成称量

- 1 如果要保存**结果列表**，请点击**完成**。
  - ➔ **完成任务窗口**打开。
- 2 选择保存或打印**结果列表**。
  - ➔ **结果对话框**打开。
- 3 请遵照向导说明。
- 4 点击**✓ 完成**。
  - ➔ **结果列表**已保存/打印并于之后删除。

## 4.6.6 清空移液容器

定期清空移液容器，防止溢出。

### 可参阅

- [清空移液容器](#) ▶ 第111页
- [溢出后清洁](#) ▶ 第115页

## 4.7 运输、包装和存储

### 4.7.1 短距离运输天平


- 1 断开与AC/DC适配器的连接并拔下所有接口线缆。
- 2 用双手拿稳秤台，将天平水平搬到目标位置。  
注意位置要求。

如果想将天平投入使用，则按照以下步骤操作：

- 1 按相反顺序安装。
- 2 给天平足够的时间进行预热。
- 3 将天平调平。
- 4 执行内部校正。

#### 可参阅

- 🔗 选择位置 ▶ 第22页
- 🔗 调节天平水平 ▶ 第29页
- 🔗 进行内部校正 ▶ 第29页

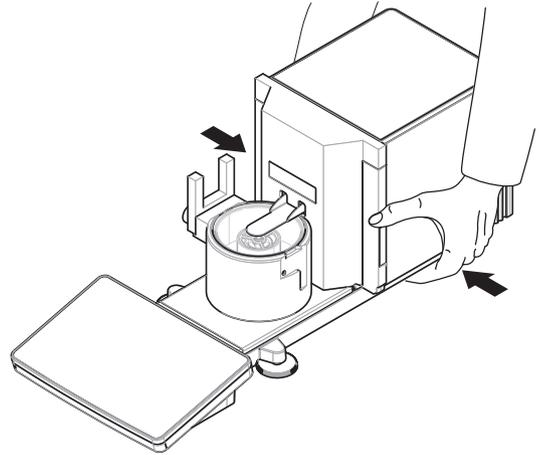

### 4.7.2 远距离运输天平

METTLER TOLEDO 在远距离运输或运送天平或者天平组件时，建议使用原始包装。原始包装元件是专门针对天平及其组件设计的，可确保在运输期间提供最佳保护。

#### 可参阅

- 🔗 开箱取出天平 ▶ 第22页

### 4.7.3 包装和存储

#### 包装天平

将所有包装部件安全存储。原始包装元件专门针对天平及其组件设计，可确保在运输或存储期间提供最佳保护。

#### 存储天平

仅在以下条件下存储天平：

- 室内且在原始包装中
- 根据环境条件，请参阅"技术资料"

#### **i** 信息

当存储时间超过6个月时，充电电池可能没电（仅丢失日期和时间）。

#### 可参阅


- 🔗 技术参数 ▶ 第121页

## 5 操作

### 5.1 触控式屏幕


#### 5.1.1 选择或激活条目

- 点击要选择或激活的项目或功能。

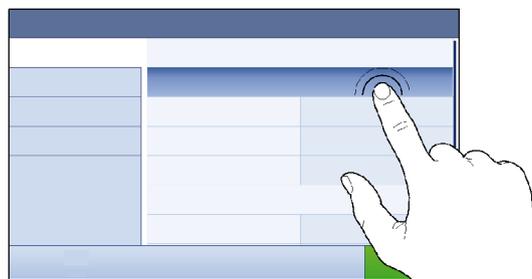

#### 5.1.2 滚动


- 向上/向下滚动列表。

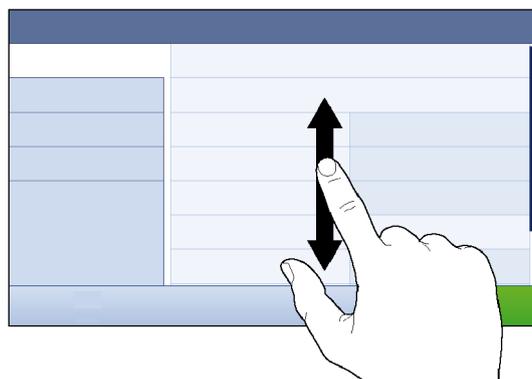


#### 5.1.3 使用飞入式面板

飞入式面板位于称量主界面的侧面。

- 1 将手指放在界面一侧的选项卡上，例如 ◀。

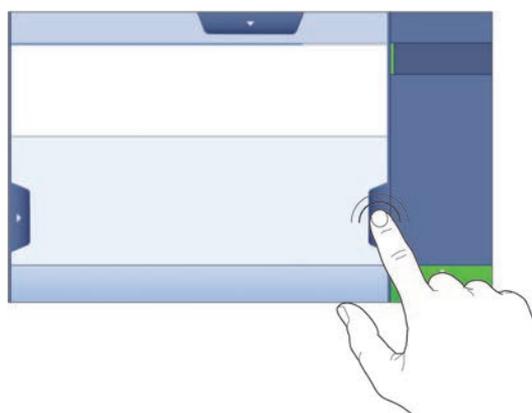

- 手指在选项卡上保持不动，然后沿箭头所指的方向滑动。

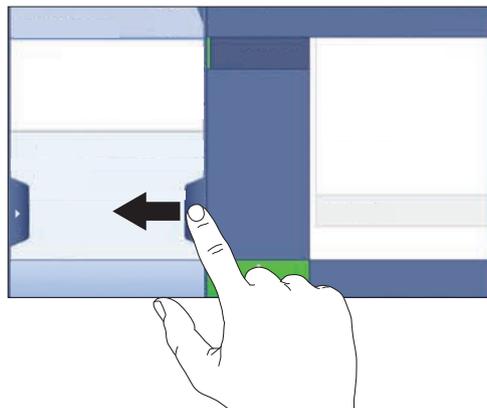

**i 信息**

还可通过点击相关选项卡打开或关闭飞入式面板。

### 5.1.4 输入字符和数字



	名称	描述
1	输入栏	显示已输入的数据。
2	退格键	删除位于当前光标位置左侧的字符。可使用触控式屏幕对光标定位。
3	放弃	关闭键盘对话框。
4	确认	确认输入的数据。
5	数字和特殊字符	切换到特殊字符模式。
6	切换	切换大小写。
7	菜单章节标题	显示当前设置章节的标题。

### 5.1.5 修改日期和时间



	名称	说明
1	加号按钮	增加
2	显示栏	显示要定义的时间或日期。
3	减号按钮	减少

### 信息

日期和时间的格式可通过设置中的**日期格式**和**时间格式**选项定义。

### 可参阅

 [日期/时间/语言/格式](#) ▶ 第82页

## 5.2 方法

称量方法适用于执行特定的称重任务。天平提供带默认参数的"General Weighing"方法。您最多可以创建50种方法并对其加以编辑。您可以使用这些方法执行称量任务或者根据自身要求对其进行编辑。您可以删除或复制方法。

如要在配置新方法时获得支持，可使用配置向导，它可引导您完成整个过程。对方法进行的更改会记录在变更历史（若激活）中。

### 5.2.1 方法概述

章节**方法列表**概述了天平上已创建的所有方法。在该部分，您可以定义新方法，编辑、复制或删除现有方法。此外，它也是在称重程序中使用任何方法的起点。

≡ 导航： ▼ 方法 > ≡] 方法列表

下列方法用于移液器校准：

-  一般称重

下列方法可用，但不适用于移液器校准天平：

-  简单公式
-  间隔称量
-  滴定
-  密度测定

### 5.2.2 方法"一般称重"

**一般称重**方法提供基本称量功能（清零、去皮、称量）。该方法用于移液器校准、基础称量任务和日常测试。

称量品设置例如目标重量和允差可指定一个或多个称量品。存在两种不同的方法：

- **一般称重：**
  - 如果您想要使用单组参数，请选择此方法。
- **一般称量（明细）：**
  - 如果您想要为称量品定义参数，则可选择此方法。当称量任务由一系列称量组成时，多个称量品方法会特别有用，每个称量都有其各自的参数，例如目标质量、允差等。详细信息请参阅 [\[使用多个称量品方法（逐项排列）](#) ▶ 第40页]

方法	
☰ 方法列表	⚖️ 我的一般称量 2022/24/06
🖋️ 手动操作	🕒 我的间隔称量 2022/24/06
🔄 任务	📄 我的简单公式 2022/24/06
🧪 测试	
🧪 校正	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>🗑️ 删除</span> <span>📄 克隆</span> <span>✎ 编辑</span> <span>➕ 新建</span> <span>🖨️ 打印</span> <span style="background-color: #00a651; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 5px;">▶ 开始方法</span> </div>	

您可以直接使用方法的出厂设置参数，或使用更改的方法参数创建一个新方法。  
如需关于方法设置的详细信息：

#### 可参阅

- 🔗 设置：方法"一般称重" ▶ 第90页
- 🔗 使用多个称量品方法（逐项排列） ▶ 第40页

### 5.2.2.1 创建方法"一般称重"


☰ 导航：▼ 方法 > ☰ 方法列表

- 1 点击操作栏中的**➕ 新建**。
  - ➔ 方法向导打开，从**1. 方法类型**开始。
- 2 点击**方法类型**并选择方法类型**一般称重**或**一般称量（明细）**。
- 3 点击**➔ 下一步**。
  - ➔ 方法向导打开**2. 标识**部分。
- 4 定义**方法名称**和**结果说明**并点击**➔ 下一步**。
  - ➔ 方法向导打开**3. 配置**部分。
- 5 选择一个**允差配置文件**并点击**➔ 下一步**。
  - ➔ 方法向导打开**4. 保存**部分。
  - ➔ 如果使用为多个称量品设置方法，向导会打开**4. 称量品**部分。
- 6 从列表选择一个称量品并定义**样品ID**、**单位**、**目标重量**、**-允差**和**+允差**。
- 7 要添加称量品，请点击**➕物品**或**📄克隆**。
- 8 点击**➔ 下一步**。
  - ➔ 方法向导打开**5. 保存**部分。
- 9 点击**✓ 完成**保存新方法。
  - ➔ 方法已创建并出现在列表中。


### 5.2.2.2 执行"一般称重"

本节将逐步介绍**一般称重**示例。实际程序可能会与本示例所述有所不同，具体视所定义的设置及称重物而定。

- 大号秤盘、环盖和防风罩已安装，请参阅[安装大号秤盘 ▶ 第44页]。
- 打开天平。
  - 1 打开**方法**部分。
  - 2 从**方法列表**中选择一种方法或者定义一种新方法。
  - 3 点击▶ **开始方法**。
    - ➔ 出现所选方法的称量主界面。
  - 4 按→**0**←可将天平归零。
  - 5 拆除防风罩(1)。

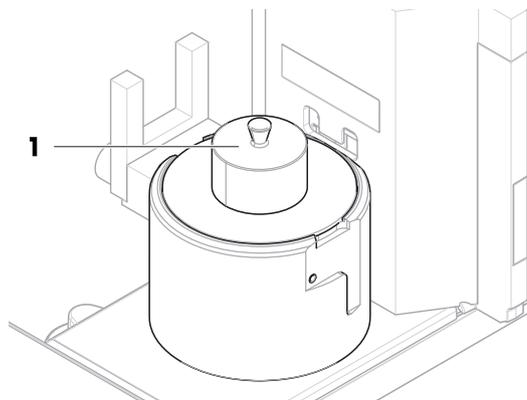

- 6 将称量物(2)放置到秤盘(3)上。
- 7 将防风罩(1)放在盖环(4)上。
  - ➔ 称重从**捕获重量...**开始。
- 8 点击**+** **添加到结果**。
  - ➔ 称重结果已保存至**结果列表**。
- 9 称量过程完成时，请点击操作栏中的 **完成**。
  - ➔ **完成任务**窗口打开。可在标签打印机上打印任务特定信息，可手动或自动打印**结果列表**（取决于方法设置），并且可将结果导出至外接存储设备。
  - ➔ 任务**一般称重**已成功完成。

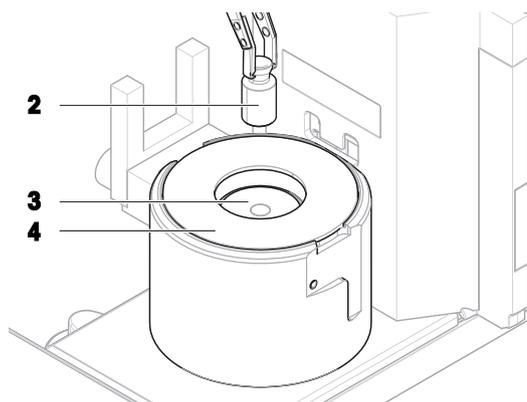

#### 信息

可从**结果列表**中排除称量结果。打开**结果列表**选择一个要排除的结果，然后点击**排除数据**。完成任务后将始终出现窗口**完成任务**，即使结果将被自动保存。

### 5.2.3 编辑方法

要复制方法，请按照以下程序操作：

- 1 打开**方法**部分。
- 2 选择要编辑的方法。
  - ➔ 所选方法的线条颜色变成蓝色。

3 点击  编辑。

如需关于方法设置的详细信息：

可参阅

 称量方法设置 ▶ 第90页

## 5.2.4 复制方法

如要简化创建方法的过程，可将已经存在的方法复制一次或多次。复制的方法将具有与原始方法相同的参数值。如果原方法中存在多个称量品，则也会复制这些物品。

- 1 打开方法部分。
- 2 点击您想复制的方法。
  - ➔ 所选方法的线条颜色变成蓝色。
- 3 点击  克隆。
  - ➔ 所选方法的副本将出现在列表中。复制的方法与原始方法设置相同。

### 信息

一个方法可被复制多次。所复制方法的名称要始终以其原始名称为基础，然后在后面添加一个数字。

## 5.2.5 删除方法

如果无需使用出厂前定义的方法和用户定义的方法，则可将其删除。因此，请执行下列操作：

- 1 打开方法部分。
- 2 点击您想删除的方法。
  - ➔ 所选方法的线条颜色变成蓝色。
- 3 点击  删除。
  - ➔ 屏幕上出现 **删除方法并取消任务?** 的消息。
- 4 点击  确定删除已选择的方法。
  - ➔ 系统返回方法列表。已删除方法，不会再显示在列表中。

### 信息

会有一些在后台运行的方法。不可直接删除该方法。要删除该方法，必须开始另一个方法。该方法如今已不再活动，可删除。

## 5.2.6 删除任务

在方法菜单的任务部分，方法将被当作任务来处理。如果在未完成当前方法的情况下启动其他方法，则其将如同任务一样暂停。如果方法中包含一个或多个称重结果或某些方法设置已更改，则该方法会暂停。

 导航： ▼ 方法 >  任务

任务只能在非使用状态下才能被删除。在任务列表里，当前在后台运行的方法会带有标记符号 。要取消任务，必须激活另一个任务。

- 1 选择待删除的任务并点击  取消。
  - ➔ 对话框 **取消任务?** 打开。
- 2 要删除任务，点击  确定；要取消删除程序，点击  取消。

## 5.2.7 使用多个称量品方法（逐项排列）

使用逐项排列方法可以简化工作流程，尤其是当必须依次执行具有不同预定义目标重量的多个称量任务时。可在单项任务中为每个称量品定义目标重量和允差等信息。这可节约时间，提高多个步骤的称量过程质量。

在称量过程中使用多个称量品之前，必须先定义称量品。创建包含多个称量品称重方式的两种方法是：

- 在创建方法过程中直接定义多个称量品。
- 使用正在运行方法的结果列表定义包含多个称量品的全新方法。

以下方法使用多个称量品：

- **一般称量（明细）**

### 5.2.7.1 创建多个称量品的全新方法（逐项排列）

本示例描述了如何为方法**一般称量（明细）**定义多个称量品。

- 1 打开**方法**部分。
- 2 点击操作栏中的**+** **新建**。
- 3 点击**方法类型**然后选择**一般称量（明细）**。
- 4 逐步通过方法向导直到步骤**4. 称量品**。
  - ➔ 出现 **4. 称量品** 对话框。
- 5 从列表中选择**一个称量品**并定义**样品ID、单位、目标重量、-允差和+允差**。
- 6 点击**→ 下一步**。
- 7 点击**✓ 完成**。
  - ➔ 方法已创建并出现在列表中。

### 5.2.7.2 从已完成任务中创建逐项排列方法

如果方法类型允许，可在执行单个物品方法时创建多个物品的方法。本示例描述了如何根据方法**一般称量（明细）**创建方法**一般称重**。

- 1 开始方法**一般称重**。
- 2 执行3次称量，然后点击将结果添加到**结果列表+** **添加到结果**。
  - ➔ 结果保存至**结果列表**。
- 3 点击**⋮ 更多**。
- 4 点击**📄 另存方法（明细）**。
- 5 定义**方法名称**。
- 6 点击**✓ 确定**。
  - ➔ 创建包含3个物品的方法**一般称量（明细）**并添加到**方法列表**，其名称由用户定义。

### 5.2.7.3 执行逐项排列方法

多个称量品方法创建后即可启动。

- 1 打开**方法**部分。
- 2 从**方法列表**中选择**逐项排列方法**。
- 3 点击**▶ 开始方法**。

- ➔ 称量主界面打开。方法中定义的目标重量和允差限值出现。

## 5.3 测试砝码

### 5.3.1 定义单个校验砝码

用户应根据相应的证书输入与每个校验砝码相关的数据。这样可使每个外部校验砝码都明确追溯到一个特定证书。最多可以配置12个外部校验砝码。这些校验砝码可用于执行外部测试和校正。

☰ 导航： ▼ 方法 > 🛠 测试 > 📄 测试砝码

#### 📘 信息

用于外部校正的外部测试砝码的重量必须至少为天平量程的10 %。质量低于天平量程10 %的外部测试砝码将不会在天平上显示。

- 对话框**测试砝码**打开。
  - 1 点击**+** **测试砝码**。
  - 2 定义测试砝码设置，并使用**✓ 完成**确认。
- ➔ 测试砝码已定义，而且可在随后的测试程序中使用。

### 5.3.2 定义组合砝码测试

用户可将测试砝码进行组合，以达到作为单个标准砝码不可用的测试量程。例如：可将1 g砝码与20 g砝码进行组合，作为一个21 g的测试砝码使用。每一个组合的测试砝码可包括两到三个测试砝码。特定组合砝码的级别只能与其包含的单个测试砝码的最低级别相当。对于其他任何测试砝码，组合的测试砝码可用于执行外部测试和调整。

☰ 导航： ☰ 方法 > 🛠 测试 > 📄 测试砝码

- 对话框**测试砝码**打开。
  - 定义至少两个单独的测试砝码。
    - 1 点击**+** **组合砝码**。
    - 2 输入一个**测试砝码名称**。
    - 3 为组合砝码选择**最小砝码级别**。
    - 4 点击**砝码**。
      - ➔ 显示至少**最小砝码级别**个单个砝码。
    - 5 选择将要包含在组合砝码中的砝码。
    - 6 点击**✓ 确定**。
      - ➔ **标称重量**计算为所选单个砝码之和。
    - 7 点击**✓ 保存**。
  - ➔ 组合校验砝码已定义，而将在随后的测试程序中使用。

## 5.4 测试

根据GWP®或其他质量管理体系安排进行的常规测试可以确保获得准确的称量结果。因此，应当按照质量管理体系定期进行测试，并且按照可追溯方式将结果记录在案。

## 5.4.1 日常测试概述

METTLER TOLEDO 可以根据您的过程要求定义要执行的日常测试。如需更多信息，请与您当地的 METTLER TOLEDO 代表联系。

执行这些测试需要天平附带的校准套件。

### 5.4.1.1 重复性测试

重复性测试通过单个测试砝码计算一系列测量的标准差，以便测定天平的重复性。

重复性指在相同的测量条件下，天平在对一个载荷以及相同载荷进行反复称量时提供相同结果能力的衡量指标。在测试期间，将载荷放在秤盘上的同一位置并进行多次测量。然后计算出测定重量值之间差异。测量结果的分布表示重复性。

重复性很大程度上受到环境条件（气流、温度变化和振动）以及进行称量的人员技能的影响。因此，必须由同一名操作人员在相同地点和恒定的环境条件下不受干扰地进行一系列测定。

提供下列测试类型：

- **重复性 - 1个测试点**: 在一个测试点测试无皮重的天平重复性。

### 5.4.1.2 灵敏度测试

天平的灵敏度定义了天平读数与实际载荷之间的偏差。灵敏度测试允许您使用一个或两个测试点测定灵敏度。

提供下列测试类型：

- **灵敏度 - 1个测试点**: 在一个测试点测试无皮重的天平灵敏度。
- **灵敏度 - 2个测试点**: 在两个测试点测试无皮重的天平灵敏度。

## 5.4.2 创建一个新测试

执行测试之前，必须定义测试设置。测试向导可指导您逐步完成整个过程。

- 1 打开**方法**部分。
- 2 点击 **测试**。
- 3 点击 **新建**。
  - ➔ 向导 **新建测试** 开始。
- 4 选择测试类型。
- 5 使用按钮 **➔ 下一步** 可转至下一步，使用按钮 **← 返回** 可返回上一步，因此可以完成整个过程。

如需关于测试设置的详细信息：


### 可参阅

[测试设置](#) ▶ 第101页

## 5.4.3 准备天平以执行测试

### 5.4.3.1 准备天平


- 1 拆除防蒸发阱门(1)。
- 2 小心地取下防蒸发阱盖(2)。
- 3 拆卸定心环(3)。

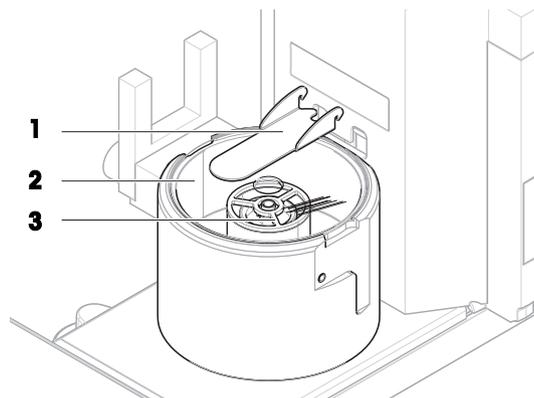


### 5.4.3.2 安装小号秤盘

小号秤盘与最大直径为6 mm的测试砝码配套使用，例如1 g OIML砝码。


- 天平已准备好，请参阅[准备天平 ▶ 第43页]。
  - 提供校准套件。
- 1 将小号秤盘(1)放在移液容器(2)上。

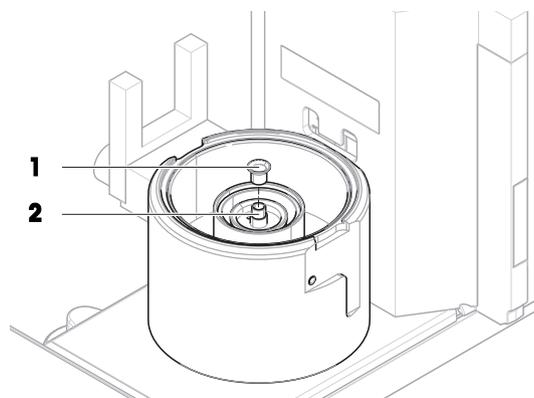

- 2 小心地将防蒸发阱盖(3)放在移液底座(4)上。

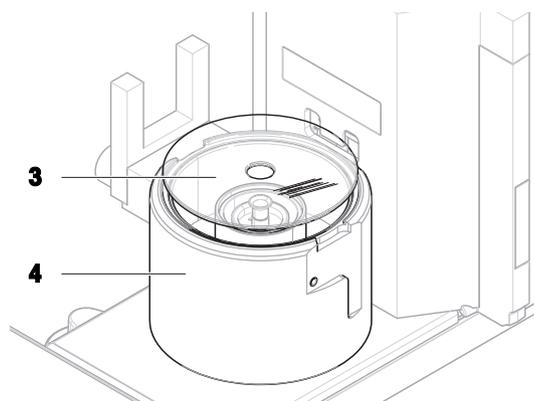

3 将防蒸发阱门(5)向后滑动，直至其卡入。

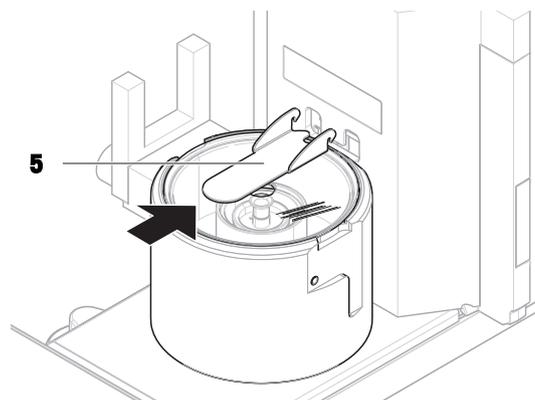


### 5.4.3.3 安装大号秤盘

大秤盘与最大质量为20 g、最大直径为35 mm的测试砝码配套使用，例如20 g OIML砝码。


■ 天平已准备好，请参阅[准备天平 ▶ 第43页]。

■ 提供校准套件。


1 将大号秤盘(1)放在移液容器(2)上。

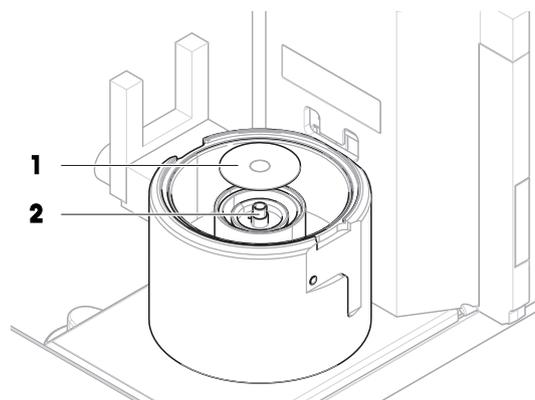

2 将盖环(3)放在移液底座(4)上。

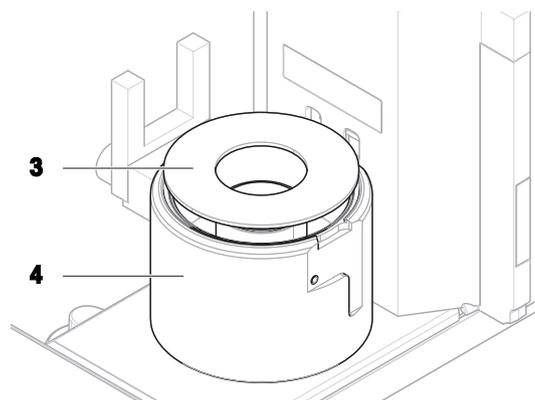

- 3 将防风罩(5)放在盖环(3)上。

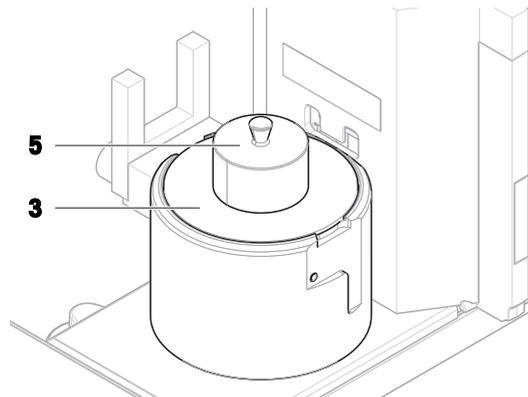

#### 5.4.4 执行测试



#### 注意

测试砝码操作不当而导致的错误称重结果。

- 只能使用手套、镊子、砝码叉或砝码提手操作测试砝码。

您可以执行重复性测试或灵敏度测试。您必须执行哪项测试及何时执行测试取决于具体的称量流程，Mettler-Toledo GmbH可帮助您基于流程要求定义常规测试。有关更多信息，请与当地的梅特勒-托利多代表联系。

可以执行测试的时间：

- 清洁后
- 软件升级后
- 每天执行操作之前
- 视您的SOP而定

要求：

- 至少要定义一个测试砝码。
- 至少要创建一个灵敏度测试或一个重复性测试。

#### 可参阅

[🔗 定义单个校验砝码 ▶ 第41页](#)

[🔗 测试设置 ▶ 第101页](#)


##### 5.4.4.1 执行"重复性测试"

本节介绍了一个测试点的重复性测试。具体使用哪种测试取决于您的测试目标。

要执行测试，请使用天平附带的校准套件。

- 小号秤盘和防蒸发阱门已安装，请参阅[安装小号秤盘 ▶ 第43页]。
- 打开天平。
  - 1 打开方法部分。
  - 2 点击  测试。
    - ➔ 之前定义的测试在列表上显示。
  - 3 选择您想要进行的重复性测试，然后点击 ▶ 启动。

- ➔ 启动测试顺序。
- 4 确保秤盘已清空且是清洁的。随手可得：测试砝码、手套和用于操作测试砝码的适当工具。
- 5 所有条件均满足后，点击**✓ 确定**。
- 6 确保秤盘已清空且防蒸发阱已关闭，然后点击**✓ 确定**。
  - ➔ 天平开始自动归零。
- 7 选择可用的测试砝码
  - 或 -
  - 添加一个新的测试砝码并点击**✓ 确定**。
- 8 激活光栅板(1)，或按**↓**。
  - ➔ 防蒸发阱门(2)打开。
- 9 使用镊子将测试砝码(3)放置到秤盘(4)上。
- 10 激活光栅板(1)，或按**↓**。
  - ➔ 防蒸发阱门(2)关闭。
  - ➔ 测量从**捕获重量...**开始。
  - ➔ 测量结果添加至**结果列表**。
- 11 激活光栅板(1)，或按**↓**。
  - ➔ 防蒸发阱门(2)打开。
- 12 小心地移除测试砝码并点击**✓ 确定**。
  - ➔ 天平开始自动归零。
  - ➔ 根据规定的**重复次数**，必须重复上四个步骤若干次。
- 13 测试程序完成后，点击**🏠 完成**。
  - ➔ 结果对话框打开。
- 14 要打印结果，点击**🖨️ 打印**；要完成测试，点击**✓ 完成**。

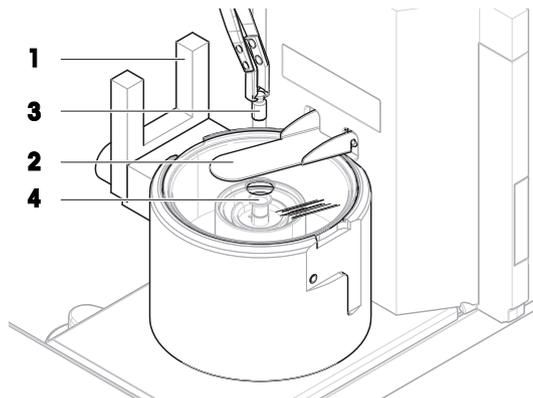

### 测试结果

如果测试失败，请参见"故障排除"来查找错误、进行修复并再次测试。如果再次测试失败，则联系METTLER TOLEDO代表。

### 可参阅

- 🔗 设置：重复性测试 ▶ 第101页
- 🔗 故障排除 ▶ 第118页


#### 5.4.4.2 执行"灵敏度测试"

本节介绍了一个测试点的灵敏度测试。具体使用哪种测试取决于您的测试目标。


要执行测试，请使用天平附带的校准套件。

- 大号秤盘、环盖和防风罩已安装，请参阅[安装大号秤盘 ▶ 第44页]。
- 打开天平。
  - 1 打开**方法**部分。
  - 2 点击**🔍 测试**。
    - ➔ 之前定义的测试在列表上显示。
  - 3 选择想要进行的灵敏度测试，然后点击**▶ 启动**。


- ➔ 启动测试顺序。
- 4 确保秤盘已清空且是清洁的。随手可得：测试砝码、手套和用于操作测试砝码的适当工具。
- 5 所有条件均满足后，点击✔ **确定**。
- 6 确保秤盘已清空且防风罩已安装，然后点击✔ **确定**。
  - ➔ 天平开始自动归零。
- 7 选择可用的测试砝码
  - 或 -
  - 添加一个新的测试砝码并点击✔ **确定**。
- 8 拆除防风罩(1)。

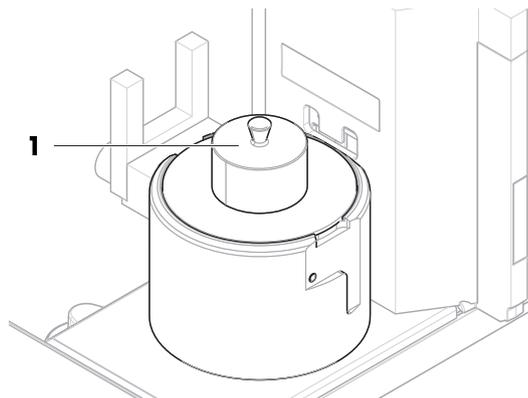

- 9 使用镊子将测试砝码(2)放置到秤盘(3)上。

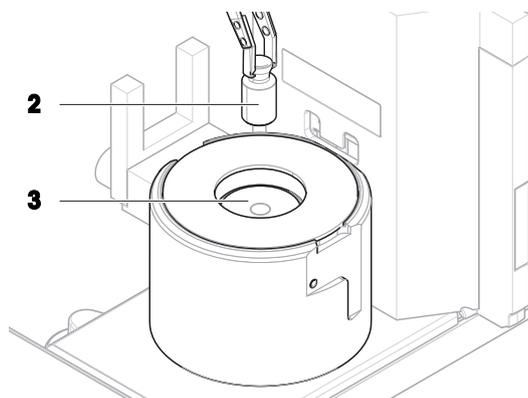

- 10 将防风罩(1)放在盖环(4)上。
  - ➔ 测量从**捕获重量...**开始。
  - ➔ 测量结果添加至**结果列表**。
- 11 测试程序完成后，点击🏠 **完成**。
  - ➔ 结果对话框打开。
- 12 要打印结果，点击🖨️ **打印**；要完成测试，点击✔ **完成**。

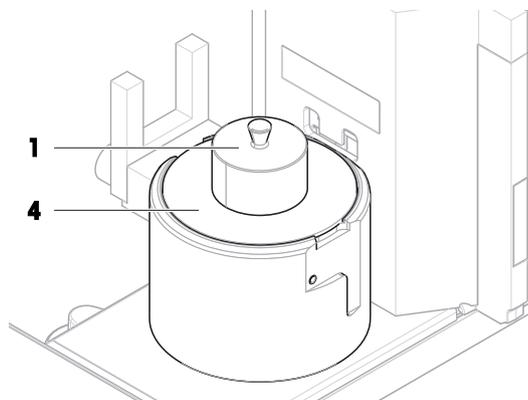

### 测试结果

如果测试失败，请参见"故障排除"来查找错误、进行修复并再次测试。如果再次测试失败，则联系METTLER TOLEDO代表。

#### 可参阅

[🔗 设置：灵敏度测试 ▶ 第104页](#)

[🔗 故障排除 ▶ 第118页](#)

### 5.4.5 编辑测试

只能编辑未在运行的测试。

☰ 导航： ▼ 方法 > 🧪 测试

- 1 在列表中选择要编辑的测试，然后点击✂️ 编辑。
  - ➔ 测试设置打开。
- 2 编辑测试设置。

### 5.4.6 打印测试结果

您可以手动打印测试结果，无论测试设置中的**自动打印**参数是否激活。因此，请执行下列操作：

- 1 打开**方法**部分。
- 2 点击🧪 测试。
  - ➔ 测试列表打开。
- 3 选择待打印的测试结果并点击🖨️ 打印全部。
  - ➔ 测试结果已打印。

### 5.4.7 删除测试

- 1 打开**方法**部分。
  - 2 点击🧪 测试。
    - ➔ 测试列表打开。
  - 3 选择要删除的测试。
  - 4 点击🗑️ 删除。
    - ➔ **删除常规测试**一节打开。**是否真的要删除所选常规测试?**消息出现。
  - 5 点击✔️是删除测试。点击❌否可取消删除过程。
    - ➔ 删除测试之后，系统返回测试列表。此时测试删除，不会再显示在列表中。
- 正在运行的测试带有符号🕒，不能删除。要删除测试，必须首先完成该测试，或必须激活另一个测试。要删除测试，请按照以下步骤继续：

### 5.4.8 查询测试历史记录

☰ 导航： ▶ 天平菜单 > 📅 历史 > 🧪 测试

- 选择测试。
- ➔ 测试历史记录打开。显示每个测试的特定数据，例如日期和时间、测试类型、温度、水平状态、校验砝码ID和重量偏差。

#### 可参阅

[🔗 历史 ▶ 第73页](#)

## 5.5 校正

本节介绍如何定义和进行内部和外部校正。执行哪种类型的校正取决于定义的校正策略。

≡ 导航: ▼ 方法 >  校正

### 5.5.1 内部校正

#### 5.5.1.1 编辑"内部校正"

- 1 打开方法部分。
- 2 点击  校正。
- 3 点击  编辑。
- 4 将策略设置为内部校正。
- 5 定义校正参数。
- 6 点击  保存。

➔ 您的内部校正已编辑。

如需关于校正设置的详细信息:

可参阅

 校正设置 ▶ 第107页

#### 5.5.1.2 执行"内部校正"

- 校正策略已设置为内部校正。
- 1 打开方法部分, 点击  校正, 选择校正, 然后点击  启动 - 或 - 在称量主界面, 点击  更多然后点击开始调整。
    - ➔ 正在执行内部校正。
    - ➔ 完成校正后, 屏幕上显示校正结果的概述。
  - 2 如果要打印结果, 则点击  打印。
  - 3 点击  完成校正。
- ➔ 天平已准备就绪。

### 5.5.2 外部校正

#### 5.5.2.1 编辑"外部校正"

- 1 打开方法部分。
- 2 点击  校正。
- 3 点击  编辑。
- 4 将策略设置为外部校正。
- 5 点击  测试砝码 - 编辑测试砝码。
  - ➔ 打开对话框测试砝码 - 编辑测试砝码。

- 6 从列表中选择一個测试砝码并点击 **✓ 确定**  
- 或 -  
点击 **+** **测试砝码**，以定义一个新的测试砝码。
  - 7 定义测试砝码设置，并使用 **✓ 确定** 确认。
  - 8 点击 **✓ 保存**。
- ➔ 您的外部调整已编辑。
- 如需关于校正设置的详细信息：

#### 可参阅


[校正设置](#) ▶ 第107页

### 5.5.2.2 执行“外部校正”

在定义外部砝码之后，可执行该功能**外部校正**。

要执行校正，请使用天平附带的校准套件。根据外部砝码的大小，选择小号秤盘或大号秤盘。该示例介绍了使用小号秤盘的程序。

- 小号秤盘和防蒸发阱门已安装，请参阅[安装小号秤盘 ▶ 第43页]。
  - 打开天平。
  - 校准策略已设置为**外部校正**。
- 1 打开**方法**部分，点击 **校正**，选择校正，然后点击 **▶ 启动**  
- 或 -  
在称量主界面，点击 **⋮ 更多** 然后点击 **开始调整**。  
➔ 启动校正过程。
  - 2 确保秤盘已清空且是清洁的。随手可得：测试砝码、手套和用于操作测试砝码的适当工具。
  - 3 所有条件均满足后，点击 **✓ 确定**。
  - 4 确保秤盘已清空且防蒸发阱已关闭，然后点击 **✓ 确定**。
  - 5 选择可用的测试砝码  
- 或 -  
添加一个新的测试砝码并点击 **✓ 确定**。
  - 6 激活光栅板(1)，或按 **↓**。  
➔ 防蒸发阱门(2)打开。
  - 7 使用镊子将测试砝码(3)放置到秤盘(4)上。
  - 8 激活光栅板(1)，或按 **↓**。  
➔ 防蒸发阱门(2)关闭，调整开始。
  - 9 激活光栅板(1)，或按 **↓**。  
➔ 防蒸发阱门(2)打开。
  - 10 小心地移除测试砝码并点击 **✓ 确定**。  
➔ 校正完成，显示校正结果。
  - 11 要打印结果，点击 **🖨 打印**；要完成调整，点击 **✓ 完成**。

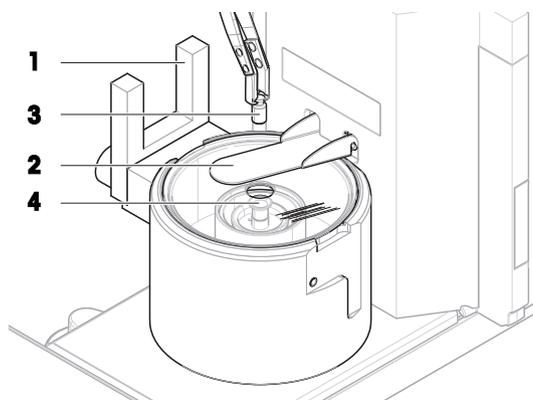

#### 可参阅

[定义单个校验砝码](#) ▶ 第41页

### 5.5.3 查询校正历史记录

☰ 导航： ▶ 天平菜单 > 📄 历史 > 📄 校正

– 选择校正。

➔ 校正历史打开。显示每次校正的特定数据，例如日期和时间、校正类型、温度、水平状态、校正触发和纠正。

可参阅

🔗 历史 ▶ 第73页

## 5.6 外围设备

### 5.6.1 打印机

打印机有助于记录您的过程和结果。可将两种类型的打印机连接至天平：

- 纸带打印机：在纸带上打印，例如，用于记录称量结果
- 标签打印机：在标签贴纸上打印，例如，用于标识样品

每种称量方法均可在任务完成时在标签或纸带上手动触发打印过程。还可以对方法的设置进行编辑，例如，将结果添加至结果列表时或任务完成时自动打印结果。在使用标签打印机时，所打印标签的模板针对每种方法单独定义。

以下各节将介绍在天平上安装和使用打印机的典型用例。其中包括两种设置组合：手动和自动打印、纸带和标签打印、任务结果和称量品结果打印，以及USB和蓝牙连接。其它设置组合也可以通过类似方式实现。



#### 注意

##### 使用不当会损坏设备

- 使用设备前，请查阅设备《用户手册》。

#### 5.6.1.1 通过USB在纸带打印机上手动打印结果

本示例描述了如何使用USB电缆安装纸带打印机。在本示例中，该方法不适用于自动打印，而是在任务完成时手动打印结果。

##### 安装和配置打印机

- 将打印机连接到电源插座并打开。
  - 将USB电缆连接到打印机。
  - 称量主界面显示在天平显示终端上。
- 1 将USB电缆连接到天平的其中一个USB-A接口。
    - ➔ 天平自动检测 USB 设备。**添加设备**出现对话框，通知用户系统已找到特定设备。
  - 2 设置USB设备名称，并点击➔ **下一步**。
  - 3 点击✔ **完成**。
    - ➔ USB设备已连接并保存到系统中。
    - ➔ 显示该设备的设置。

- 4 点击**打印机设置**。
- 5 点击**打印机类别**，然后选择**条码打印机**。
- 6 点击**✓ 保存**。

#### **信息**

某些打印机在标签或纸带上均可进行打印。在这些情况下，必须在打印机设置中指定打印机类型。如果打印机只能在标签上或只能在纸带上打印，则打印机类型自动设置。

#### **信息**

标签打印机与纸带打印机可同时连接至天平。但是，任何时候只有一种类型的打印机可处于激活状态。当连接一台新的同类型打印机时，之前激活的同类型打印机自动停用。在连接一台新打印机后，验证其他所有打印机的状态。

#### **信息**

如果USB电缆断开并重新连接，将自动检测连接情况。无需重新安装打印机。

### **打印测试页**

安装和配置打印机后，即可打印测试页。

**≡ 导航：** ▶ **天平菜单** > **⚙ 设置** > **🖨 设备/打印机**

- 打印机已连接天平。
- 1 导航至章节**🖨 设备/打印机**。
- 2 在设备列表中选择打印机。
- 3 点击操作栏中的**🖨 打印测试页**。

### **打印结果**

**≡ 导航：** ▼ **方法** > **☰ 方法列表**

- 纸带印机已连接天平。
- 1 从方法列表中选择方法。
- 2 点击▶ **开始方法**。
- 3 执行必要的操作来称量样品。
- 4 点击**🏠 完成**打开导出选项。
  - ➔ 出现 **完成任务** 对话框。
- 5 点击**手动打印结果**以在纸带打印机上打印结果。

#### **可参阅**

 **设备/打印机** ▶ 第86页

#### **5.6.1.2 通过蓝牙在标签打印机上自动打印结果**

本示例描述了如何使用蓝牙适配器安装标签打印机。在本例中，该方法的设置使得每次用户点击**添加到结果**时都会自动打印标签。



有关如何安装蓝牙适配器的更多信息，见随附安装说明。


## 安装和配置打印机

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 > 🖨 接口 > 📶 蓝牙

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 > 🖨 设备/打印机

- 将打印机连接到电源插座并打开。
- 提供蓝牙RS适配器（连接至打印机）和蓝牙USB适配器（连接至天平）。
- 蓝牙RS适配器上的开关处于位置DCE。
- 您已识别蓝牙RS适配器上的MAC地址（唯一设备地址）。
- 称量主界面显示在天平显示终端上。

1 将蓝牙USB适配器（1）连接到天平的其中一个USB-A接口（2）。

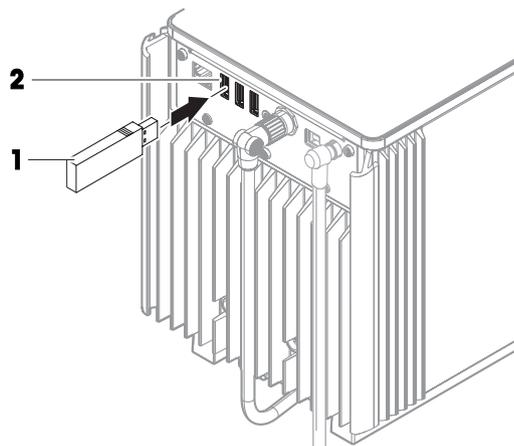

2 将蓝牙RS适配器（3）连接到打印机（4）。

- ➔ 蓝牙RS适配器上的灯开始闪烁。

3 导航至章节📶 蓝牙。

4 将**激活**设置为**激活**。

5 点击✔ **保存**。

6 导航至章节🖨 设备/打印机。

7 点击+ **添加设备**。

- ➔ 对话框打开**添加设备**。

8 选择**蓝牙连接**并点击➔ **下一步**。

- ➔ **正在搜索设备...**消息出现。
- ➔ 将显示所有可用蓝牙设备的MAC地址。

9 从列表中选择蓝牙RS适配器的MAC地址，然后点击➔ **下一步**。

10 检查**PIN码**是否正确：[Mettler-Toledo](#)。

11 点击➔ **下一步**，以确认蓝牙连接。

- ➔ 天平正在将其蓝牙USB适配器与打印机的蓝牙RS适配器配对。
- ➔ 系统通知用户已找到设备。

12 设置USB设备名称，并点击➔ **下一步**。


13 点击✔ **完成**。

- ➔ USB设备已连接并保存到系统中。
- ➔ 显示该设备的设置。

14 点击**打印机设置**。

15 点击**打印机类别**，然后选择**标签打印机**。

16 点击✔ **保存**。

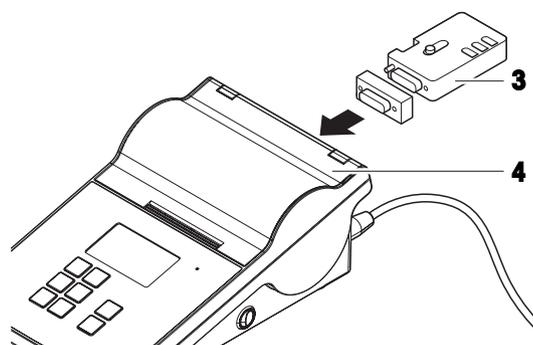

### 信息

设置蓝牙连接时，天平将与蓝牙RS适配器配对，但不会与已连接的打印机配对。当用户将相同的蓝牙RS适配器连接到其他打印机时，用户必须从设备列表中移除已配置的打印机，并添加这台新的打印机。

### 信息

某些打印机在标签或纸带上均可进行打印。在这些情况下，必须在打印机设置中指定打印机类型。如果打印机只能在标签上或只能在纸带上打印，则打印机类型自动设置。

### 信息

标签打印机与纸带打印机可同时连接至天平。但是，任何时候只有一种类型的打印机可处于激活状态。当连接一台新的同类型打印机时，之前激活的同类型打印机自动停用。在连接一台新打印机后，验证其他所有打印机的状态。

### 信息

如果USB适配器在从天平上移除后再次插入，将会自动检测蓝牙连接。该过程最多需要30秒。

## 打印测试页

安装和配置打印机后，即可打印测试页。

**≡ 导航：** ▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 > 🖨 设备/打印机

- 打印机已连接天平。
- 1 导航至章节  设备/打印机。
- 2 在设备列表中选择打印机。
- 3 点击操作栏中的  打印测试页。

## 编辑方法设置

**≡ 导航：** ▼ 方法 > 📄 方法列表

- 1 从方法列表中选择方法。
- 2 点击  编辑。
- 3 点击  打印/导出。
- 4 点击  为称量品打印标签。
- 5 将自动打印出称量品的标签设置为激活。
- 6 从列表中选择所需模板：**使用的模板**。
- 7 点击 **字段设置**。
- 8 自定义每个字段的内容。
- 9 点击  确定。
- 10 点击  保存。

## 打印结果

**≡ 导航：** ▼ 方法 > 📄 方法列表

- 标签打印机已连接天平。
- 存在带有打印标签所需模板的方法。
- 1 从方法列表选择方法。
- 2 点击  开始方法。

- 3 执行必要的操作来称量样品。
- 4 点击**+** 添加到结果。
  - ➔ 该称量品的标签自动打印在标签打印机上。

#### 可参阅

- 🔗 蓝牙 ▶ 第86页
- 🔗 设备/打印机 ▶ 第86页

## 5.6.2 RFID阅读器

智能芯片是可贴在样品容器底部的RFID标签。它们用于存储样品相关信息。它们通常与方法类型**滴定**一起使用。智能芯片的内容可使用RFID阅读器（如EasyScan USB或SmartScan）进行访问和编辑。



### 注意

#### 使用不当会损坏设备

- 使用设备前，请查阅设备《用户手册》。

#### 可参阅

- 🔗 设备/打印机 ▶ 第86页

### 5.6.2.1 使用EasyScan USB从RFID智能芯片读取数据

本示例描述了如何使用EasyScan USB从智能芯片读取数据。

#### 安装EasyScan USB


- 准备好EasyScan USB。
  - 准备好USB-A至USB-B连接线缆。
  - 称量主界面显示在天平显示终端上。
- 1 将USB电缆连接至天平上的USB-A端口。
  - 2 将USB电缆连接至RFID阅读器的USB-B端口。
    - ➔ 天平自动检测 USB 设备。**添加设备**出现对话框，通知用户系统已找到特定设备。
  - 3 设置USB设备名称，并点击**→ 下一步**。
  - 4 点击**✓ 完成**。
    - ➔ USB设备已连接并保存到系统中。
    - ➔ 显示该设备的设置。
  - 5 点击**✓ 保存**。

#### 测试RFID阅读器

☰ **导航：** ▶ **天平菜单** > **⚙ 设置** > **🖨 设备/打印机**

- RFID阅读器已安装在天平上。
  - 准备好智能芯片RFID标签。
- 1 导航至章节**🖨 设备/打印机**。
  - 2 从设备和打印机列表中选择设备。

- 3 点击  **测试设备**。
  - ➔ 打开对话框**测试RFID设备**。
- 4 扫描RFID阅读器上的RFID标签。
  - ➔ 如果RFID阅读器工作正常，将会出现消息**成功检测到RFID标签**。
  - ➔ RFID阅读器工作正常。

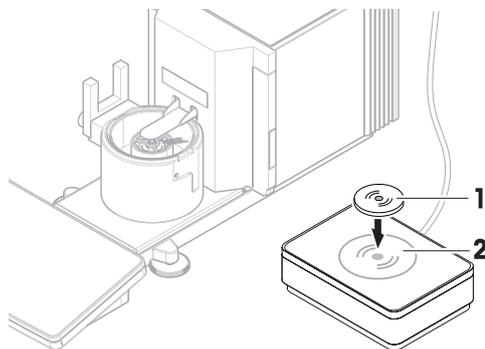

### 从智能芯片读取数据

**≡ 导航：** ▶ **天平菜单 > 维护 > 格式化RFID**

- RFID阅读器已安装在天平上。
  - 准备好智能芯片RFID标签。
- 1 导航至章节 **格式化RFID**。
  - 2 点击 **格式化RFID**。
    - ➔ 打开对话框**格式化RFID标签**。
  - 3 将RFID标签放到RFID阅读器上。
    - ➔ 向导程序会询问**是否要格式化RFID标签并删除所有数据？**
    - ➔ 在对话框中，您可以读取所有存储数据。
  - 4 要格式化RFID标签，请点击**→格式**。要取消该对话框，点击**✕取消**。

#### 5.6.2.2 使用EasyScan格式化RFID智能芯片

本示例描述了如何使用SmartScan格式化智能芯片，即删除所有数据。  
本示例描述了如何使用EasyScan格式化智能芯片，即删除所有数据。

#### 格式化智能芯片

**≡ 导航：** ▶ **天平菜单 > 维护 > 格式化RFID**

- RFID阅读器已安装在天平上。
  - 准备好智能芯片RFID标签。
- 1 导航至章节 **格式化RFID**。
  - 2 点击 **格式化RFID**。
    - ➔ 打开对话框**格式化RFID标签**。
  - 3 将RFID标签放到RFID阅读器上。
    - ➔ 向导程序会询问**是否要格式化RFID标签并删除所有数据？**
  - 4 要格式化RFID标签，请点击**→格式**。
    - ➔ RFID标签已格式化。

#### 5.6.3 脚踏开关和ErgoSens

脚踏开关和ErgoSens为选配件，让您无需使用终端即可在天平上进行操作。以下各节将介绍可以使用脚踏开关或ErgoSens执行的操作示例。



## 注意

### 使用不当会损坏设备

- 使用设备前，请查阅设备《用户手册》。

#### 5.6.3.1 使用ErgoSens对天平执行去皮功能

本示例说明了如何安装和配置USB ErgoSens，以对天平执行去皮功能。

##### 安装和配置ErgoSens

- 准备好ErgoSens。
  - 称量主界面显示在天平显示终端上。
- 1 将USB电缆连接到天平的其中一个USB-A接口。
    - ➔ 天平自动检测 USB 设备。添加设备出现对话框，通知用户系统已找到特定设备。
  - 2 设置USB设备名称，并点击➔ 下一步。
  - 3 点击✔ 完成。
    - ➔ USB设备已连接并保存到系统中。
    - ➔ 显示该设备的设置。
  - 4 点击函数，然后选择皮重。
  - 5 点击✔ 保存。
    - ➔ ErgoSens已准备好对天平执行去皮功能。

##### 可参阅

[设备/打印机](#) ▶ 第86页

#### 5.6.4 编辑设备设置

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 > 🖨 设备/打印机

- 1 导航至章节🖨 设备/打印机。
  - ➔ 将显示设备列表，其中显示了每个设备的连接状态和连接类型。
- 2 从设备和打印机列表中选择设备。
  - ➔ 显示设备的详细信息。
- 3 要更改设备名称，点击名称，输入名称并点击✔。
- 4 某些设备具有附加的可编辑设置。点击这些设置进行编辑。
- 5 保存设置。

#### 5.6.5 删除设备

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 > 🖨 设备/打印机

- 1 导航至章节🖨 设备/打印机。
  - ➔ 将显示设备列表，其中显示了每个设备的连接状态和连接类型。
- 2 从设备和打印机列表中选择设备。
- 3 点击🗑 移除装置。

- ➔ 将出现一条消息，询问您是否确认要删除设备。
- 4 如果确定要删除，点击**✓ 确定**。如果要取消删除对话框，则点击**✕ 取消**。
- ➔ 设备已删除。

## 5.7 通过服务进行远程控制

### 5.7.1 LabX服务

要启用LabX与仪器之间的通信，必须确保仪器中的适当设置与LabX中的设置一致。每当进行连接和启动任务时，LabX将仪器上的日期和时间同LabX服务器同步。当仪器连接时，连接仪器上的用户界面语言会变更为LabX装置上目前安装的语言。



要在计算机上安装LabX，以及了解有关LabX的更多信息，请查阅LabX参考手册（RM）。

#### 信息

一旦LabX与天平之间建立连接，天平终端将由LabX控制。始终可以在终端上直接切换至手动模式。

#### 可参阅

 LabX/服务 ▶ 第88页

#### 5.7.1.1 通过USB连接使用LabX

要建立此连接，必须在计算机上安装USB驱动程序。驱动程序可在线获取：

▶ [www.mt.com/labweighing-software-download](http://www.mt.com/labweighing-software-download)

##### 将天平连接至计算机

- 准备好USB-A至USB-B连接线缆。
- 1 将USB电缆连接至天平的USB-B端口。
- 2 将USB电缆连接至计算机上的USB-A端口。

##### 在天平上配置服务

≡ 导航：▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 >  LabX/服务

- 1 导航至章节  LabX/服务。
- 2 将LabX服务设置为**USB**。
- 3 点击**✓ 保存**。

#### 5.7.1.2 通过以太网连接使用LabX

##### 将天平连接至网络

≡ 导航：▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 >  接口

- 准备好以太网电缆。
- 1 将以太网电缆连接至天平的以太网端口。
- 2 将以太网电缆的另一端连接至本地网络。
- 3 导航至章节  接口。
- 4 点击**以太网**。

- 5 保留以太网连接的设置。以后建立连接时可能需要此信息。
- 6 点击✓ 保存。

### 在天平上配置服务

≡ 导航：▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 > 🌐 LabX/服务

- 通过以太网将天平连接至网络。
- 1 导航至章节🌐 LabX/服务。
  - 2 将LabX服务设置为网络。
  - 3 记录该端口号。以后建立连接时可能需要此信息。
  - 4 点击✓ 保存。

## 5.7.2 MT-SICS服务

所有XPR和XSR天平均可集成到网络中，并且可以配置为使用MT-SICS（METTLER TOLEDO Standard Interface Command Set）与计算机通信。可用命令视天平的功能而定。

有关详情，请联系当地METTLER TOLEDO代表。

与XPR和XSR天平的MT-SICS相关的完整文档可在线获取。

▶ [www.mt.com/labweighing-software-download](http://www.mt.com/labweighing-software-download)

### 可参阅

🔗 LabX/服务 ▶ 第88页

### 5.7.2.1 通过USB连接使用MT-SICS

本示例描述了如何在天平和计算机之间建立直接USB连接。然后，可使用计算机控制天平，并使用MT-SICS的命令接收数据。

要建立此连接，必须在计算机上安装USB驱动程序。驱动程序可在线获取：

▶ [www.mt.com/labweighing-software-download](http://www.mt.com/labweighing-software-download)

### 将天平连接至计算机

- 准备好USB-A至USB-B连接线缆。
- 1 将USB电缆连接至天平的USB-B端口。
  - 2 将USB电缆连接至计算机上的USB-A端口。

### 在天平上配置服务

≡ 导航：▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 > 🌐 LabX/服务

- 1 导航至章节🌐 LabX/服务。
- 2 将MT-SICS设置为USB。
- 3 点击✓ 保存。

### 配置计算机

- USB驱动程序已安装在计算机上。
  - 终端程序已安装完成并在计算机上运行。
- 1 为终端程序提供必要的连接设置。
  - 2 通过向天平发送命令测试连接，例如，发送s以从天平检索稳定重量。

- ➔ 如果终端程序收到带有重量、日期和时间的字符串，则说明已成功建立连接。
- ➔ 如果终端程序未收到响应，请检查连接设置。

### 5.7.2.2 通过以太网连接使用MT-SICS

本示例描述了如何通过本地网络在天平和计算机之间建立连接。然后，可使用计算机控制天平，并使用MT-SICS的命令接收数据。

#### 将天平连接至网络

☰ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙️ 设置 > 🌐 接口

- 准备好以太网电缆。
  - 1 将以太网电缆连接至天平的以太网端口。
  - 2 将以太网电缆的另一端连接至本地网络。
  - 3 导航至章节 🌐 接口。
  - 4 点击以太网。
  - 5 保留以太网连接的设置。以后建立连接时可能需要此信息。
  - 6 点击 ✓ 保存。

#### 在天平上配置服务

☰ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙️ 设置 > 🌐 LabX/服务

- 通过以太网将天平连接至网络。
  - 1 导航至章节 🌐 LabX/服务。
  - 2 将MT-SICS设置为网络。
    - ➔ 端口号会显示在设置列表中。
  - 3 记录该端口号。以后建立连接时可能需要此信息。
  - 4 点击 ✓ 保存。

#### 配置计算机

- 终端程序已安装完成并在计算机上运行。
  - 1 为终端程序提供必要的连接设置。
    - ➔ 计算机连接到与天平相同的网络和子网。
  - 2 通过向天平发送命令测试连接，例如，发送s以从天平检索稳定重量。
    - ➔ 如果终端程序收到带有重量、日期和时间的字符串，则说明已成功建立连接。
    - ➔ 如果终端程序未收到响应，请检查连接设置。

#### i 信息

如需更多信息，请联系网络管理员。

### 5.7.3 Web服务

Web服务允许用户使用Web浏览器发送命令，以控制和传输天平数据。

#### 将天平连接至网络

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙️ 设置 > 🌐 接口

- 准备好以太网电缆。
- 1 将以太网电缆连接至天平的以太网端口。
- 2 将以太网电缆的另一端连接至本地网络。
- 3 导航至章节 🌐 接口。
- 4 点击以太网。
- 5 保留以太网连接的设置。以后建立连接时可能需要此信息。
- 6 点击 ✓ 保存。

#### 在天平上配置服务

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙️ 设置 > 🌐 LabX/服务

- 通过以太网将天平连接至网络。
- 计算机和天平连接到同一网络。
- 天平带有Web浏览器。
- 1 导航至章节 🌐 LabX/服务。
- 2 激活和配置服务。
- 3 点击 ✓ 保存。



Web服务文档和相关示例可在线获取。

▶ [www.mt.com/labweighing-software-download](http://www.mt.com/labweighing-software-download)

#### i 信息

如需更多信息，请联系网络管理员。

#### 导出WSDL定义文件

WSDL（Web服务描述语言）文件描述了Web服务的功能。WSDL文件可按以下方式导出。

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙️ 设置 > 🗣️ 天平 > ⚙️ 常规

- 1 导航至 ⚙️ 常规。
- 2 点击… 更多。
- 3 点击**导出Web Service WSDL文件**
  - ➔ 显示可用目标位置列表，其中包括文件服务器和连接至天平的任何USB存储设备。
- 4 选择要存储数据的目标设备。
- 5 点击➔ 下一步。
  - ➔ 如果导出成功，显示屏会显示✔️以及文件名称和目标文件夹。

#### 可参阅

🔗 LabX/服务 ▶ 第88页

## 5.8 数据管理

### 5.8.1 导出结果

本示例描述了如何在任务结束时将结果导出至文件服务器。使用USB存储设备时，可以遵循类似的导出程序。

#### 连接至文件服务器

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 > 🌐 LabX/服务

- 1 导航至章节 🌐 LabX/服务。
- 2 将文件服务器设置为激活。
- 3 点击文件服务器配置。
- 4 点击服务器名称并输入服务器名称。
- 5 点击共享名称并输入您想使用的共享文件夹的路径。
- 6 点击操作栏中的凭证。
  - ➔ 出现 设置文件服务器凭证 对话框。
- 7 填写您的凭据（域名、用户名和密码）并点击 ✓ 确定。
  - ➔ 该凭据保存在天平上。
- 8 点击 ✓ 确定以建立与文件服务器的连接。

#### 导出XSD文件

称量结果以XML文件导出。XML文件的要素描述在XSD（XML Schema Definition）文件中提供。XSD文件可按以下方式导出。

#### 信息

如果用XSD文件进行验证，则XML文件中的版本必须与XSD架构的版本一致。

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 > 🏠 天平 > 🌐 常规

- 1 导航至 🌐 常规。
- 2 点击… 更多。
- 3 点击把结果导出成XSD文件。
  - ➔ 显示可用目标位置列表，其中包括文件服务器和连接至天平的任何USB存储设备。
- 4 选择要存储数据的目标设备。
- 5 点击→ 下一步。
  - ➔ 如果导出成功，显示屏会显示🟢以及目标文件夹的名称。

#### 导出称量结果

≡ 导航： ▼ 方法 > 📄 方法列表

- 已建立以太网连接。
  - 已配置文件服务器访问权限。
- 1 从方法列表中选择方法。
  - 2 点击▶ 开始方法。
  - 3 执行必要的操作来称量样品。
  - 4 点击🏠 完成打开导出选项。

- ➔ 出现 **完成任务** 对话框。
- 5 点击**手动导出结果**以导出结果。
  - ➔ 显示可用目标位置列表，其中包括文件服务器和连接至天平的任何USB存储设备。
- 6 选择**文件服务器**。
- 7 点击➔ **下一步**。
  - ➔ 系统检查文件服务器连接的凭据。
  - ➔ 结果导出至文件服务器。
- 8 点击**✓ 完成**。
- ➔ 完成任务后，将结果从**结果列表**中删除。

#### 可参阅

🔗 LabX/服务 ▶ 第88页

## 5.8.2 将单个结果发送至计算机

天平可以通过USB连接将称量结果发送至计算机。此功能可用于将结果发送至Excel工作表、文本文件或MT-SICS。在模式**HID**（人机交互设备）中使用**HID**时，结果会发送至光标所在的计算机，如同键盘输入一样（也称为“拖放光标”）。

本示例描述了如何使用功能**HID**将**一般称重**类方法的称量结果直接发送到计算机上的Excel文件中。

### 将天平连接至计算机

- 准备好USB-A至USB-B连接线缆。
- 1 将USB电缆连接至天平的USB-B端口。
- 2 将USB电缆连接至计算机上的USB-A端口。

### 配置天平

☰ 导航： ▶ **天平菜单** > ⚙️ **设置** > 🗣️ **天平** > 📊 **称量 / 质量**

- 1 导航至章节📊 **称量 / 质量**。
- 2 点击**自动重量值输出**。
- 3 点击**输出模式**，然后选择**结果**。
- 4 点击**目标**，然后选择**HID**。
- 5 查看**自动重量值输出**部分的其他设置，以自定义输出。例如，将日期和时间添加到每个称量结果中。

#### 📘 信息

正确的设置很大程度上取决于您的应用。例如，设置Excel工作表时，用字符**TAB**分隔的值将放置在单独的单元格中。

### 编辑方法设置

☰ 导航： ▼ **方法** > 📄 **方法列表**

- 方法**一般称重**已存在。
- 1 从**方法列表**选择方法。
- 2 点击✍️ **编辑**。
- 3 点击🖨️ **打印/导出**。
- 4 点击**数据条输出结果和数据导出**。

- 5 将**重量值**设置为**激活**。
- 6 点击**✓ 确定**。
- 7 点击**✓ 保存**。
  - ➔ 将该方法设置当点击**添加到结果**时，将结果发送至计算机。

### 运行方法

- USB驱动程序已安装在计算机上。
  - 1 从**方法列表**选择方法。
  - 2 点击**▶ 开始方法**。
  - 3 执行必要的操作来称量样品。
  - 4 打开Excel工作表，将光标放在第一个目标单元格中，例如"A1"。
  - 5 点击**+** **添加到结果**。
    - ➔ 称重结果已保存至**结果列表**。
    - ➔ 称量结果存储在Excel工作表的单元格"A1"中。
    - ➔ 如果将字符**TAB**用作分隔符，则其他称量参数将存储在"B1"、"C1"等单元格中。
    - ➔ 如果使用字符**Enter**标记行尾，光标会出现在"A2"单元格中。

### 5.8.3 导出和导入设置

天平设置可以导出和导入。将数据从一台天平转移到另一台天平上是很有用的，例如，可在数台天平上使用相同的方法。在更新软件前，将天平设置存储备份也是一个很好的做法。

以下数据可导入和导出：

- **天平设置**
  - 在导入这些设置时，天平的GWP状态可能会改变（**GWP认证模式**）。
  - 天平可能提示重启。
- **用户管理**
  - 在导入这些设置时，天平上的现有设置将被替换。
- **方法**
  - 在导入方法时，可选择导入所有方法还是仅导入选定方法。
  - 如果要导入的方法与现有方法的名称相同，可以选择是否要覆盖现有方法。
- **测试和重量**
  - 在导入这些设置时，天平上的所有现有测试和测试砝码将被擦除并替换为导入的数据。

可通过USB存储设备传输数据。对于XPR天平，也可通过文件服务器传输数据。



#### 注意

#### 数据导入可能导致数据丢失

导入数据可在未发出警告的情况下删除用户应用程序数据。

### 5.8.3.1 在天平之间传输测试砝码设置

本示例展示了如何从一台天平导出测试砝码设置，并将其导入到另一台天平。如果您使用相同的校准砝码在多台天平上执行测试，则此程序尤其有用。通过 USB 存储设备传输数据。

#### 导出数据与设置

☰ 导航： ▶ 天平菜单 > ☰ 维护 > ☰ 导入/导出

- 将USB存储设备连接至天平。
- 1 导航至章节☰ 导入/导出。
  - ➔ 打开对话框**导入/导出**。
- 2 选择☰ **导出数据和设置**并点击➔ **下一步**。
  - ➔ 打开对话框**导出数据和设置**。
- 3 停用除**测试和重量**以外的所有数据类型。
- 4 点击✓ **导出**。
  - ➔ 显示可用的USB存储设备列表。
- 5 选择目标USB存储设备以存储数据。
- 6 点击➔ **下一步**。
  - ➔ 系统将数据导出至USB存储设备。
  - ➔ 如果导出成功，显示屏会显示☑以及文件名称和目标文件夹。
- 7 点击✕ **关闭**完成过程。

#### 导入数据和设置

☰ 导航： ▶ 天平菜单 > ☰ 维护 > ☰ 导入/导出

- 将包含待导入数据的USB存储设备连接至天平。
- 1 导航至章节☰ 导入/导出。
  - ➔ 打开对话框**导入/导出**。
- 2 选择☰ **导入数据和设置**并点击➔ **下一步**。
  - ➔ 显示可用的USB存储设备列表。
- 3 选择已包含待导入数据的USB设备。
- 4 点击➔ **下一步**。
- 5 选择要导入的文件。
- 6 点击➔ **下一步**。
- 7 要仅导入测试砝码，请选择数据类型**测试砝码**。
- 8 点击✓ **导入**。
  - ➔ 系统从USB存储设备导入数据。
  - ➔ 如果导入成功，消息**数据和设置的导入工作已经被执行**出现。
- 9 点击✕ **关闭**完成过程。

## 5.9 用户管理



### 注意

丢失密码或ID导致的数据丢失。用户名

没有用户名或密码不能访问受保护菜单区。

- 注释用户名和密码并将其保存在安全位置。

### 5.9.1 激活用户管理

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 > 🗣 天平 > ⚙ 常规 > 用户管理

用户管理功能在出厂设置中禁用。要激活用户管理，请按照以下步骤操作：

- 1 点击 然后选择**激活**。
  - ➔ 打开对话框**激活用户管理**。
- 2 点击➔ **下一步**。
  - ➔ 对话框 **设置管理员密码(可选)**打开。
- 3 点击 **新密码** 并输入新密码。
- 4 再次确认新密码并点击 **确定**。
  - ➔ 对话框关闭。
- 5 在 **常规**部分确认已激活的用户管理，点击 **确定**
  - ➔ **用户管理**处于活动状态。每次系统启动时，登录对话框都会打开。

### 5.9.2 禁用用户管理

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 > 🗣 天平 > ⚙ 常规 > 用户管理

- 1 点击 然后选择**非活动**。
  - ➔ 打开对话框**取消激活用户管理**。
- 2 点击➔ **下一步**。
  - ➔ 对话框 **设置取消锁定密码**打开。
- 3 点击 **新密码** 并输入新密码。
- 4 再次确认新密码并点击 。- ➔ 对话框关闭。
- 5 点击 **确定**以确认。
  - ➔ 用户管理已禁用。

### 5.9.3 管理用户和用户组

设置用户只有在用户管理设置为**激活**时可见。

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > 👤 用户

#### 打印用户列表

通过点击 **打印全部**可打印所有用户及用户组的概述。

可参阅

 激活用户管理 ▶ 第66页

### 5.9.3.1 创建新用户

☰ 导航： ▶ 天平菜单 >  用户 >  用户

- 1 点击操作栏中的 **+** 新建用户。
- 2 定义新用户的值。
- 3 如要定义用户配置文件密码，请点击操作栏内的  更改密码。
- 4 点击**新密码**。
  - ➔ 键盘对话框打开。
- 5 定义密码。
- 6 点击**确认新密码**并填入定义的密码。
- 7 点击**✓**以关闭键盘对话框。
- 8 点击**✓ 确定**确认定义的密码。
  - ➔ 对话框**用户名**打开。
- 9 点击**✓ 确定**确认定义的用户配置文件。
  - ➔ 已创建用户。列表上出现了新的用户。

### 5.9.3.2 创建新组

☰ 导航： ▶ 天平菜单 >  用户 >  组

#### 信息

只有适当权限的用户才可访问此区域。

- 1 点击**+** 新建组。
  - ➔ 对话框打开。
- 2 定义组的属性。
- 3 点击**✓ 确定**。
  - ➔ 已创建组，系统返回定义的组的列表。

### 5.9.3.3 删除用户或用户组

删除操作的要求：

- 您已以管理员的身份登录。

☰ 导航： ▶ 天平菜单 >  用户 >  用户

- 1 选择要删除的**用户名**用户。
  - ➔ 用户管理对话框打开。
- 2 点击操作栏中的  删除。
  - ➔ 打开对话框**删除用户**。
- 3 要删除用户，点击**✓ 确定**。
  - ➔ 该用户已不可撤销地删除。

## 5.10 允差配置文件

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 > 磅 天平 > Q<sub>g</sub> 称量 / 质量 > 允差配置文件

### 创建允差配置文件

- 1 单击 **+** 新建创建新的配置文件。
- 2 定义配置文件的设置。
- 3 定义所有设置后，单击 **✓ 确定**。
  - ➔ 系统返回配置文件列表，列表上出现新的配置文件。

通过点击现有的配置文件更改其设置，可删除配置文件或将其设为默认值。可创建几个配置文件。必须选择默认配置文件。

如果对默认允差配置文件进行更改，则日常测试的状态将设定为**未执行**。

## 5.11 密码保护和天平重置

### 5.11.1 密码保护

如果用户管理已激活，则每个用户都有一个单独的密码。

- 任何登录的用户都可以更改自己的密码。请参阅[更改密码 ▶ 第68页]。
- 拥有配置用户管理权限的用户可以更改任何用户的密码。请参阅[更改密码 ▶ 第68页]。
- 如果拥有配置用户管理权限的用户忘记了密码（并且没有其他用户可以更改密码），则可以申请重置密码。请参阅[申请重置密码 ▶ 第69页]

#### 信息

如果参数**密码重置**设置为**不允许**，则需要由服务技术人员重置天平。

如果用户管理处于非活动状态，则可以生成密码以锁定整个天平。请参阅[创建解锁密码 ▶ 第69页]。

#### 5.11.1.1 更改密码

任何用户都可以更改自己的密码。另外，拥有配置用户管理权限的用户可以更改其他用户的密码。

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > 👤 用户 > 👤 用户

- 1 为应更换密码的用户选择**用户名**。
  - ➔ 用户管理对话框打开。
- 2 点击操作栏中的  **更改密码**。
  - ➔ 打开对话框**更改密码**。
- 3 输入新密码并确认。

#### 信息

任何密码均有效。

- 4 单击 **✓ 确定**。
  - ➔ 密码已更改。

### 5.11.1.2 申请重置密码

如果拥有配置用户管理权限的用户忘记了密码，则可以申请重置密码。

- 天平登录对话框打开。
  - 1 选择需要重置密码的用户。该用户需拥有配置用户管理权限。
  - 2 点击…更多。
    - ➔ 打开对话框更多。
  - 3 点击🔄请求重置密码。
  - 4 打开对话框请求重置密码。
  - 5 记下服务代码并点击📧服务请求。
    - ➔ 显示您的METTLER TOLEDO服务代表相关信息。
  - 6 通过电话或电子邮件联系您的METTLER TOLEDO服务代表。
    - ➔ 您将获得一个8位字符的重置密码，您可以使用该密码登录一次。
  - 7 使用重置密码登录并选择新密码。

### 5.11.1.3 创建解锁密码

如果用户管理处于非活动状态，则仍可使用称为解锁密码的唯一密码来锁定天平。首先需要生成此密码，并且需要提供该密码以锁定和解锁天平。

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙️ 设置 > 🏠 天平 > ⚙️ 常规

- 1 如要创建解锁密码，请点击操作栏内的🔒取消锁定密码。
  - ➔ 打开对话框设置取消锁定密码。
- 2 设置一个新密码，确认并点击✓确定。
- 3 在对话框⚙️常规中，点击✓保存和✓确定。
  - ➔ 解锁密码已创建。

## 5.11.2 登录和退出

如果用户管理已激活，则用户需要登录才能使用天平。

### 5.11.2.1 登录

- 天平登录对话框打开。
  - 1 选择用户并输入密码。
  - 2 点击👤登录。
    - ➔ 您已经登录，您的用户名显示在称量主界面上。

### 5.11.2.2 退出

导航： ▶ 天平菜单 > 👤退出/锁定天平

- 点击👤注销。
  - ➔ 现在已退出。

### 5.11.3 锁定和解锁天平

锁定是指关闭天平。此类"完全锁定"背后的原因有很多。如果天平存在缺陷或称重质量下降，则用户可完全锁定天平。

如果用户管理已激活，则拥有相关权限的用户可锁定天平。

如果用户管理处于非活动状态，则仍可锁定天平以阻止对天平的进一步使用。如果未设置解锁密码，则可以在无密码的情况下锁定和解锁天平。如果已设置解锁密码，则只能使用此密码锁定和解锁天平。请参阅[创建解锁密码 ▶ 第69页]。

#### 5.11.3.1 锁定天平

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > 🔒 锁定

- 1 要锁定天平，点击 🔒 锁定天平。  
➔ 打开对话框锁定天平。
- 2 点击➔ 下一步。
- 3 输入解锁密码并点击 ✓ 锁定天平。  
➔ 天平已锁定且出现锁定屏幕。

#### 5.11.3.2 解锁天平

- 天平被锁定且锁定屏幕打开。
- 1 点击 🚫 取消锁定天平。
  - 2 若适用的话，输入解锁密码。
  - 3 点击 ✓ 取消锁定天平以确认。  
点击 ✕ 取消可显示称量主界面，但天平仍为锁定状态且只能编辑有限的几个设置。  
➔ 天平已解锁并出现称量主界面。

### 5.11.4 重置天平

当用户管理处于活动状态时，只有具有适当权限的用户才能重置天平。

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙️ 维护 > ↺ 重置



#### 注意

##### 复位将导致数据丢失

复位天平将删除用户应用数据并将用户配置设回出厂状态。

- 1 要删除变更历史数据和测试历史数据及校正历史数据，请激活选项还会删除变更、测试和校正历史。
- 2 点击➔ 下一步。  
➔ 窗口重置天平打开并警告天平重置将丢失某些数据。
- 3 点击 ↺ 重置天平。  
➔ 天平软件将以出厂状态重新启动。Alibi内存设置与Alibi条目保持不变。

## 5.12 自动加样

自动加样方法（即**自动加样**和**自动溶液制备**）只能在XPR分析自动天平上执行。但是，与RFID阅读器相连的任何XPR天平可用于读取/编辑任何加样头中的数据。

### 5.12.1 管理加样头数据

每个加样头均带有RFID标签，可用于与仪器交换数据。您可以取下加样头，然后将其插入另一个数据立即可用的加样模块或液体模块。

#### 信息

加样头RFID标签上的数据也可由任何配备外部RFID读取器的XPR天平管理。

**导航：** ▼ 方法 >  手动操作 >  管理加样头数据

#### 编辑加样头数据

- 1 点击  管理加样头数据。
  - ➔ 对话框打开，里面显示加样头数据。
- 2 点击  编辑以编辑连接的加样头的的数据。
- 3 点击  确定以保存数据。

#### 复制加样头数据

使用此功能可以将存储在一个加样头的的数据复制到另一个加样头。不必在含有相同或相似物质的新加样头中重新输入所有所需的数据。

- 将要复制其数据的第一个加样头连接到加样模块或液体模块。
- 将用于保存数据的第二个加样头现已可用。

- 1 点击  管理加样头数据。
  - ➔ 对话框打开，里面显示加样头数据。
- 2 点击  复制以复制连接的加样头的的数据。
- 3 请遵照向导说明。

#### 加样头数据的可用字段

根据加样头的类型，以下数据存储存储在RFID标签中。

参数	说明	数值
物质	指定物质名称。	文本（0...20个字符）
批次ID	定义批次标识。	文本（1...15个字符）
加样前确认失效期	定义是否在加样前验证失效日期。	激活   非活动*
失效期	指定物质的失效日期。	日期
设定填充日期	定义是否必须指定填充日期。	激活   非活动*
注入日期	指定加样头填充日期。	日期
ID 1字段标签... ID 3字段标签	定义用户定义字段的标签。	文本（0...10个字符）
ID 1值...ID 3值	定义用户定义字段的值。	文本（0...15个字符）
摩尔质量	定义物质的摩尔质量。	数字(1...10000 g/mol)

纯度	定义物质的纯度。	数字(0.001...100%)
密度	定义液体密度。 此字段仅适用于液体加样头。	数字(1 g/ml*   0.01... 10 g/ml)
加样前核实数量	定义是否在加样之前验证加样头中的剩余量。	激活   非活动*
剩余数量	加样头中物质的残留量。 填充加样头时，在此字段中插入该物质的重量。要使用秤盘上的重量，请点击  。	数字(0.01...999999 mg)
加样前核实剂量限值	定义在加样前是否已验证加样头的剂量限值。 此字段仅适用于粉末加样头。	激活*   非活动
剩余剂量	显示在到达 <b>剂量限值</b> 之前，此加样头仍可用的加样操作次数。 <b>剩余剂量</b> 根据 <b>剂量限值</b> 和 <b>总剂量数</b> 计算得出。 此字段仅适用于粉末加样头。只有在将 <b>加样前核实剂量限值</b> 设置为 <b>激活</b> 后才可用。	数字
剂量限值	指定此加样头的最大加样操作次数。 此字段仅适用于粉末加样头。	数字(250*   0... 50000)
总剂量数	显示到目前为止，使用此加样头执行的加样操作次数。 此字段仅适用于粉末加样头。只有在将 <b>加样前核实剂量限值</b> 设置为 <b>激活</b> 后才可用。	数字
加样时轻拍	加样期间启动轻击锤的自动开始敲击功能。 注意，轻敲可能会导致某些粉末产生压实效果。 此字段仅适用于粉末加样头。	激活*   非活动
加样前轻拍	每次加样前启动轻击锤的自动开始敲击功能。 注意，轻敲可能会导致某些粉末产生压实效果。 此字段仅适用于粉末加样头。	激活   非活动*
泵压	定义液体加样操作的泵压。 此字段仅适用于液体加样头。	0.3   0.4   0.5 bar*
加样头类型	显示加样头的类型。	文本
加样头ID	显示加样头的唯一ID。	文本

\* 出厂设置

## 5.12.2 更改泵压力

可以根据使用的液体和加样头来调节泵压。泵压保存为加样头的设置，请参阅[管理加样头数据 ▶ 第71页]。

## 6 软件描述

### 6.1 天平菜单设置

天平菜单包含有常规设置和信息。要打开天平菜单章节，请点击屏幕左侧带有▶符号的选项卡。天平菜单节分为下列小节。

-  水平调节向导，参见[水平调节向导 ▶ 第73页]
-  历史，请参阅[历史 ▶ 第73页]
-  天平信息，参见[天平信息 ▶ 第75页]
-  用户（仅会在激活用户管理时显示），参见[用户 ▶ 第75页]
-  设置，请参阅[设置 ▶ 第78页]
-  维护，参见保养

#### 6.1.1 水平调节向导

准确的水平和稳定安装是获得可重复且精确的称量结果的必要条件。借助 水平调节向导 可将天平调平。

≡ 导航： ▶ 天平菜单 >  水平调节向导

 信息

在调平天平之后，必须执行内部校正。

可参阅

 调节天平水平 ▶ 第29页

#### 6.1.2 历史

天平会永久性记录在历史部分进行过的测试和校正

≡ 导航： ▶ 天平菜单 >  历史

历史节分为下列小节。

-  校正
-  测试
-  服务
-  变更（仅会在变更历史记录激活时显示）

##### 6.1.2.1 校正

≡ 导航： ▶ 天平菜单 >  历史 >  校正

校正历史中最多可存储500个条目。

按钮	名称	说明
	筛选	点击以筛选列表： <ul style="list-style-type: none"><li>• 按日期范围</li><li>• 按用户名</li></ul>

按钮	名称	说明
	打印	点击打印显示的条目。
	关闭	点击该按钮，即可返回到 <b>历史</b> 一节。

### 6.1.2.2 测试

≡ 导航： ▶ 天平菜单 >  历史 >  测试

测试历史中最多可存储500条记录。

按钮	名称	说明
	筛选	点击以筛选列表： <ul style="list-style-type: none"> <li>按日期范围</li> <li>按用户名</li> </ul>
	打印	点击打印显示的条目。
	关闭	点击该按钮，即可返回到 <b>历史</b> 一节。

### 6.1.2.3 服务

≡ 导航： ▶ 天平菜单 >  历史 >  服务

服务历史中最多可存储500个条目。

按钮	名称	说明
	筛选	点击以筛选列表： <ul style="list-style-type: none"> <li>按日期范围</li> <li>由技术人员</li> </ul>
	打印	点击打印显示的条目。
	关闭	点击该按钮，即可返回到 <b>历史</b> 一节。

### 6.1.2.4 变更

功能**变更历史**是一个能够提高称量流程可追溯性的管理工具。将列出添加方法或设置变更等信息。点进列表以显示有关数据的详细信息。

≡ 导航： ▶ 天平菜单 >  历史 >  变更

工厂设置中已经禁用了**变更历史**。要激活**变更历史**，参见[称量 / 质量 ▶ 第78页]。

变更历史中最多可存储5000个条目。

按钮	名称	说明
	筛选	点击以筛选列表： <ul style="list-style-type: none"><li>按日期范围</li><li>按用户名</li></ul>
	打印	点击打印显示的条目。
	关闭	点击该按钮，即可返回到 <b>历史</b> 一节。

### 6.1.3 天平信息

≡ 导航： ▶ 天平菜单 >  天平信息

天平信息一节显示了有关特定天平的信息：

- 标识
- 硬件
- 软件
- 维护

按钮	名称	说明
	许可证协议	点击该按钮，即可打开许可协议。
	关闭	点击该按钮，即可返回天平菜单。

### 6.1.4 用户

在**用户**一节中可定义用户和用户组的权限。用户可以被分配到用户组。在用户管理已激活的情况下，每次系统启动时，登录对话框都会打开。

设置**用户**只有在**用户管理**设置为**激活**时可见。

≡ 导航： ▶ 天平菜单 >  用户

**用户管理**一节分为下列小节：

-  **常规**: 适于所有用户的设置。
-  **用户**: 对单个用户的设置
-  **组**: 适于用户组的设置。

可创建无限数量的用户。用户始终为用户组的一部分，而且拥有其所在用户组的权限。具有适当权限的用户可对哪些用户拥有哪些权限进行定义或做出变更。

可参阅

 [激活用户管理 ▶ 第66页](#)

### 6.1.4.1 常规

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > 👤 用户 > ⚙️ 常规

参数	说明	数值
自动注销	定义用户是否在预定义的等待时间之后自动注销。	激活*   非活动
等待时间	定义天平上无活动多长时间后自动注销用户。 仅当自动注销设定为激活时，此设置才可用。	数字（15分钟*   1...60分钟）
用户提议	定义用户列表是否将出现在登录屏幕上。 <b>激活：</b> 将出现所有用户的列表，可从中选择用户名。 <b>非活动：</b> 用户需要在登录时手动键入自己的用户名。	激活*   非活动
密码重置	定义是否能够在登录屏幕上重置密码。 如果设定为不允许且密码丢失，则无法申请新密码。天平需要重置，且所有数据和设置均将丢失。	允许*   不允许

\* 出厂设置

### 6.1.4.2 用户

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > 👤 用户 > 👤 用户

参数	说明	数值
用户名	为用户制定唯一标识符。 定义用户配置文件后，用户名的值将固定且不可再更改。	文本（1...22个字符）
姓氏	定义用户的姓氏。	文本（0...22个字符）
名字	定义用户的名字。	文本（0...22个字符）
激活	激活或禁用当前用户。	激活*   非活动
分配的组	将用户分配到用户组。	定义的组的列表
用户语言	定义用户配置文件的语言。	可用语言

\* 出厂设置

可创建无限数量的用户。用户始终为用户组的一部分，而且拥有其所在用户组的权限。具有适当权限的用户可对哪些用户拥有哪些权限进行定义或做出变更。

### 6.1.4.3 组

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > 👤 用户 > 👤 组

#### 📘 信息

只有适当权限的用户才可访问此区域。

参数	说明	数值
组名称	定义组名。	文本（1...22个字符）

#### 常规权限

参数	说明	数值
锁定/解锁天平	定义是否允许用户组锁定或解锁天平。	激活   非活动

配置方法	定义是否允许用户组进行下列操作： <ul style="list-style-type: none"> <li>创建新方法</li> <li>编辑方法</li> <li>删除方法</li> <li>锁定或解锁方法</li> <li>导入或导出方法</li> </ul>	激活   非活动
执行服务命令	定义是否允许用户组进行下列操作： <ul style="list-style-type: none"> <li>访问服务功能</li> <li>锁定/解锁天平</li> <li>查看校正状态</li> <li>生成支持文件</li> </ul>	激活   非活动
配置系统	定义是否允许用户组进行下列操作： <ul style="list-style-type: none"> <li>修改系统设置</li> <li>导入系统设置</li> <li>配置外围设备</li> <li>执行软件更新</li> <li>执行应用或出厂设置</li> </ul>	激活   非活动
配置用户管理	定义是否允许用户组进行下列操作： <ul style="list-style-type: none"> <li>打印或导出/导入用户管理设置</li> <li>修改用户管理设置</li> <li>启用或禁用用户管理</li> </ul>	激活   非活动
取消任务	定义是否允许用户组在执行方法期间取消任务。	激活   非活动
排除 / 覆盖数据	定义是否允许用户组在 <b>结果列表</b> 中排除或覆写结果。	激活   非活动
重置时间跨度统计	定义是否允许用户组进行下列操作： <ul style="list-style-type: none"> <li>使用<b>SQC</b>方法时重置时间跨度统计</li> </ul>	激活   非活动

### 质量管理权限

参数	说明	数值
开始外部校正	定义是否允许用户组执行外部校正。	激活   非活动
显示变更历史	定义是否允许用户组查看 <b>变更历史</b> 。	激活   非活动
配置常规测试/ GWP	定义是否允许用户组进行下列操作： <ul style="list-style-type: none"> <li>配置日常测试</li> <li>导入或导出日常测试</li> <li>配置和导入测试砝码</li> <li>配置允差配置文件</li> <li>激活/禁用GWP认证模式</li> </ul>	激活   非活动
开始常规测试	定义是否允许用户组执行日常测试。	激活   非活动

所有用户均可编辑和屏幕亮度与声音相关的设置，变更应用于所有用户。任何用户均可在不影响其他用户设置的情况下为天平界面设定用户特定语言。

## 6.1.5 设置

本部分将说明可更改以满足特定要求的天平设置。天平设置适用于整个称重系统和所有用户。

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙️ 设置

设置一节分为下列小节：

- 🗣️ 天平
- 🧪 模块/加样
- 📡 接口
- 🖨️ 设备/打印机
- 🛠️ LabX/服务

### 6.1.5.1 天平

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙️ 设置 > 🗣️ 天平

天平一节分为下列几个小节：

- 🏋️ 称量 / 质量
- 🌐 日期/时间/语言/格式
- 🔊 显示屏/状态指示灯/声音
- ⚙️ 常规

#### 称量 / 质量

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙️ 设置 > 🗣️ 天平 > 🏋️ 称量 / 质量

参数	说明	数值
水平调节警告	定义天平未处于水平状态时的操作 选定 <b>强制水平调节</b> 且天平未处于水平状态时，无法将称量值添加到 <b>结果列表</b> 中（绿色按钮被禁用）。 对于经认证的天平，该设置设定为 <b>强制水平调节</b> 且不可编辑。	非活动   可选水平调节*   强制水平调节
静电检测	定义静电检测环境的条件。 <b>标准环境</b> ：如果在稳定的环境中操作，请选择此选项。 <b>环境不稳定</b> ：如果在不稳定的环境中操作，即 <b>标准环境</b> 设置不足以使天平测定静电称量误差，请选择此选项。	标准环境*   环境不稳定
允差配置文件	允差配置文件中存储了特定称量方法所需的所有天平设置。您可以针对不同的称量方法创建不同的允差配置文件。 此部分包含多种设置，这些设置在下面的表 <b>允差配置文件</b> 中介绍。	
自动重量值输出	定义是否以及应通过何种方式（ <b>MT-SICS</b> 和/或 <b>HID</b> ）导出称量值。 此部分包含多种设置，这些设置在下面的表 <b>自动重量值输出</b> 中介绍。	

GWP认证模式	<p>良好的称量管理规范（GWP®）是METTLER TOLEDO启动的一个项目，旨在帮助客户安全高效地操作称量设备。它涵盖仪器生命周期内的每一个相关步骤，对如何指定、校准和操作称量仪器提供明确指南。</p> <p>通过GWP认证的模式观察是否提供下列条件：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用适合的允差配置文件。</li> <li>• 内部校正成功。</li> <li>• 所需的测试成功。</li> <li>• 进行强制水平调节。</li> <li>• 未违反最小称量值。</li> </ul> <p>如果所有条件齐备，则天平会在每个称量结果之后增加通过GWP认证的标志。</p> <p><b>GWP认证模式</b>只能由METTLER TOLEDO服务技术人员激活。</p>	激活   非活动*
变更历史	<p>变更历史用于记录系统设置、用户管理与方法以及其他设置与配置的变更情况。其中存储下列信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 用户ID与时间戳</li> <li>• 物体标识</li> <li>• 属性的旧值与新值</li> </ul> <p>变更历史中最多可存储5000个条目。</p> <p>有关详细信息，请参阅[变更 ▶ 第74页]。</p>	激活   非活动*
天平重新校准提醒	定义是否提醒用户校准过期日期即将到来。	激活*   非活动
提前天数	<p>定义在显示出重新校准提醒的到期日期之前的天数。</p> <p>只有在将<b>天平重新校准提醒</b>设定为<b>激活</b>后，此设置才可用</p>	数字（30天*   0...400天）
校准过期时的操作	<p>定义校准过期时的操作。</p> <p><b>阻止</b>：天平将被锁定。在这种情况下，不可再次使用天平，直至用户将天平解锁为止。如果<b>用户管理</b>为<b>激活</b>，则只有具备相应权限的用户才能解锁天平。</p>	无*   阻止
锁定之前的天数	定义在提醒告知失效日期即将到来之前的天数。	数字（30天*   0...400天）
测试砝码重新校准提醒	定义是否提醒用户测试砝码校准的过期日期即将到来。	激活   非活动*
提前天数	<p>定义在显示出重新校准提醒的到期日期之前的天数。</p> <p>只有在将<b>测试砝码重新校准提醒</b>设定为<b>激活</b>后，此设置才可用</p>	数字（30天*   0...400天）
服务提醒	定义是否提醒用户服务到期日期即将到来。	激活   非活动*
提前天数	<p>定义在显示出服务提醒的到期日期之前的天数。</p> <p>只有在将<b>服务提醒</b>设定为<b>激活</b>后，此设置才可用</p>	数字（30天*   0...400天）

\* 出厂设置

### 允差配置文件

与称重性能和天平校准数据相关的设置可存储在允差配置文件中。

有关创建允差配置文件的详细信息，请参阅[允差配置文件 ▶ 第68页]

参数	说明	数值
名称	定义配置文件的名称。	文本 (0...22个字符)
指示灯	定义允差配置文件的指示图标颜色。该图标将出现在称量值单位上方。选定颜色后，可添加最多3个字符的说明。	无*   中性   白色   黄色   红色   蓝色   绿色   黑色
指示灯文本	定义指示图标的文本。	文本 (0...3个字符)
校准认证	从天平可用证书下拉列表中选择校准证书。新证书只能由服务技术人员根据执行的天平校准创建。	校准认证   无*
环境	定义天平的环境条件。 <b>非常稳定</b> ：适用于完全无气流和振动的环境。 <b>稳定</b> ：适用于几乎无气流和振动的环境。 <b>标准</b> ：适用于环境条件存在适中变化的普通工作环境。 <b>不稳定</b> ：适用于周围环境不时变化的工作环境。 <b>非常不稳定</b> ：适用于周围环境持续变化的工作环境。	非常稳定   稳定   标准*   不稳定   非常不稳定
称量模式	定义天平的过滤器设置。 <b>通用</b> ：适合于所有的标准称量应用。 <b>传感器模式</b> ：根据环境条件的设置，此设置可以发出不同强度的过滤后称量信号。该过滤器具有与时间（不适应）相关的线性特征，并且适合连续处理测量值。	通用*   传感器模式
数值发布	定义天平将测量值视为稳定且可捕获时的速度。 <b>非常快</b> ：如果您需要快速测量结果且可重复性又不十分重要时，则建议选择此选项。 <b>非常可靠</b> ：为测量结果提供非常好的可重复性，但会延长稳定时间。 也可以从中选择一些中间设置。	非常快   快速   快速可靠*   可靠   非常可靠
显示器可读性	确定天平显示屏的可读性 <b>d</b> 。 <b>1d</b> ：显示最大分辨率 <b>2d</b> ：缩小2倍分辨率显示结果 <b>5d</b> ：缩小5倍分辨率显示结果 <b>10d</b> ：缩小10倍分辨率显示结果 <b>100d</b> ：缩小100倍分辨率显示结果 <b>1000d</b> ：缩小1000倍分辨率显示结果 对于已审批天平，此设置可用的值视天平型号而定。	1d*   2d   5d   10d   100d   1000d
归零偏移补偿	<b>归零偏移补偿</b> 功能持续校正因秤盘上的少量灰尘等原因有可能造成的与零点之间的任何偏差。 对于已审批天平，此设置可用的值视天平型号而定。	激活*   非活动
允许单位	定义此允差配置文件中允许的单位。	可用值取决于型号。

\* 出厂设置

## 自动重量值输出

天平可与带USB电缆的电脑相连。称量结果可以直接传送至目标应用（如Microsoft Excel）。

参数	说明	数值
输出模式	<p>定义通过通信接口（如USB、以太网）传送的称量值。</p> <p><b>结果：</b> 称量值仅在将它们添加到<b>结果列表</b>后才能传送。</p> <p><b>持续：</b> 称量值通过<b>LabX/服务 &gt; MT-SICS</b>定义的接口连续传送。</p> <p>可以使用其他字段，取决于所选的选项。</p>	结果*   持续
目标	<p>定义传送称量值的方式。</p> <p><b>HID（人机交互设备）：</b> 将简单的字符流（例如：重量值）传送至台式计算机，而无需安装额外驱动程序（相当于键盘）。可配置传送称量值的格式。</p> <p><b>MT-SICS：</b> 数据以MT-SICS格式（METTLER TOLEDO标准接口命令集）进行传送。MT-SICS可双向工作，即：天平可向主机发送确认信息，也可以接收命令。MT-SICS有单独的参考手册。</p> <p><b>HID / MT-SICS：</b> 数据以HID和MT-SICS格式同时传送。</p> <p><b>MT-SICS可配置：</b> 数据以用户定义的MT-SICS格式传送。</p> <p>仅当<b>输出模式</b>设定为<b>结果</b>时，此设置才可用。</p>	HID*   HID / MT-SICS   MT-SICS   MT-SICS可配置
结果ID 1 结果ID 2	<p>定义输出中是否包含字段<b>结果ID 1</b>和<b>结果ID 2</b>。</p> <p>支持的字符包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 数字：0 – 9</li> <li>• 字母：a-z和A-Z</li> <li>• 特殊字符：空格、点、逗号、分号、加号、减号</li> </ul> <p>不支持的字符将替换为空格。</p> <p>只有在将<b>输出模式</b>设定为<b>结果</b>后，此设置才可用。</p>	激活   非活动*
日期	<p>定义输出中是否包含字段<b>日期</b>。</p> <p>日期格式为<b>YYYY-MM-DD</b>。</p> <p>只有在将<b>输出模式</b>设定为<b>结果</b>后，此设置才可用</p>	激活   非活动*
时间	<p>定义输出中是否包含字段<b>时间</b>。</p> <p>时间格式为<b>hh-mm-ss</b>。</p> <p>只有在将<b>输出模式</b>设定为<b>结果</b>后，此设置才可用</p>	激活   非活动*
净重指示	<p>在标准输出格式中，并没有专门标出净重值。若要在净重值前面加上一个N，则可以激活此功能。净值符号在字段中向左对齐。</p> <p>仅当<b>输出模式</b>设定为<b>结果</b>时，此设置才可用。</p>	激活   非活动*
净重指示字段长度	<p>定义净重指示符的字段长度。</p> <p>仅当<b>输出模式</b>设定为<b>结果</b>且<b>净重指示</b>设定为<b>激活</b>时，此设置才可用。</p>	数字 (2*   1...2)

重量字段长度	定义传送到电脑上的应用程序（如传送到Excel字段中）的数字个数。 仅当 <b>输出模式</b> 设定为 <b>结果</b> 时，此设置才可用。	数字（1*10..20）
签名	定义是否使用代数符号显示称量结果。 <b>用于所有值</b> ：每个称量结果之前加上一个加号或减号。 <b>用于负值</b> ：只在负值前加上一个减号。正值在传输时不带代数符号。 仅当 <b>输出模式</b> 设定为 <b>结果</b> 时，此设置才可用。	用于所有值   用于负值*
签名位置	定义该代数符号是位于重量字段的首位还是直接位于重量数字的前面。 仅当 <b>输出模式</b> 设定为 <b>结果</b> 时，此设置才可用。	重量字段左侧   重量数字左侧*
小数点	定义用于分隔数值整数与分数的字符。 仅当 <b>输出模式</b> 设定为 <b>结果</b> 时，此设置才可用。	,   .*
单位	定义称量字段是否显示称量单位。 仅当 <b>输出模式</b> 设定为 <b>结果</b> 时，此设置才可用。	激活*   非活动
单位字段长度	定义称量单位的字段长度。 仅当 <b>输出模式</b> 设定为 <b>结果</b> 且 <b>单位</b> 设定为 <b>激活</b> 时，此设置才可用。	数字（1*11..6）
字段分隔符	定义用于分隔数据字段的字符或字符序列。 仅当 <b>输出模式</b> 设定为 <b>结果</b> 时，此设置才可用。	无   空格*   TAB     ;
行结束字符	定义表示行结束的字符或字符序列。 只有在将 <b>输出模式</b> 设定为 <b>结果</b> 后，此设置才可用	CRLF   CR   LF   TAB   无   Enter*
更新/sec.	定义数据传送速率。 仅当 <b>输出模式</b> 设定为 <b>持续</b> 时，此设置才可用。	2   5   6*   10
格式	定义传送数据的格式。 仅当 <b>输出模式</b> 设定为 <b>持续</b> 时，此设置才可用。	MT-SICS*   PM   AT/MT

\* 出厂设置

## 日期/时间/语言/格式

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 > 磅 天平 > 🌐 日期/时间/语言/格式

参数	说明	数值
日期	定义当前日期。	日期
时间	定义当前时间。 使用加/减按钮来定义时间。	时间
语言	定义界面导航的语言。	English   Deutsch   Français   日本語   中文   Español   Italiano   Русский   Português   Polski   Magyar   Čeština

时区	选择时区。设置时区后，天平会在夏令时和冬令时之间自动切换。	参见屏幕上的列表
日期格式	设置日期格式。	D.MMM.YYYY*   MMM D YYYY   DD.MM.YYYY   MM/DD/YYYY   YYYY- MM-DD   YYYY/MM/DD   YYYY年M月D日
时间格式	选择时间格式。	24:MM*   12:MM   24.MM   12.MM
键盘布局	定义键盘布局的语言。	英语   德语   法语   西 班牙语   日语   简体中 文   俄语   捷克语   波 兰语   匈牙利语
系统默认设置	定义应用于新创建的用户默认设置。 仅当 <b>用户管理</b> 设定为 <b>激活</b> 时，此设置才可用。	

\* 出厂设置

### 显示屏/状态指示灯/声音

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 > 🗣 天平 > 📺 显示屏/状态指示灯/声音

参数	说明	数值
显示屏亮度	定义显示器的亮度。	20 %   40 %   60 %   80 %*   100 %
音量	定义终端声音音量。	非活动   20 %   40 %   60 %*   80 %   100 %
按键声音	定义按键时是否发出声音。	激活*   非活动
信息声音	定义屏幕上出现信息时是否发出声音。	激活*   非活动
警告声音	定义屏幕上出现警告时是否发出声音。	激活*   非活动
出错声音	定义出现错误时是否发出声音。	激活*   非活动
状态指示灯	<p>激活/关闭 <b>状态指示灯</b>。</p> <p><b>激活(无绿色灯)</b>：将监控天平当前的所有状态，必要时红色/黄色指示灯将会点亮，但绿色指示灯将会保持熄灭状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>状态指示灯</b>为红色：错误。在纠正错误之前，不得使用天平。</li> <li>• <b>状态指示灯</b>为黄色：警告。例如，测试管理器已将测试推送至天平，或者您正在校准提醒日期和下次校准的预定日期之间操作天平。天平仍可使用。</li> <li>• <b>状态指示灯</b>为绿色或熄灭：正常。未检测到问题，天平可随时进行称量。</li> </ul>	激活*   激活(无绿色 灯)   非活动

状态指示灯亮度	定义显示器的亮度 <b>状态指示灯</b> 。 仅当 <b>状态指示灯</b> 设置为 <b>激活</b> 或 <b>激活(无绿色灯)</b> 时，此设置才可用。	20 %   40 %   60 %*   80 %   100 %
---------	--	------------------------------------

\* 出厂设置

## 常规

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 > 音 天平 > ⚙ 常规

参数	说明	数值
天平ID	定义天平的ID。此名称可用于通过网络与天平通信。 不允许使用空格或特殊字符。	文本 (0...22个字符)
待机	定义天平是否在闲置时间达到预定义的 <b>等待时间</b> 后自动进入待机模式。 如果激活了 <b>用户管理</b> ，则当天平切换到待机模式时，用户将被自动注销。 始终可通过按下⏻手动启动待机模式。	激活*   非活动
等待时间	定义天平在闲置多长时间后自动切换到待机模式。 仅当 <b>待机</b> 设定为 <b>激活</b> 时，此设置才可用。	数字 (10分钟*   0...60分钟)
系统启动时更新软件	激活此选项后，可在启动时通过USB存储设备来执行软件更新。	激活*   非活动
自动导出目录	为自动导出定义目标目录。 仅当配置了 <b>文件服务器</b> 时，才能导出至 <b>文件服务器</b> (请参阅[LabX/服务 ▶ 第88页])。	USB存储设备*   文件服务器
用户管理	激活/禁用 <b>用户管理</b> 。	激活   非活动*

\* 出厂设置

### 6.1.5.2 模块/加样

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 > 模块/加样

#### 加样模块/加样头

参数	说明	数值
加样头标签	定义要打印的加样位头标签的模板，即标签上包括哪些数据以及采用哪种格式。 此部分包含多种设置，这些设置在下面的表 <b>加样头标签</b> 中介绍。	

#### 加样头标签

参数	说明	数值
副本	定义打印标签的副本数量。	数字
使用的模板	选择标签模板。	可用标签如下所示。





## 字段设置

每个标签字段的内容均可单独定义。

参数	说明	数值
标签字段1	定义每个标签字段内显示的信息。标签字段的数量取决于所选的模板。	可用条目取决于方法设置。

## 可用标签

可选择以下标签布局：

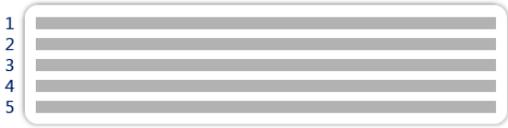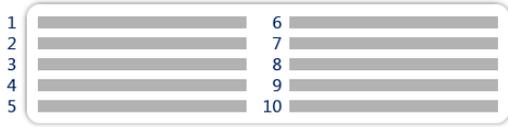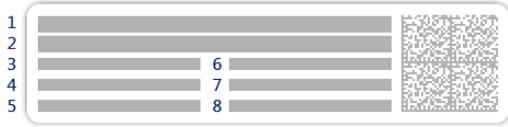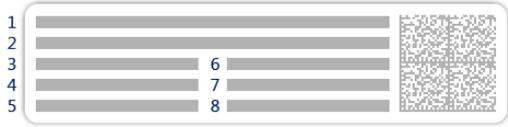 <p>1 2 3 4 5</p> <p>5个大字段</p>	 <p>1 2 3 4 5</p> <p>5个小字段</p>
 <p>1 2 3 4 5</p> <p>10个小字段</p>	 <p>1 2 3</p> <p>带3个大字段的1D条形码</p>
 <p>1 2 3</p> <p>带3个小字段的1D条形码</p>	 <p>1 2 3</p> <p>带6个小字段的1D条形码</p>
 <p>1 2 3 4 5</p> <p>带5个大字段的2D条形码</p>	 <p>1 2 3 4 5</p> <p>带5个小字段的2D条形码</p>
 <p>1 2 3 4 5</p> <p>带2个大字段和6个小字段的2D条形码</p>	 <p>1 2 3 4 5</p> <p>带8个小字段的2D条形码</p>

### 6.1.5.3 接口

☰ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 > 📶 接口

接口节分为下列小节：

- 🌐 以太网
- 📶 蓝牙

## 以太网

使用以太网接口可将天平与网络连接，以便：

- 将称重结果以XML文件形式存储在共享文件夹中
- 使用MT-SICS通信协议或LabX与天平进行远程通信

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 > 🌐 接口 > 🌐 以太网

参数	说明	数值
主机名	定义天平主机名称。	文本（1...22个字符）
MAC地址	关于用于唯一标识网络中天平的MAC（介质访问控制）地址的信息。	
网络配置	<b>DHCP</b> : 将自动设置以太网连接的设置。 <b>手动</b> : 必须由用户手动设置以太网连接的设置。	DHCP*   手动
IP地址	如果不自动获得IP，则可在此处输入。	000.000.000.000... 255.255.255.255
子网掩码	定义TCP/IP协议使用的，用于确定主机是在本地子网上还是远程网络上的子网掩码。	000.000.000.000... 255.255.255.255
DNS服务器（主）	定义主DNS（域名系统）服务器的地址。	000.000.000.000... 255.255.255.255
DNS服务器（辅助）	定义从DNS服务器的地址。	000.000.000.000... 255.255.255.255
默认网关	定义将主机子网连接至其他网络的默认网关的地址。	000.000.000.000... 255.255.255.255

\* 出厂设置

## 蓝牙

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 > 🌐 接口 > 📶 蓝牙

### 蓝牙标识

参数	说明	数值
激活	借助选项 <b>蓝牙</b> ，可以通过蓝牙与打印机进行通信。	非活动*   激活

\* 出厂设置

## 6.1.5.4 设备/打印机

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 > 🖨 设备/打印机

本节分为下列几个小节：

- 🖨 挡光板
- 🖨 打印机
- 📄 条形码阅读器
- 📄 RFID阅读器
- 📄 ErgoSens
- 📄 脚踏开关

## 挡光板

≡ 导航: ▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 > 🖨 设备/打印机 > 🛑 挡光板

连接至天平的 USB 端口后, 即可自动识别设备。可在此处查询设置。

## 打印机

≡ 导航: ▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 > 🖨 设备/打印机 > 🖨 打印机

### 打印机设置

参数	说明	数值
打印机类别	定义打印机类型。 条码打印机: 在纸带上打印称重结果 标签打印机: 在标签上打印称重结果	条码打印机   标签打印机*
设备	用于激活或禁用设备。	已激活*   已取消激活
线缆端头	定义打印时的行尾字符。此处设置的值必须与打印机设置相匹配。 此设置仅适用于纸带打印机。	<CR> <LF>*   <CR>   <LF>
字符集	定义通信专用的字符代码。此处设置的值必须与打印机设置相匹配。 此设置仅适用于纸带打印机。	ANSI/WIN   IBM/DOS   UTF8*

\* 出厂设置

## 条形码阅读器

≡ 导航: ▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 > 🖨 设备/打印机 > 📄 条形码阅读器

连接至天平的 USB 端口后, 即可自动识别设备。可在此处查询设置。

## RFID阅读器

≡ 导航: ▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 > 🖨 设备/打印机 > 📄 RFID阅读器

连接至天平的 USB 端口后, 即可自动识别设备。可在此处查询设置。

## ErgoSens

≡ 导航: ▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 > 🖨 设备/打印机 > 📄 ErgoSens

参数	说明	数值
函数	定义在触发设备时执行哪个功能。 如果设定为门, 则需要指定设置天平 > 门 > 设备。	无*   门   归零   皮重   添加结果

\* 出厂设置

## 脚踏开关

≡ 导航: ▶ 天平菜单 > ⚙ 设置 > 🖨 设备/打印机 > 📄 脚踏开关

参数	说明	数值
函数	定义在触发设备时执行哪个功能。 如果设定为门, 则需要指定设置天平 > 门 > 设备。	无*   门   归零   皮重   添加结果

\* 出厂设置

## 可参阅

- 🔗 打印机 ▶ 第51页
- 🔗 RFID阅读器 ▶ 第55页
- 🔗 脚踏开关和ErgoSens ▶ 第56页

### 6.1.5.5 LabX/服务

提供多项与天平通信的服务：**LabX服务**、**MT-SICS服务**或者**Web服务**。请注意，任何时候只能启用一项服务。

要启用LabX与仪器之间的通信，必须确保仪器中的适当设置与LabX中的设置一致。每当进行连接和启动任务时，LabX将仪器上的日期和时间同LabX服务器同步。当仪器连接时，连接仪器上的用户界面语言会变更为LabX装置上目前安装的语言。

☰ 导航：▶ 天平菜单 > ⚙️ 设置 > 🌐 LabX/服务

参数	说明	数值
LabX服务	<b>非活动</b> ：将不建立与LabX的连接。 <b>网络</b> ：启动时将建立与LabX的网络连接。必须指定 <b>端口</b> 。 <b>USB</b> ：启动时将建立与LabX的USB连接。	非活动*   网络   USB
MT-SICS服务	<b>非活动</b> ：MT-SICS端口不会打开。 <b>网络</b> ：MT-SICS网络端口将在启动时打开。必须指定 <b>端口</b> 。 <b>USB</b> ：MT-SICS USB端口将在启动时打开。	非活动*   网络   USB
Web服务	如果设定为 <b>激活</b> ，则网络端口将在启动时打开。使用菜单 <b>Web服务配置</b> 可配置服务。 完整的 <b>Web服务</b> 文档可在线获取： <a href="http://www.mt.com/labweighing-software-download">▶ www.mt.com/labweighing-software-download</a> 。	非活动*   激活
文件服务器	允许定义一台用于导入/导出数据的文件服务器。 如果设定为 <b>激活</b> ，则可使用菜单 <b>文件服务器配置</b> 配置服务器。	激活   非活动*

\* 出厂设置

## 可参阅

- 🔗 LabX服务 ▶ 第58页
- 🔗 MT-SICS服务 ▶ 第59页
- 🔗 Web服务 ▶ 第61页
- 🔗 数据管理 ▶ 第62页

### 6.1.5.6 打印设置

☰ 导航：▶ 天平菜单 > ⚙️ 设置

所有的天平设置完成设定后，您可以打印完整的设置列表，以对信息进行归档。

- 要打印天平设置，点击🖨️ **打印设置**。
  - ➡️ 完整的天平设置已打印。

## 6.1.6 维护

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > 维护

只有在用户具有适当的用户权限时，选项**维护**才会出现。

**维护**一节分为下列小节：

- 导入/导出
- 格式化RFID
- 软件更新
- 重置
- 服务菜单

可参阅

[数据管理](#) ▶ 第62页

[RFID阅读器](#) ▶ 第55页

[软件升级](#) ▶ 第116页

[重置天平](#) ▶ 第70页

### 6.1.6.1 服务菜单

≡ 导航： ▶ 天平菜单 > 维护 > 服务菜单

图标	名称	描述
  	设备错误	点击以显示错误代码。在对设备进行故障排除时，此错误代码可能有助于与METTLER TOLEDO通信。图标视错误的严重程度而定：严重错误、警告或信息。 只有当设备上持续出现错误代码时，设备错误图标才会出现。
	显示校正状态	点击可打开以下方面的相关信息： <ul style="list-style-type: none"><li>• 预调整者</li><li>• 温度补偿</li><li>• 生产线性化</li><li>• 标准校准</li><li>• 生产校准</li><li>• 用户线性化</li><li>• 用户校准</li></ul>
	保存支持文件	点击可将支持文件（与错误有关的所有信息）保存到USB存储设备上以发送给METTLER TOLEDO代表。

图标	名称	描述
	导入配置日志	日志配置文件可由METTLER TOLEDO提供，以便更全面地收集要保存在支持文件中的天平参数。该文件仅用于故障排除目的。 点击可从USB存储设备导入日志配置，以便导出增强的参数列表并发送给METTLER TOLEDO代表。

## 6.2 称量方法设置

对于本手册中描述的天平型号，只有方法**一般称重**是相关的。

### 6.2.1 设置：方法"一般称重"

本小节描述了一**般称重**和**一般称量（明细）**方法的设置。可为新建方法或现有方法编辑设置。

≡ 导航： ▼ 方法 >  方法列表 >  我的一般称量 >  编辑

 编辑方法 - 我的一般称量

 常规	方法类型	一般称重
 ID格式	方法名称	我的一般称量
 称量	注释	在此处输入
 称量品	锁定方法	<input type="checkbox"/>
 自动化		
 打印/导出		

 关闭
 保存

**一般称重**方法的设置按照下列方式分组：

-  常规
-  ID格式
-  称量
-  称量品，仅适用于方法**一般称重**
-  称量品，仅适用于方法**一般称量（明细）**
-  自动化
-  打印/导出

可参阅

 [创建方法"一般称重" ▶ 第37页](#)

 [编辑方法 ▶ 第38页](#)

#### 6.2.1.1 常规

当创建方法时已在向导中定义**方法类型**，不能更改。

参数	说明	数值
方法名称	定义方法的名称。	文本（1...22个字符）

注释	方法可通过备注进行描述。	文本 (0...128个字符)
锁定方法	锁定方法以防止进一步编辑。	激活   非活动*

\* 出厂设置

## 6.2.1.2 ID格式

### 任务ID

参数	说明	数值
任务ID数目	定义任务ID的数量。 如果 <b>任务ID数目</b> 大于0, 则设置 <b>任务ID</b> 、 <b>任务说明</b> 和 <b>前缀/默认值</b> 对于每个任务ID都可用。	0   1*   2   3
任务ID 1	定义任务ID的命名类型。 <b>使用默认设置手动</b> : 可在执行方法时手动输入任务ID的值。 <b>自动时间戳</b> : 系统提供一个由附加当前日期和时间的前缀所创建的值。	使用默认设置手动*   自动时间戳
任务说明	允许为每个任务ID字段定义标签。	文本 (0...32个字符)
默认值	定义任务ID的默认值。可在执行方法时手动更改任务ID的数值。 只有在将对应的 <b>任务ID</b> 设置为 <b>使用默认设置手动</b> 后, 此设置才可用。	文本 (0...32个字符)
前缀	定义任务ID的前缀。 只有在将对应的 <b>任务ID</b> 设置为 <b>自动时间戳</b> 后, 此设置才可用。	文本 (0...32个字符)

\* 出厂设置

### 结果ID

参数	说明	数值
结果ID数目	定义结果ID的数量。 如果 <b>结果ID数目</b> 大于0, 则设置 <b>结果ID</b> 、 <b>结果说明</b> 和 <b>前缀/默认值</b> 对于每个结果ID都可用。	0   1*   2   3
结果ID 1	定义结果ID的命名类型。 <b>使用默认设置手动</b> : 可在执行方法时手动输入结果ID的值。 <b>自动计数</b> : 系统提供一个从 <b>前缀</b> 创建的值, 该值附加有一个唯一数字 (计数器)。	使用默认设置手动*   自动计数
结果说明	允许为每个结果ID定义标签。	文本 (0...32个字符)
默认值	定义结果ID的默认值。可在执行方法时手动更改结果ID的数值。 只有在将对应的 <b>结果ID</b> 设置为 <b>使用默认设置手动</b> 后, 此设置才可用。	文本 (0...32个字符)

前缀	定义结果ID的前缀。 只有在将对应的 <b>结果ID</b> 设置为 <b>自动计数</b> 后，此设置才可用。	文本 (0..32个字符)
----	---	---------------

\* 出厂设置

### 6.2.1.3 称量

参数	说明	数值
显示信息重量	设定为 <b>激活</b> 时，称量屏幕上将显示出辅助重量。	激活   非活动*
信息单位	定义 <b>信息重量</b> 的单位。 只有在将 <b>显示信息重量</b> 设定为 <b>激活</b> 后，此设置才可用	可用单位取决于天平型号。

\* 出厂设置

#### 称量设置

参数	说明	数值
允差配置文件	允差配置文件中存储了特定称量方法所需的所有天平设置。您可以针对不同的称量方法创建不同的允差配置文件。	用户为特定天平和应用程序创建允差配置文件。
重量捕获模式	定义在点击添加结果的按钮后，或者通过自动创建称量结果触发添加结果时的行为。 <b>稳定</b> ：系统等待稳定的重量。 <b>立即</b> ：系统不等待稳定的重量。系统等待定义的秒数（ <b>重量捕获延迟</b> ）。当捕获重量的延时过后，从重量流中捕获重量值。	稳定*   立即
重量捕获延迟	定义在点击添加结果的按钮或添加结果由自动创建称量结果触发后，天平等待获取称量值的时间（以秒表示）。 仅当 <b>重量捕获模式</b> 设定为 <b>立即</b> 时，此设置才可用。	数字 (5秒*   0..60秒)

\* 出厂设置

## 统计

参数	说明	数值
激活统计	<p>如果将<b>激活统计</b>设定为<b>激活</b>，则将计算下列统计信息：</p> <p><b>总数</b>：统计使用的物品数量</p> <p><b>总和</b>：所有值的和（小数位和单位视方法设置而定）</p> <p><b>最小值模式</b>：最小值（小数位和单位视方法设置而定）</p> <p><b>最大值模式</b>：最大值（小数位和单位视方法设置而定）</p> <p><b>范围</b>：最大值与最小值之差（小数位和单位视方法设置而定）</p> <p><b>平均值</b>：数值会被累加并除以值的数量，然后进行四舍五入，小数位会比在相关允差配置文件中配置的小数位多一个（单位视方法设置而定）。</p> <p><b>标准偏差</b>：对标准偏差进行四舍五入，小数位会比在相关允差配置文件中配置的小数位多一个（单位视方法设置而定）</p> <p><b>相对标准偏差</b>：相对标准偏差（四舍五入到2个小数位，以%表示）</p> <p>增加或更新结果之后，将立即计算和显示统计值。</p>	激活   非活动*

\* 出厂设置

## 静电

参数	说明	数值
离子发生器	定义是否激活/禁用去静电装置。	激活   非活动*

\* 出厂设置

## 可参阅

 创建方法"一般称重" ▶ 第37页

### 6.2.1.4 称量品 / 称量品

可为方法定义目标重量及允差限值。方法**一般称重**包括**称量品**中的一个物品，但可以在**称量品**中为方法**一般称量（明细）**定义多个物品。

参数	说明	数值
样品ID	定义样品名称。 该设置仅适用于多个称量品方法（逐项排列）。	文本（0...32个字符）
单位	定义称量结果的单位。	可用单位取决于天平型号。
目标重量	定义目标重量。目标重量将在天平的称量辅助工具（SmartTrac）中显示出来。定义包含允差的目标重量后，SmartTrac将指示出当前显示的重量是否在允差范围内。	数字
-允差	定义允差下限值。 仅当定义 <b>目标重量</b> 后，此设置才可用。	数字

+允差	定义允差上限值。 仅当定义 <b>目标重量</b> 后，此设置才可用。	数字
-----	--	----

#### 可参阅

[创建方法"一般称重" ▶ 第37页](#)

### 6.2.1.5 自动化

参数	说明	数值
条码数据目标	<p>如果将条形码阅读器与天平相连，则此选项可定义数据处理方式。</p> <p><b>键盘输入：</b> 数据将被写入当前打开的输入窗口。如果没有打开任何输入窗口，将忽略该数据。</p> <p><b>目标重量值：</b> 条形码数据被视为目标重量值。</p> <p><b>任务ID 1：</b> 收到的条形码数据被视作该任务ID的标识文本。</p> <p><b>结果ID 1：</b> 收到的条形码数据将被视作该结果ID的标识文本。</p> <p>下拉菜单中的可用项目取决于为方法指定的<b>任务ID数目</b>和<b>结果ID数目</b>。</p> <p>确保扫描的条形码的字符与应插入的字段格式兼容。</p>	键盘输入*   目标重量值   任务ID 1   结果ID 1   ...

\* 出厂设置

#### 自动输料机支架

本手册中描述的天平类型不支持此功能。

参数	说明	数值
自动输料机支架	<p>启用或禁用自动喂料器支持功能。</p> <p>如要使用自动喂料器支持功能，需要使用USB将自动喂料器与天平相连以及对其正确配置。</p>	激活   非活动*
称量品的数量	定义自动喂料器将向天平输送的物品数量。	数字 (20*   1...100)
真实性允许误差	<p>定义测量值的真实性允许误差。</p> <p>真实性允许误差与定义的目标重量有关。</p> <p>示例： 对于一个30%的真实性允许误差而言，所有与目标重量相差±30%以内的重量值均被视为似然值，并传送至统计数据中。其他所有重量值均被忽略并且从统计数据中排除。</p>	数字 (30%*   0...100%)
结束时清空输料机	<p>指定在任务结束时，是否清空自动喂料器中的所有物体。</p> <p><b>激活：</b> 自动喂料器以配置的清空进料速率进料，并在最后一个物品通过光电反光板后90秒停止。</p> <p><b>非活动：</b> 不自动清空。</p>	激活   非活动*
进料速率	定义自动喂料器向天平输送物品的速度。	减缓   常规*   快速   非常快

\* 出厂设置

## 称重自动化

参数	说明	数值
自动归零	<b>激活</b> ：当重量低于预定义阈值时，天平会自动清零。 已审批天平没有这一设置。	激活   非活动*
自动归零阈值	定义 <b>自动归零</b> 的阈值。 仅当 <b>自动归零</b> 设定为 <b>激活</b> 时，此设置才可用。	数字
去皮模式	定义去皮模式。 <b>无</b> ：不自动去皮。 <b>自动去皮</b> ：天平将首个稳定称量值自动存储为皮重。 <b>预置皮重</b> ：允许您手动输入固定皮重的数值。	无*   自动去皮   预置皮重
自动去皮阈值	定义选项 <b>去皮模式</b> 的阈值。 这个值定义了必须放在秤盘上的最小称量值，以使其自动保存为皮重。如果重量低于此极限值，则不会自动将该值传送到皮重存储器。 您可以将最轻的去皮容器放在秤盘上，然后按下  按钮，而无需输入称量值。应用的重量值被直接作为极限值接受。 仅当 <b>去皮模式</b> 设定为 <b>自动去皮</b> 时，此设置才可用。	数字
预置皮重值	为预设皮重定义重量值。 可以将相关去皮容器放在秤盘上，然后按下  按钮，而无需输入重量值。将获得的重量值直接定义为预设皮重。 仅当 <b>去皮模式</b> 设定为 <b>预置皮重</b> 时，此设置才可用。	数字
自动结果	达到阈值之后，将自动生成称量结果。 <b>无</b> ：不自动生成结果。 <b>含样品皮重</b> ：将达到阈值的重量值从秤盘上去除后，对天平去皮。 <b>不含样品去皮重</b> ：将达到阈值的重量值从秤盘上去除后，不对天平去皮。 如果已激活 <b>自动输料机支架</b> ，设置 <b>自动结果</b> 将自动设定为 <b>不含样品去皮重</b> 并且无法编辑。	无   含样品皮重*   不含样品去皮重
自动结果阈值	定义 <b>自动结果</b> 的阈值。 仅当样本的重量大于此阈值时，才会自动将结果添加到 <b>结果列表</b> 。 只有在将 <b>自动结果</b> 设定为 <b>激活</b> 后，此设置才可用	数字
重量触发器	定义选项 <b>自动结果阈值</b> 的行为。 <b>超出</b> ：当重量超过定义的阈值时生成称量结果。 <b>降至以下</b> ：当重量低于定义的阈值时生成称量结果。 仅当 <b>自动结果</b> 设定为 <b>不含样品去皮重</b> 时，此设置才可用。 如果已激活 <b>自动输料机支架</b> ，设置 <b>重量触发器</b> 将自动设定为 <b>超出</b> 并且无法编辑。	超出*   降至以下

结果生成后自动去皮	如果设置为 <b>激活</b> ，则将结果添加到 <b>结果列表</b> 时，天平会自动去皮。	激活   非活动*
自动完成任务	<b>激活</b> : 在将最后一个称量品结果添加到 <b>结果列表</b> 后，天平将自动完成正在运行的任务。 仅当方法正在使用多个称量品时，此设置才可用。	激活   非活动*

\* 出厂设置

#### 可参阅

 创建方法"一般称重" ▶ 第37页

### 6.2.1.6 打印/导出

参数	说明	数值
数据条输出结果和数据导出	定义当任务完成时打印和/或导出的内容以及自动执行哪些打印/导出操作。 此部分包含多种设置，这些设置在下面的表 <b>数据条输出结果和数据导出</b> 中介绍。	
任务的标签打印	定义要打印的任务标签的模板，即，标签上包括哪些数据以及采用哪种格式。 此部分包含多种设置，这些设置在下面的表 <b>任务的标签打印</b> 中介绍。	
为称量品打印标签	定义要打印的称量品标签的模板，即，标签上包括哪些数据以及采用哪种格式。 此部分包含多种设置，这些设置在下面的表 <b>为称量品打印标签</b> 中介绍。	
标签剪切	定义是否应在打印后裁剪标签。 <b>按标签</b> : 每张标签打印后即进行裁剪。 <b>按任务</b> : 任务完成后裁剪标签。 仅当连接的标签打印机可以剪切标签时，此设置才有用。	关闭*   按标签   按任务

\* 出厂设置

#### 6.2.1.6.1 数据条输出结果和数据导出

##### 自动数据输出

参数	说明	数值
条码打印机	点击 <b>完成</b> 按钮时， <b>激活/禁用</b> 色带打印机上 <b>结果列表</b> 的自动打印功能。可在 <b>模板设置</b> 一节中定义传送至打印机的数据。	激活   非活动*
结果导出	点击 <b>完成</b> 按钮后，将 <b>激活/禁用</b> 数据自动导出至文件服务器或USB存储设备。	激活   非活动*
重量值	<b>激活/禁用</b> 该选项，可在点击 <b>添加到结果</b> 时自动通过USB或以太网发送称量值。	激活   非活动*

\* 出厂设置

## 数据条输出结果模板

该菜单项可用于定义纸带打印机打印的信息。

每个单独的参数都可以通过相应的复选框设置为**非活动**或**激活**。要一次性启用或禁用所有参数，请按以下过程操作：

- 1 要一次性禁用所有的复选框，点击  **取消全选**。
  - ➔ 所有参数设定为**非活动**。
- 2 要一次性禁用所有的复选框，点击  **全选**。
  - ➔ 所有参数设定为**激活**。

## 模板设置

参数	说明	数值
页眉和脚注	定义要打印的页眉和/或页脚。	标题   标题文本   日期/时间   用户   签名   分割线   组标题
天平信息	定义要打印的天平相关信息。	天平类型   天平ID   天平序列号   软件版本
质量信息	定义要打印的质量信息。	允差配置文件   校正日期/时间   常规测试名称   常规测试最后执行时间   常规测试结果   GWP认证状态   水平状态   MinWeigh状态
任务信息	定义要打印的任务相关信息。	方法名称   方法注释   任务ID   自定义单位设置   自动结果设置   总数   总和   平均值   最小值模式   最大值模式   范围   标准偏差   相对标准偏差
称量品信息	定义要打印的称量品相关信息。	显示已排除的称量品   结果状态   结果ID   GWP认证状态   静电电荷   水平状态   MinWeigh状态   允差状态   目标与允差
结果详细信息	定义要打印的测量结果相关信息。	重量   皮重   毛重   信息重量   日期/时间   稳定性

### 6.2.1.6.2 任务的标签打印

参数	说明	数值
任务的自动标签打印	当设置为 <b>激活</b> 时，点击 <b>完成</b> 时会自动打印任务标签。	激活   非活动*

副本	定义打印标签的副本数量。	数字
使用的模板	选择标签模板。	可用标签如下所示。

\* 出厂设置

### 字段设置

每个标签字段的内容均可单独定义。

参数	说明	数值
标签字段1	定义每个标签字段内显示的信息。标签字段的数量取决于所选的模板。	可用条目取决于方法设置。

### 条形码设置

每个条码字段的内容均可单独定义。只有当所选的**使用的模板**包含至少1个二维码时，该部分才可用。

参数	说明	数值
分隔符	定义条形码条目之间的分隔符。 仅当所选 <b>使用的模板</b> 包含多个二维码时，此设置才可用。	TAB*   表单传递   墨盒返回   空格   用户定义
条形码字段1	定义每个条形码中显示的信息。条形码字段的数量取决于所选的模板。	可用条目取决于方法设置。

\* 出厂设置

## 6.2.1.6.3 为称量品打印标签

参数	说明	数值
自动打印出称量品的标签	当设置为 <b>激活</b> 时，点击 <b>添加到结果</b> 时会自动打印称量品标签。	激活   非活动*
副本	定义打印标签的副本数量。	数字
使用的模板	选择标签模板。	可用标签如下所示。

\* 出厂设置

### 字段设置

每个标签字段的内容均可单独定义。

参数	说明	数值
标签字段1	定义每个标签字段内显示的信息。标签字段的数量取决于所选的模板。	可用条目取决于方法设置。

### 条形码设置





每个条码字段的内容均可单独定义。只有当所选的**使用的模板**包含至少1个二维码时，该部分才可用。

参数	说明	数值
分隔符	定义条形码条目之间的分隔符。 仅当所选 <b>使用的模板</b> 包含多个二维码时，此设置才可用。	TAB*   表单传递   墨盒返回   空格   用户定义
条形码字段1	定义每个条形码中显示的信息。条形码字段的数量取决于所选的模板。	可用条目取决于方法设置。

\* 出厂设置

### 6.2.1.6.4 可用标签

可选择以下标签布局：

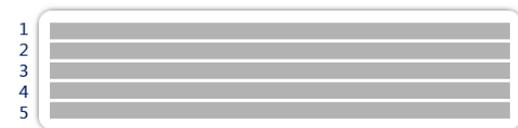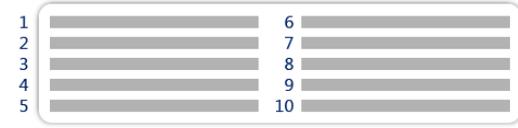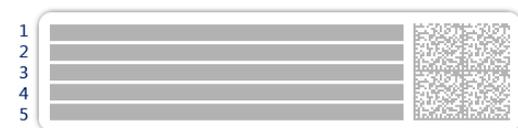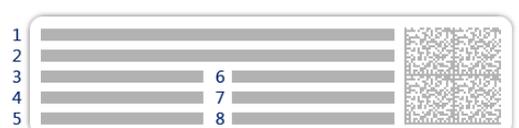 <p>1 2 3 4 5</p> <p>5个大字段</p>	 <p>1 2 3 4 5</p> <p>5个小字段</p>
 <p>1 2 3 4 5</p> <p>10个小字段</p>	 <p>1 2 3</p> <p>带3个大字段的1D条形码</p>
 <p>1 2 3</p> <p>带3个小字段的1D条形码</p>	 <p>1 2 3</p> <p>带6个小字段的1D条形码</p>
 <p>1 2 3 4 5</p> <p>带5个大字段的2D条形码</p>	 <p>1 2 3 4 5</p> <p>带5个小字段的2D条形码</p>
 <p>1 2 3 4 5</p> <p>带2个大字段和6个小字段的2D条形码</p>	 <p>1 2 3 4 5</p> <p>带8个小字段的2D条形码</p>

## 6.3 测试砝码设置

### 6.3.1 设置：单个校验砝码

≡ 导航：▼ 方法 > 测试 > 测试砝码 > 我的重量1 > 编辑

参数	说明	数值
测试砝码名称	定义测试砝码的名称。	文本（1...22个字符）
测试砝码ID	定义测试砝码ID。	文本（1...22个字符）
标称重量	定义实际重量的近似四舍五入值。	数字
砝码级别	按照OIML或ASTM定义砝码级别。另外，可以使用 <b>拥有</b> 创建自定义允差等级。	E1   E2   F1   F2   M1   M2   M3   ASTM000   ASTM00   ASTM0   ASTM0   ASTM1   ASTM2   ASTM3   ASTM4   ASTM5   ASTM6   ASTM7   拥有*
实际重量	定义实际重量。实际重量为具有砝码校准证书上特定常规质量值（CMV）的比重。	数字
下次校准日期	定义下一校准日期。	日期
证书	如果测试砝码的证书可用，请设置为 <b>激活</b> 并填写与证书相关的其他参数（参见下文）。	激活   非活动*
认证ID	定义证书ID。 仅当 <b>认证ID</b> 设定为 <b>激活</b> 时，此设置才可用。	文本（1...22个字符）
认证日期	定义证书日期。 仅当 <b>认证ID</b> 设定为 <b>激活</b> 时，此设置才可用。	日期
砝码组ID	定义砝码组ID。	文本（1...22个字符）

\* 出厂设置

### 6.3.2 设置：组合测试砝码

≡ 导航：▼ 方法 > 测试 > 测试砝码 > 我的重量1+2 > 编辑

参数	说明	数值
测试砝码名称	定义测试砝码的名称。	文本（1...22个字符）
标称重量	显示此组合砝码中所含所有单个砝码的标称重量之和。	数字
最小砝码级别	按照OIML或ASTM定义最低砝码级别。还可选择自定义允差类别 <b>拥有</b> 。 选择构成组合砝码的砝码时，仅显示级别大于等于所选 <b>最小砝码级别</b> 的各个砝码。	E1   E2   F1   F2   M1   M2   M3   ASTM000   ASTM00   ASTM0   ASTM0   ASTM1   ASTM2   ASTM3   ASTM4   ASTM5   ASTM6   ASTM7   拥有*

砝码	显示出可用的各个测试砝码的列表。总共有两个或三个测试砝码可供选择。 仅显示出级别大于等于所选 <b>最小砝码级别</b> 的各个砝码。	测试砝码列表
----	--	--------

\* 出厂设置

## 6.4 测试设置

### 6.4.1 设置：重复性测试

≡ 导航： ▾ 方法 > 📄 测试 > 📄 我的重复性测试 > ✎ 编辑

#### 1. 名称和类型

参数	说明	数值
测试类型	已预定义测试类型，在此菜单中无法修改测试类型。	可用的测试类型
名称	定义测试的名称。	文本（1...22个字符）
测试已激活	启用/禁用测试。	激活*   非活动
显示准备说明	如果激活，将在测试序列中显示预定义的准备说明。	激活*   非活动
自动打印	激活时，在计算出测试结果之后，将立即在启用的纸带打印机上打印测试结果。	激活   非活动*

\* 出厂设置

#### 2. 测试规格

参数	说明	数值
结果计算	计算结果时选择使用标称质量还是常规质量值（CMV）。 <b>基于标称重量：</b> 具有特定砝码等级的标称值。 <b>基于实际重量(CMV)：</b> 砝码校准证书上的砝码常规质量值（CMV）。	基于标称重量*   基于实际重量(CMV)
重复次数	定义一系列重量测量的次数。	数字（10*   2...15）

\* 出厂设置

#### 皮重

只有当**测试类型**设定为**重复性 - 去皮 - 1个测试点**时才会出现此部分。

参数	说明	数值
皮重名称	定义皮重的名称。	文本（1...22个字符）
最小皮重	为去皮容器定义最小称量值。只有在将至少达到此重量的去皮容器放置在天平上时，方可继续进行测试。	数字

\* 出厂设置

#### 测试点

参数	说明	数值
标称重量	定义将用于此测试的砝码标称值。	数字

砝码级别	按照OIML或ASTM定义砝码级别。另外，可以使用 <b>拥有</b> 创建自定义允差等级。	E1   E2   F1   F2   M1   M2   M3   ASTM000   ASTM00   ASTM0   ASTM1   ASTM2   ASTM3   ASTM4   ASTM5   ASTM6   ASTM7   拥有*
------	--	---

\* 出厂设置

### 测试限值

参数	说明	数值
控制限制	定义关于其设定值的过程错误允差。超出 <b>控制限制</b> 就是违反质量要求，因此需要校正过程。 最小值为天平可读性的40%。 超出 <b>控制限制</b> 的结果：测试失败，天平不合格。	数字
警告限制	定义相应上限或下限值，如果超出上限或未达到下限，则需要更严格的过程监测。 <b>警告限制</b> 必须小于 <b>控制限制</b> 。 超出 <b>警告限制</b> 的结果：测试失败，但是差值超过预期。	数字

### 3. 测试砝码

可选择配置的校验砝码。关于校验砝码定义与设置的信息，请见校验砝码与[测试砝码设置 ▶ 第100页]。

### 4. 错误管理

参数	说明	数值
锁定天平	定义测试失败后天平的行为。 <b>激活</b> ：当失败的测试次数达到指定数量后，天平将被锁定。在这种情况下，不可再次使用天平，直至具有适当权限的用户将天平解锁为止。 <b>非活动</b> ：未激活锁定功能。	激活   非活动*
允许的重试次数	定义锁定天平之前允许的最多重试次数。 仅当 <b>锁定天平</b> 设定为 <b>激活</b> 时，此设置才可用。	数字 (3*10..9)

\* 出厂设置

### 5. 测试计划

参数	说明	数值
计划类型	指定要执行测试的计划。 <b>手动</b> ：测试手动执行。 <b>每天</b> ：每天在指定时间生成一项任务。 <b>每周</b> ：每周至少生成一项任务。需要时可选择额外日期。 <b>每月</b> ：每月在指定的日期和时间生成一项任务。 <b>每季度</b> ：每三个月在指定时间生成一项任务。 <b>每年</b> ：每年在指定的时间生成一项任务。	手动*   每天   每周   每月   每季度   每年

开始时间	定义测试到期的时间。 仅当 <b>计划类型</b> 未设定为 <b>手动</b> 时，此设置才可用。	时间
------	---	----

\* 出厂设置

## 通知

当**计划类型**设定为**手动**时，此部分不出现。

参数	说明	数值
测试之前(x)小时	定义在发送通知以告知即将开始的计划测试之前的时间长度。	取决于所选频率（计划类型）的不同值。
每(x)小时通知	定义发布下一个通知之前的时间间隔。	取决于所选频率（计划类型）的不同值。

## 首选天数

只有当**计划类型**设定为**每周**时才会出现此部分。

参数	说明	数值
首选天数	定义执行测试的首选日。	星期一*   星期二*   星期三*   星期四*   星期五*   星期六   星期天

\* 出厂设置

## 首选执行日

只有当**计划类型**设定为**每月**时才会出现此部分。

参数	说明	数值
星期几	定义执行测试的首选日。 如果选中了 <b>无</b> ，将安排在最后一次执行后一个月内执行测试。	无*   星期一   星期二   星期三   星期四   星期五   星期六   星期天
该月的第几周	定义在当月哪一周执行测试。 仅当 <b>星期几</b> 未设定为 <b>无</b> 时，此设置才可用。	第一个*   第二个   第三个   第四个

\* 出厂设置

## 6. 打印

参数	说明	数值
页眉和脚注	定义要打印的页眉和/或页脚。	标题   标题文本   日期/时间   用户   签名   分割线   组标题
天平信息	定义要打印的天平相关信息。	天平类型   天平ID   天平序列号   软件版本
测试摘要	定义要打印的测试总结相关信息。	测试类型   测试名称   测试结果   标准偏差

测试详细信息	定义要打印的测试详情相关信息。	测试触发器   开始时调节水平   温度   准备说明   测试开始 (日期/时间)   测试结束 (日期/时间)   用户名
皮重规格	定义要打印的皮重规格相关信息。 本节仅适用于使用皮重进行测试。	皮重名称   最小皮重
测试砝码	定义要打印的测试砝码相关信息。	测试砝码ID   砝码级别   标称重量   实际重量   砝码组ID   认证ID   认证日期   下次校准日期   砝码类型   最小砝码级别   所用标称重量   所用实际重量
测试限值	定义要打印的测试限值相关信息。	警告限制   控制限制
测量/结果	定义要打印的测量和结果相关信息。	重量   状态   水平状态   零/去皮

#### 可参阅

[定义单个校验砝码](#) ▶ 第41页

[创建一个新测试](#) ▶ 第42页

## 6.4.2 设置：灵敏度测试

≡ 导航： ▼ 方法 > 测试 > 我的灵敏度测试 > 编辑

### 1. 名称和类型

参数	说明	数值
测试类型	已预定义测试类型，在此菜单中无法修改测试类型。	可用的测试类型
名称	定义测试的名称。	文本 (1...22个字符)
测试已激活	启用/禁用测试。	激活*   非活动
显示准备说明	如果激活，将在测试序列中显示预定义的准备说明。	激活*   非活动
自动打印	激活时，在计算出测试结果之后，将立即在启用的纸带打印机上打印测试结果。	激活   非活动*

\* 出厂设置

### 2. 测试规格

参数	说明	数值
结果计算	计算结果时选择使用标称质量还是常规质量值 (CMV)。 <b>基于标称重量：</b> 具有特定砝码等级的标称值。 <b>基于实际重量(CMV)：</b> 砝码校准证书上的砝码常规质量值 (CMV)。	基于标称重量*   基于实际重量(CMV)

\* 出厂设置

## 皮重

只有当选项**测试类型**设定为**灵敏度 - 去皮 - 1个测试点**或**灵敏度 - 去皮 - 2个测试点**时，此部分才出现。

参数	说明	数值
皮重名称	定义皮重的名称。	文本 (1...22个字符)
最小皮重	为去皮容器定义最小称量值。只有在将至少达到此重量的去皮容器放置在天平上时，方可继续进行测试。	数字

## 测试点

根据选择的测试，可为一个或两个测试点定义下列选项：

参数	说明	数值
标称重量	定义将用于此测试的砝码标称值。	数字
砝码级别	按照OIML或ASTM定义砝码级别。另外，可以使用 <b>拥有</b> 创建自定义允差等级。	E1   E2   F1   F2   M1   M2   M3   ASTM000   ASTM00   ASTM0   ASTM0   ASTM1   ASTM2   ASTM3   ASTM4   ASTM5   ASTM6   ASTM7   拥有*
控制限制	定义关于其设定值的过程错误允差。超出 <b>控制限制</b> 就是违反质量要求，因此需要校正过程。 超出 <b>控制限制</b> 的结果：测试失败，天平不合格。	数字
警告限制	定义相应上限或下限值，如果超出上限或未达到下限，则需要更严格的过程监测。 <b>警告限制</b> 必须小于 <b>控制限制</b> 。 超出 <b>警告限制</b> 的结果：测试失败，但是差值超过预期。	数字

\* 出厂设置

## 3. 测试砝码

可选择配置的校验砝码。关于校验砝码定义与设置的信息，请见校验砝码与[测试砝码设置 ▶ 第100页]。

## 4. 错误管理

参数	说明	数值
锁定天平	定义测试失败后天平的行为。 <b>激活</b> ：当失败的测试次数达到指定数量后，天平将被锁定。在这种情况下，不可再次使用天平，直至具有适当权限的用户将天平解锁为止。 <b>非活动</b> ：未激活锁定功能。	激活   非活动*
允许的重试次数	定义锁定天平之前允许的最多重试次数。 仅当 <b>锁定天平</b> 设定为 <b>激活</b> 时，此设置才可用。	数字 (3*   0...9)

\* 出厂设置

## 5. 测试计划

参数	说明	数值
计划类型	指定要执行测试的计划。 <b>手动</b> : 测试手动执行。 <b>每天</b> : 每天在指定时间生成一项任务。 <b>每周</b> : 每周至少生成一项任务。需要时可选择额外日期。 <b>每月</b> : 每月在指定的日期和时间生成一项任务。 <b>每季度</b> : 每三个月在指定时间生成一项任务。 <b>每年</b> : 每年在指定的时间生成一项任务。	手动*   每天   每周   每月   每季度   每年
开始时间	定义测试到期的时间。 仅当 <b>计划类型</b> 未设定为 <b>手动</b> 时, 此设置才可用。	时间

\* 出厂设置

### 通知

当**计划类型**设定为**手动**时, 此部分不出现。

参数	说明	数值
测试之前(x)小时	定义在发送通知以告知即将开始的计划测试之前的时间长度。	取决于所选频率(计划类型)的不同值。
每(x)小时通知	定义发布下一个通知之前的时间间隔。	取决于所选频率(计划类型)的不同值。

### 首选天数

只有当**计划类型**设定为**每周**时才会出现此部分。

参数	说明	数值
首选天数	定义执行测试的首选日。	星期一*   星期二*   星期三*   星期四*   星期五*   星期六   星期天

\* 出厂设置

### 首选执行日

只有当**计划类型**设定为**每月**时才会出现此部分。

参数	说明	数值
星期几	定义执行测试的首选日。 如果选中了 <b>无</b> , 将安排在最后一次执行后一个月内执行测试。	无*   星期一   星期二   星期三   星期四   星期五   星期六   星期天
该月的第几周	定义在当月哪一周执行测试。 仅当 <b>星期几</b> 未设定为 <b>无</b> 时, 此设置才可用。	第一个*   第二个   第三个   第四个

\* 出厂设置

## 6. 打印

参数	说明	数值
页眉和脚注	定义要打印的页眉和/或页脚。	标题   标题文本   日期/时间   用户   签名   分割线   组标题
天平信息	定义要打印的天平相关信息。	天平类型   天平ID   天平序列号   软件版本
测试摘要	定义要打印的测试总结相关信息。	测试类型   测试名称   测试结果
测试详细信息	定义要打印的测试详情相关信息。	测试触发器   开始时调节水平   温度   准备说明   测试开始 (日期/时间)   测试结束 (日期/时间)   用户名
皮重规格	定义要打印的皮重规格相关信息。 本节仅适用于使用皮重进行测试。	皮重名称   最小皮重
测试砝码	定义要打印的测试砝码相关信息。	测试砝码ID   砝码级别   标称重量   实际重量   砝码组ID   认证ID   认证日期   下次校准日期   砝码类型   最小砝码级别   所用标称重量   所用实际重量
测试限值	定义要打印的测试限值相关信息。	警告限制   控制限制
测量/结果	定义要打印的测量和结果相关信息。	重量   偏差   状态   水平状态   零/去皮

### 可参阅

[🔗 定义单个校验砝码 ▶ 第41页](#)

[🔗 创建一个新测试 ▶ 第42页](#)

## 6.5 校正设置

☰ 导航: ▼ 方法 > 📄 校正 > 📄 内部校正 > ✎ 编辑

### 1. 策略

参数	说明	数值
策略	定义要执行的校正类型。 当策略设定为 <b>无校正</b> 或 <b>外部校正</b> 时, 没有其他设置可用。 对于经过认证的天平, 该设置设定为 <b>内部校正</b> 且不可编辑。	内部校正*   外部校正   无校正

自动打印	激活时，在计算出结果之后，将立即在启用的纸带打印机上打印校正结果。	激活   非活动*
------	-----------------------------------	-----------

\* 出厂设置

## 2. 规格

参数	说明	数值
“校前”测试	校正序列开始时，将自动执行内部灵敏度测试以评估当前状态。将显示出测试结果并进行记录。	激活   非活动*
“校后”测试	完成校正后，将自动执行内部灵敏度测试。将显示出测试结果并进行记录。	激活   非活动*

\* 出厂设置

## 限制

只有当激活“校前”测试或“校后”测试选项中的一个时，这些设置才显示。

参数	说明	数值
控制限制	定义关于其设定值的过程错误允差。超出 <b>控制限制</b> 就是违反质量要求，因此需要校正过程。 超出 <b>控制限制</b> 的结果：校正失败，天平不合格。	数字 (0.1%*   0.001...100%)
警告限制	定义相应上限或下限值，如果超出上限或未达到下限，则需要更严格的过程监测。 <b>警告限制</b> 必须小于 <b>控制限制</b> 。 超出 <b>警告限制</b> 的结果：校正通过，但是差值超过预期。	数字 (0.001...100%)

\* 出厂设置

## 3. 错误管理

参数	说明	数值
锁定天平	定义校正失败后天平的措施。 <b>激活</b> ：校正失败后天平将被锁定。在这种情况下，不可再次使用天平，直至具有适当权限的用户将天平解锁为止。 <b>非活动</b> ：天平将不会被锁定。	激活   非活动*

\* 出厂设置

## 4. 计划

参数	说明	数值
水平调节后启动	定义在水平调节后是否开始内部校正。	激活   非活动*
温度变化后启动	定义在出现1°C温度变化后是否自动开始内部校正。 对于经认证的天平，该设置设定为 <b>内部校正</b> 且不可编辑。 此限制不适用于/AC类天平。	激活   非活动*
计划	定义执行校正的时间。可为每天定义1至3个开始时间。也可定义执行校正的日期。	非活动   1个启动时间   2个启动时间*   3个启动时间
启动时间1	定义执行任务的开始时间。 要定义的开始时间的数量由 <b>计划</b> 指定。	时间

首选天数	定义预定校正的天数。 仅当 <b>计划</b> 未设定为 <b>非活动时</b> ，此设置才可用。	星期一   星期二   星期三   星期四   星期五   星期六   星期天
------	--	---

\* 出厂设置

## 5. 打印

参数	说明	数值
页眉和脚注	定义要打印的页眉和/或页脚。	标题   标题文本   日期/时间   用户   签名   分割线   组标题
天平信息	定义要打印的天平相关信息。	天平类型   天平ID   天平序列号   软件版本
校正摘要	定义要打印的校正摘要相关信息。	校正类型   校正状态   天平已校正
校正详细信息	定义要打印的校正详情相关信息。	触发器   传感器温度   水平状态   日期/时间   用户名
校正重量	定义要打印的校正砝码相关信息。 本节仅适用于使用外部砝码进行校正的情况。	测试砝码ID   砝码级别   标称重量   实际重量   砝码组ID   认证ID   认证日期   下次校准日期   砝码类型   最小砝码级别   所用标称重量   所用实际重量
校正限值	定义要打印的校正限值相关信息。 本节仅适用于内部校正。	警告限制   控制限制
测量/结果	定义要打印的测量和结果相关信息。 本节中可用的设置视校正策略而定。	修正   “校前”测试偏差   “校后”测试偏差   “校前”测试结果   “校后”测试结果

### 可参阅

- [🔗 定义单个校验砝码 ▶ 第41页](#)
- [🔗 编辑“内部校正” ▶ 第49页](#)
- [🔗 编辑“外部校正” ▶ 第49页](#)

## 7 维护

为了保证天平的功能性和称量结果的准确性，用户必须执行一些保养。  
适当的维护时间间隔取决于您的标准操作流程（SOP）。

### 7.1 维护任务

维护作业	推荐的维护间隔	备注
进行内部校正	<ul style="list-style-type: none"><li>• 每天</li><li>• 清洁后</li><li>• 调平后</li><li>• 更换放置位置后</li></ul>	参见"校正"
执行日常测试（重复性测试、灵敏度测试）。 METTLER TOLEDO 建议至少执行一次灵敏度测试。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 清洁后</li><li>• 安装天平后</li><li>• 软件升级后</li><li>• 取决于您的内部规定(SOP)</li></ul>	请参阅"测试"
清空容器	<ul style="list-style-type: none"><li>• 取决于仪器的使用频率</li><li>• 取决于您的内部规定(SOP)</li></ul>	请参阅"清空容器"
清洁	<ul style="list-style-type: none"><li>• 每次使用后</li><li>• 根据污染度</li><li>• 取决于您的内部规定(SOP)</li></ul>	请参阅"清洁"
更新软件	<ul style="list-style-type: none"><li>• 取决于您的内部规定（SOP）。</li><li>• 新软件发布后。</li></ul>	参见"软件更新"

#### 可参阅

- [🔗 校正 ▶ 第49页](#)
- [🔗 测试 ▶ 第41页](#)
- [🔗 清空容器 ▶ 第111页](#)
- [🔗 清洁 ▶ 第113页](#)
- [🔗 软件升级 ▶ 第116页](#)

## 7.2 清空容器

### 7.2.1 组装泵



#### 警告


##### 触电会造成重伤或死亡

接触带电零件有可能造成伤害。

- 1 仅使用仪器专用METTLER TOLEDO电源线和交流/直流适配器。
- 2 将电源线连接至接地电源插座。
- 3 将所有电缆与接头放置在远离液体和潮湿的地方。
- 4 检查电缆与电源插头有无损坏，如有损坏请更换。

在正常使用过程中，移液罐和防蒸发阱凹槽中含有水。该泵可以安全有效地除水，而无需拆卸仪器。入口软管连接有金属管，便于操作。出口软管用于处置抽吸的液体。

- 1 以这种方式安装电缆，确保其不会受损或干扰操作。
- 2 将交流/直流适配器(1)插头插入插座。
- 3 用力拧紧螺母，紧固插头。
- 4 将电源插头插入接地电源插座中。
- 5 将带有金属管(2)的软管连接至吸嘴IN(3)。
- 6 将另一根软管连接至吸嘴OUT(4)。
- 7 将软管的自由端插入适合盛放废液(5)的容器中。

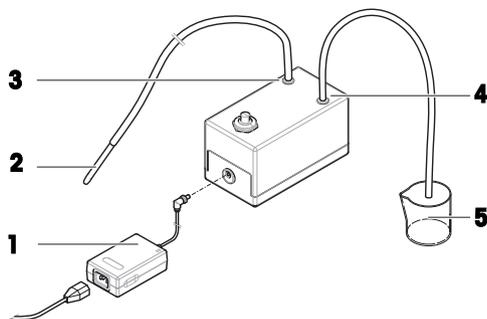

### 7.2.2 清空移液容器

必须定期清空移液容器，防止溢出。




#### 注意

##### 操作不当会导致泵损坏

不使用泵时将其打开，否则可能会将其损坏。

- 不使用泵时将其关闭。

- 泵已组装。
- 出口软管放在适合废液的容器中。
- 1 激活挡光板(1)，或按↑。
  - ➔ 防蒸发阱门(2)打开。
- 2 将金属管(3)插入移液容器(4)中。
- 3 打开泵(5)。
  - ➔ 液体被抽出并收集到容器中，用于处理废液。
- 4 关闭泵(5)。
- 5 重新组装天平。
- ➔ 天平已经准备好可以使用了。

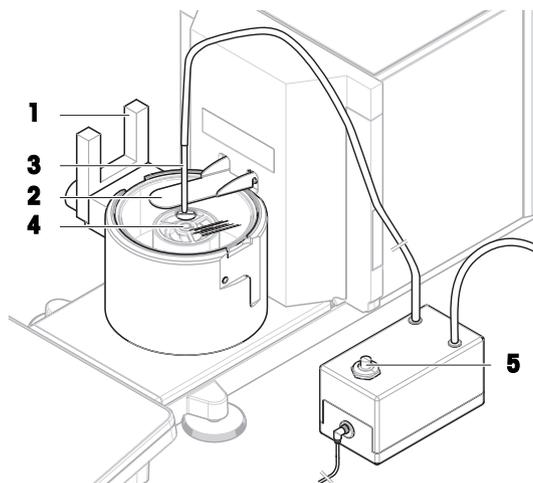

#### 可参阅

🔗 组装泵 ▶ 第111页

### 7.2.3 情况防蒸发阱容器




#### 注意

#### 操作不当会导致泵损坏

- 不使用泵时将其打开，否则可能会将其损坏。
- 不使用泵时将其关闭。


- 泵已组装。
- 出口软管放在适合废液的容器中。
- 1 拆除防蒸发阱门(1)。
- 2 小心地取下防蒸发阱盖(2)。

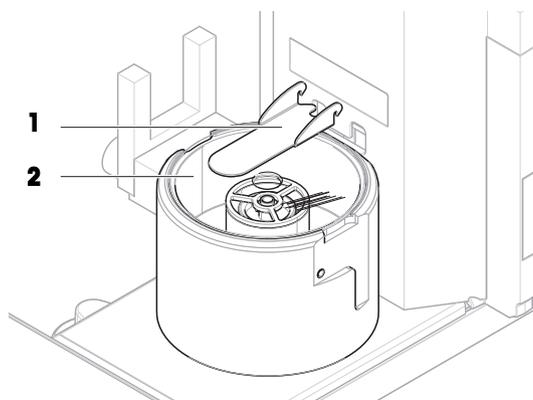

- 3 将金属管(3)插入防蒸发阱容器(4)中。
- 4 打开泵(5)。
  - ➔ 液体被抽出并收集到容器中，用于处理废液。
- 5 如果需要，使用泵清空移液容器(6)，请参阅 [清空移液容器 ▶ 第111页]。
- 6 关闭泵(5)。
- 7 或者，卸下防蒸发阱容器(4)将其清空。
- 8 重新组装天平。

#### 可参阅


🔗 组装泵 ▶ 第111页

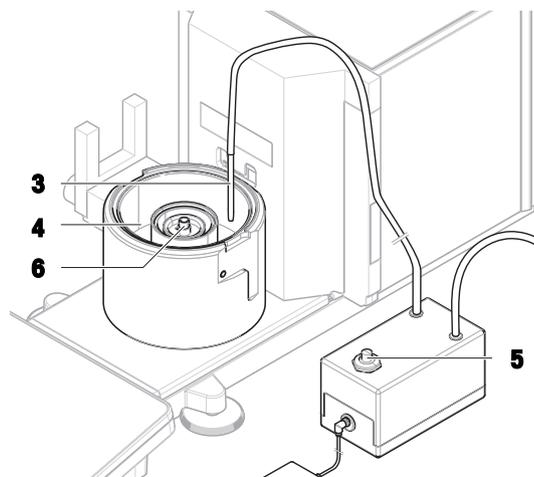


## 7.3 清洁

### 7.3.1 拆卸进行清洁


- 容器已清空，请参阅[清空容器 ▶ 第111页]。
  - 关闭天平，请参阅[关闭天平 ▶ 第31页]。
- 1 卸下固定螺钉(1)并将挡光板(2)放在一边。
  - 2 拆除防蒸发阱门(3)。
  - 3 小心地取下防蒸发阱盖(4)。

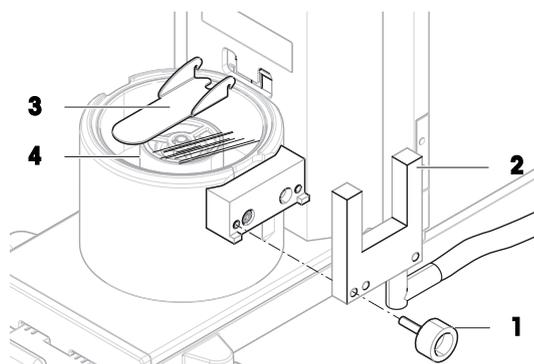

- 4 拆卸定心环(5)。
- 5 小心抬起并取下带有防蒸发容器(6)的移液底座(7)。

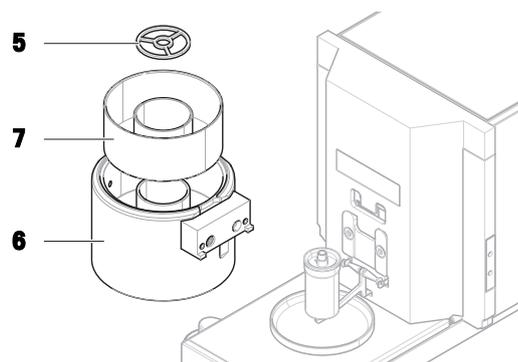

- 6 取下移液容器(8)并拧下固定移液管的盖子(9)。
- 7 小心地取下移液容器支架(10)。
- 8 取下承水盘(11)。

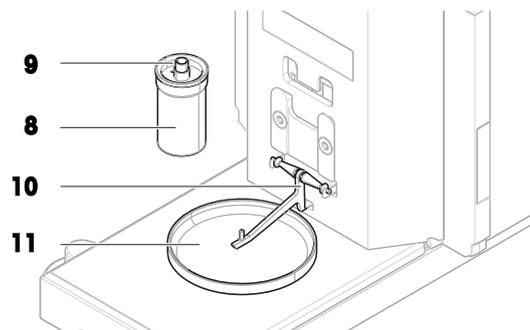

### 7.3.2 清洗剂

下表列出了METTLER TOLEDO推荐的清洁工具及清洗剂。注意表中指定的清洗剂浓度。

		工具			清洗剂						
		纸巾	毛刷	洗碗机	水	丙酮	乙醇 (70%)	异丙醇 (70%)	盐酸 (3-10%)	氢氧化钠 (0.2-1.0 M)	过氧乙酸 (2-3%)
天平周围	天平外壳	✓	R	—	R	—	R	✓	R	R	R
	支脚	✓	R	—	R	—	R	✓	R	R	R
天平终端	显示操作终端	✓	R	—	✓	PR	R	R	R	R	R
	显示屏	✓	—	—	✓	PR	R	R	R	R	R
	终端保护罩	✓	R	—	✓	—	R	R	R	PR	PR
防蒸发阱	防蒸发阱容器	✓	—	—	✓	PR	R	R	R	R	—
	防蒸发阱盖 (玻璃)	✓	R	R	R	PR	✓	✓	R	R	R
	防蒸发阱门	✓	R	R	✓	R	R	R	—	—	—
称量区域	移液容器	✓	—	—	✓	R	R	R	—	—	PR
	移液容器支架	✓	—	—	✓	R	R	R	—	—	—
	定心环	✓	—	—	✓	R	R	R	—	—	—
	移液底座	✓	—	—	✓	R	R	R	—	—	PR
	挡光板	✓	—	—	✓	PR	R	R	R	R	—
	滴水盘	✓	—	—	✓	R	R	R	—	—	PR
校准套件	秤盘	✓	—	—	✓	R	R	R	—	—	PR
	盖环	✓	—	—	✓	R	R	R	—	—	—
	防风罩	✓	—	—	✓	R	R	R	—	—	—
泵	泵外壳	✓	R	—	R	—	R	✓	R	PR	R

## 插图

- ✓ METTLER TOLEDO的最佳推荐；可以放心使用，没有任何限制。
- R METTLER TOLEDO推荐；可以放心使用，没有任何限制。
- PR METTLER TOLEDO部分推荐：必须评估对酸和碱的单独耐受性，包括对接触时间的依赖度。
- 不推荐。极易损坏。

### 7.3.3 清洁天平



#### 注意

##### 因清洗方法不正确而损坏仪器

如果液体进入外壳，则有可能损坏仪器。某些清洗剂、溶剂或研磨剂可能会损坏仪器表面。

- 1 请勿向仪器喷洒或倾倒液体。
- 2 仅使用仪器参考手册（RM）或指南“8 Steps to a Clean Balance”中指定的清洁剂。
- 3 务必使用略微湿润的无绒布或纸巾清洁仪器。
- 4 立即拭去任何溅出物。



关于清洁天平的更多信息，请参阅“8 Steps to a Clean Balance”。

► [www.mt.com/lab-cleaning-guide](http://www.mt.com/lab-cleaning-guide)

#### 清洁天平的周围

- 去除天平周围的任何灰尘或污垢，避免进一步的污染。

#### 清洁终端

- 使用湿布或纸巾及温和清洗剂清洁终端。

#### 清洁可拆卸部件

- 使用湿布或纸巾及中性清洁剂对拆下的部件进行清洁。

#### 清洁称量单元

- 1 断开天平与AC/DC适配器的连接。
- 2 使用沾湿温和清洗剂的无绒布清洁天平表面。
- 3 首先使用一次性纸巾清除粉末或灰尘。
- 4 使用湿的无绒软布和温和溶剂（如70%的异丙醇或乙醇）清除粘性物质。

### 7.3.4 溢出后清洁

如果发生溢出（例如：当过量灌装移液容器时），必须立即去除多余液体。

- 1 使用泵清空防蒸发阱容器，请参阅[情况防蒸发阱容器 ▶ 第112页]。
- 2 使用泵清空移液容器，请参阅[清空移液容器 ▶ 第111页]。
- 3 拆卸其余物品，并用无绒布或纸巾清洁，请参阅[拆卸进行清洁 ▶ 第113页]。
- 4 重新组装天平。

#### 可参阅

 组装泵 ▶ 第111页

### 7.3.5 清洁后投入使用

- 1 重新组装天平。
- 2 显示终端是否已连接天平。
- 3 重新将天平连接至交流/直流适配器。
- 4 检查水平状态，必要时调平天平。
- 5 请遵守“技术资料”中规定的预热时间。
- 6 执行内部校正。
- 7 根据您公司的内部规程进行一次常规测试。METTLER TOLEDO建议在清洁天平后进行一次灵敏度测试。
- 8 按**→0←**可将天平归零。  
➔ 天平已经准备好可以使用了。

#### 可参阅

 技术参数 ▶ 第121页

 进行内部校正 ▶ 第29页

 调节天平水平 ▶ 第29页

 执行“灵敏度测试” ▶ 第46页

## 7.4 服务

由获授权的服务技术人员定期进行维护，以确保未来数年可靠运行。有关可用服务选项的详细信息，请联系当地METTLER TOLEDO代表。

## 7.5 软件升级

搜索软件：

▶ [www.mt.com/labweighing-software-download](http://www.mt.com/labweighing-software-download)

如需获得更新软件方面的支持，请联系METTLER TOLEDO服务代表。

METTLER TOLEDO 建议在更新软件之前将数据保存在存储设备上。

≡ 导航： ▶ 天平菜单 >  维护 >  软件更新

#### 可参阅

 导出和导入设置 ▶ 第64页

### 7.5.1 更新软件

- 将包含软件安装程序（zip文件格式）的USB存储设备连接到天平。
  - 1 点击 软件更新。
  - 2 选择 **更新软件** 并点击**→下一步**。  
➔ 更新向导打开，将会引导您逐步完成程序。

## 7.5.2 将软件恢复至以前版本

当前的软件版本可回滚至之前的软件版本。

- 1 点击  软件更新。
- 2 选择将软件恢复到以前版本。并点按 **→ 下一步**。
  - ➔ 更新向导打开，将会引导您逐步完成程序。

## 7.5.3 软件更新后投入使用

- 1 按下  打开天平。
- 2 检查水平状态，必要时调平天平。
- 3 执行内部校正。
- 4 根据您公司的内部规程进行日常测试。
- 5 按 **→0←** 可将天平归零。
  - ➔ 天平已经准备好可以使用了。

### 可参阅

-  调节天平水平 ▶ 第29页
-  进行内部校正 ▶ 第29页

## 8 故障排除

下一章介绍了可能的错误及其原因和补救措施。如果按照这些说明无法修复错误，则联系METTLER TOLEDO。

### 8.1 错误信息

错误信息	可能原因	诊断	补救措施
天平重置失败	通信故障	—	断开电源线并于几秒之后重新连接。
系统未设置有效的日期和时间	电池电量低	—	连接电源插座，让电池充电2到3天。
无法确定重量	电子元件的数据信号问题。	—	断开电源线并于几秒之后重新连接。
	操作终端和称量装置之间的连接故障。	检查电缆是否受损（扭结、缠绕或针脚折断）。	更换操作终端电缆。
	设备发生错误。	检查服务菜单中是否列出了设备错误，参见[服务菜单 ▶ 第89页]。点击 <b>设备错误</b> 。	记录错误代码并联系当地METTLER TOLEDO服务代表。
无法启动校正	天平打开时未达到初始零点。	—	断开电源线，几秒之后重新连接。
预防性的性能优化	天平内存(RAM)已满。	—	完成当前任务。断开电源线并于几秒之后重新连接。

可参阅

 服务菜单 ▶ 第90页

### 8.2 出错现象

错误现象	可能原因	诊断	补救措施
显示屏变暗。	仪器处于待机模式。	—	打开仪器。
	无电源。	检查与AC/DC适配器和电源插座的连接。	将称量装置连接至电源插座。请参阅"连接天平"
	操作终端未连接仪器。	检查操作终端电缆连接。	检查仪器的操作终端连接线缆。
	操作终端电缆损坏。	检查电缆是否受损（扭结、缠绕或针脚折断）。	更换操作终端电缆。
	仪器连接了错误的AC/DC适配器。	请参阅"技术资料"进行检查。	使用正确的AC/DC适配器。
	AC/DC适配器损坏。	—	更换AC/DC适配器。

错误现象	可能原因	诊断	补救措施
显示器上的值忽高忽低。	称量台上有振动干扰（如建筑振动、人走动）	将盛有水的烧杯放在称量台面上。振动会导致水面波动。	保护称量位置，使其免受振动干扰（例如使用减震装置）。 寻找其他称量位置。
	由于防风罩不紧密和/或打开的窗户导致气流流动。	检查防风罩是否有缝隙。	紧固防风罩。 关闭窗口。
	该位置不适合称量。	—	遵循该位置的要求。请参阅"选择位置"。
	有东西接触到移液容器或称盘。	检查接触的部件或污垢。	取下接触部件。 清洁天平。
显示器上的值发生增/减漂移。	防蒸发阱容器已清空。	检查防蒸发阱容器内是否有足量的水。	将防蒸发阱容器注满水，请参阅"给防蒸发阱容器注水"。
	移液容器外部有水滴。	检查移液容器外部是否潮湿。	清洁移液容器的外部。
	移液器吸取的水比防蒸发阱内的空气热或冷。	检查使用适应环境的水时称量结果是否稳定。	将水加热至室温。
	天平尚未预热。	—	使天平预热。"通用数据"中详细说明了预热时间多久为足够。
显示器显示超载或欠载。	未正确安装移液容器。	轻轻抬起或按压移液容器，查看显示器是否显示质量。检查移液容器是否可以自由移动。	正确安装移液容器，请参阅"组装天平"。
	安装的秤盘错误。	轻轻抬起或按压秤盘，查看显示器是否显示质量。	安装正确的秤盘。
	未安装秤盘。	—	安装正确的秤盘。
	通电时零点不正确。	—	断开电源线并于几秒之后重新连接。
	天平未调整。	—	执行内部调整，请参阅"内部调整"。
激活光栅板时，防蒸发阱门不能打开/关闭。	仪器处于待机模式。	—	打开仪器。
	光栅板未连接到天平。	检查电缆是否已连接。	正确连接电缆。
	天平未正确检测到光栅板。	—	断开光栅板电缆与天平的连接。从设备列表中删除光栅板，请参阅"删除设备"。将光栅板连接至天平。

错误现象	可能原因	诊断	补救措施
	挡光板或门马达出现故障。	点击终端的⬆️，检查防蒸发阱门是否打开/关闭。如果起作用，则说明光栅板存在缺陷。如果不起作用，则说明光栅板或门马达出现故障。	更换光栅板。 请联 METTLER TOLEDO代表更换门马达。
用户界面响应迟缓。	任务的结果列表中包含太多结果。	检查每个正在运行和待处理任务的结果列表。	完成所有任务：对于任务列表中的每项任务，选择该任务，点击继续任务然后点击完成。

### 8.3 修复错误后投入使用

修复错误之后，执行以下步骤，将天平投入使用：

- 确保天平完全重新组装并已清洁。
- 重新将天平连接至交流/直流适配器。

## 9 技术参数

### 9.1 通用数据

#### 电源

交流/直流适配器（型号 FSP060-DHAN3）：	输入：100 – 240 V AC $\pm$ 10%，50 – 60 Hz，1.8 A 输出：12 V DC，5 A，LPS，SELV
交流/直流适配器（型号 FSP060-DIBAN2）：	输入：100 – 240 V AC $\pm$ 10%，50 – 60 Hz，1.5 A 输出：12 V DC，5 A，LPS，SELV
交流/直流适配器用电缆：	3芯，配有国家专用插头
天平功耗：	12 V DC $\pm$ 10%，2.25 A
极性：	

#### 保护与标准

过压类别：	II
污染度：	2
安全性和EMC标准：	请参阅符合性声明
应用范围：	仅用于室内干燥的地方

#### 环境条件

当天平在以下环境条件下使用时，则适用以下这些限值：

平均海拔高度：	最高5000 m
环境温度：	+10 至 +30 °C
最大温度变化：	5 °C/h
空气相对湿度：	30–70%，无冷凝现象
适应环境的时间：	仪器放置在与投入使用位置相同的位置后至少 <b>8小时</b> 。
预热时间：	天平接通电源后至少 <b>120分钟</b> 。从待机模式开启后，仪器随即做好操作准备。

天平可在以下环境条件下使用。但是，天平的称量性能可能超出限值：

环境温度：	+5 – +40 °C
空气相对湿度：	气温在31 °C时，空气湿度为20%至最大80%，气温达到40 °C时，空气湿度线性下降至50%，无冷凝现象

在以下条件下，可将天平断开连接并存储在其包装中：

环境温度：	-25 – +70 °C
空气相对湿度：	10–90%，无冷凝现象


## 9.2 关于梅特勒-托利多交流/直流适配器附注

经认证的外置AC/DC适配器符合II类双重绝缘设备的要求。它没有提供保护性接地接头，但具有用于EMC目的的功能性接地接头。这种接地接头**并非**安全装置。有关我们产品合规性的更多信息，请参阅每种产品随附的“符合性声明”。

在按照2001/95/EC欧盟指令进行测试时，必须将AC/DC适配器和仪器当作II类双重绝缘设备来处理。

因此，不需要进行接地测试。无需在电源插头接地连接器和仪器金属外壳的任何外露部分之间进行接地测试。

因为仪器对静电荷非常敏感，所以在接地连接器（1）和AC/DC适配器的负极（2）之间连接了一个10 kΩ的漏电电阻器。具体连接如等效电路图中所示。此电阻器不属于电气安全装置中的一部分，因此不需要定期进行测试。

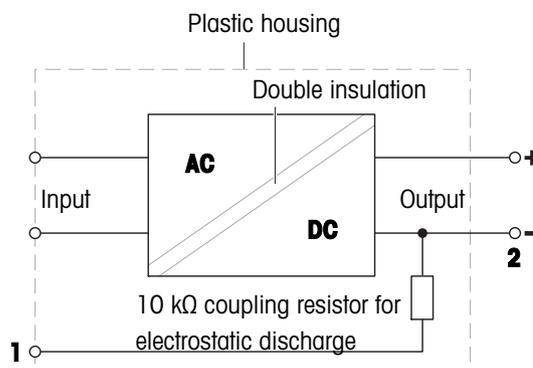

### 9.3 型号——技术参数

	<b>XPR26PC</b>
--	----------------

#### 极限值

最大称量	22 g
额定载荷	20 g
可读性	0.001 mg
重复性 (标称载荷下)	0.0025 mg
重复性 (5%载荷下)	0.0015 mg
线性偏差	0.01 mg
灵敏度偏移 (标称加载下) ▲	0.08 mg
灵敏度温度漂移	0.0001%/°C

#### 典型值

重复性 (5%载荷下)	0.0007 mg
线性偏差	0.003 mg
偏载误差 (测试载荷下)	0.006 mg (10 g)
灵敏度偏移 (标称加载下) ▲	0.05 mg
最小称量值 (USP, 允差 = 0.10%) ▼	1.4 mg
最小称量值 (允差 = 1%) ▼	0.14 mg
稳定时间	3.5 s

#### 外形尺寸和其它规格

天平外形尺寸 (宽 × 长 × 高)	195 × 485 × 292 mm
天平重量	10.1 kg

#### 用于日常测试的砝码


砝码 (OIML等级)	20 g (F1) / 1 g (F1)
砝码 (ASTM等级)	20 g (ASTM 1) / 1 g (ASTM 1)

▲ 使用内置砝码进行调整之后

▼ 在5%载荷、k = 2时测定

## 9.4 外形尺寸

型号: XPR26PC

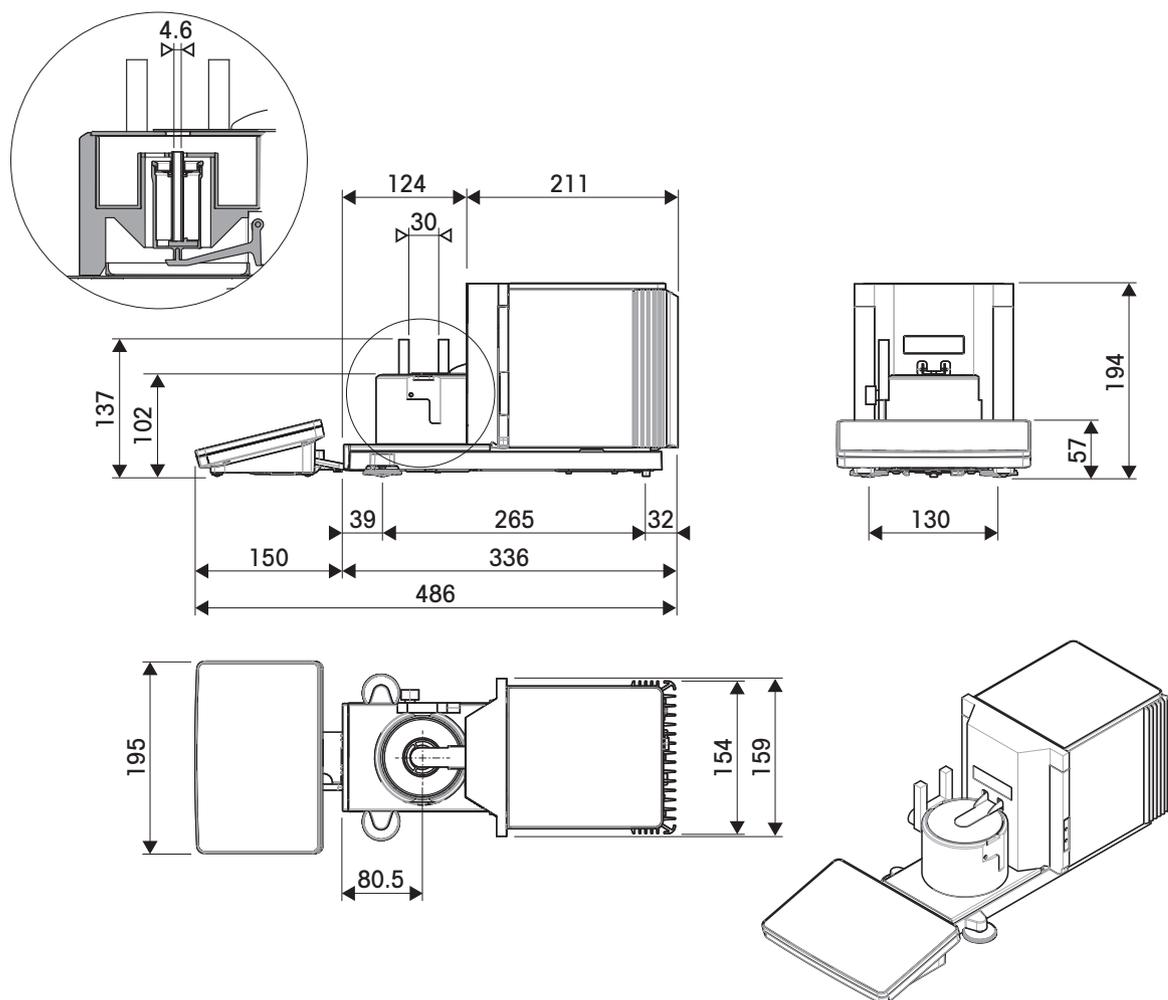

↔	外形尺寸 [mm]
↔	净外形尺寸 [mm]

## 10 丢弃

根据关于废弃电气和电子设备 (WEEE) 的欧洲指令 2012/19/EU，此设备不得作为生活垃圾处理。这也适用于欧盟以外的国家，参照他们的具体要求。

请在电气和电子设备指定的收集点按照当地规定处理此产品。如有任何疑问，请与相关部门或您购买时的经销商联系。



## 11 配件和备件

### 11.1 附件

附件是可以在工作流程中提供帮助的附加组件。

	说明	订购号
<b>移液器校准</b>		
	校准套件（无调整/测试砝码）	11140044
	加样槽，5 件	11600616
	气压计	11600086
	已校准的温度计	11132685
<b>去静电组件</b>		
	带有支架的紧凑式去静电装置（USB）	30499859
	带支架的紧凑式去静电装置（30499859）所用的附加紧凑式去静电装置（USB）	30496446

## 打印机



CLS-631标签打印机(RS232C/USB-A)

11141820

标签和色带套件

30004309

此款打印机可能需要NetCom套件。联系您当地的METTLER TOLEDO服务代表。



P-52RUE点阵打印机, 带RS232C、USB和以太网接口, 简单打印输出

30237290

纸卷(长度: 20米), 一套5卷

00072456

纸卷(长度: 13米), 自粘型, 一套3卷

11600388

色带, 黑色, 一套2个

00065975



P-56RUE热敏打印机, 带有RS232C、USB和以太网接口、简单打印输出、日期和时间

30094673

白色纸卷(长度: 27米), 一套10张

30094723

白色自粘型纸卷(长度: 13米), 一套10张

30094724



P-58RUE热敏打印机, 带有RS232C、USB和以太网接口、简单打印输出、日期和时间、标签打印、天平应用程序(例如: 统计、配方、总计)

30094674

白色纸卷(长度: 27米), 一套10张

30094723

白色自粘型纸卷(长度: 13米), 一套10张

30094724

白色纸卷, 自粘型标签(550个标签), 一套6张

30094725

标签尺寸56×18 mm

## 防盗装置



防盗电缆(带锁)

11600361

## RFID阅读器/写入器/卡片



EasyScan USB

30416173

读和写RFID标签。




智能标签

每套 50 件

30101517

每套 200 件

30101518



### MethodCard

每套 5 件

30300929

每套 25 件

30300930

### 解放双手配件



脚踏开关，远程操作的可选开关（USB连接）

30312558



ErgoSens，远程操作的光感应器（USB连接）

30300915

### 条形码阅读器



有线USB条形码阅读器

30417466

### RS232C接口电缆



USB-RS232电缆（通过RS232C将仪器连接至USB端口）

64088427



带集成零调制解调器的USB-RS232电缆（通过RS232C将外围设备和计算机连接至XPR/XSR天平）

30576241

### 无线接口



蓝牙RS232C串行适配器ADP-BT-S

30086494

用于以下无线连接：

- 仪器和计算机（具体取决于仪器型号）
- 打印机和仪器



蓝牙USB适配器，用于无线连接到P-5x打印机  
(需要额外的蓝牙RS232串行适配器30086494)

30416089

## 天平台



称量台

30404636

## 软件



Calibry PC 软件  
Calibry Express; 用于单通道移液器

11138423



Calibry Single Workstation; 利用一个系统 MCP 进行校准

11138419



Calibry Network; 安装在网络中访问相同数据库的多台 PC 上

11138420

## CarePacs



CarePac OIML

30550617



CarePac ASTM

11123106

## 校正砝码



OIML / ASTM 砝码 (带校准证书)  
▶ [www.mt.com/weights](http://www.mt.com/weights)

## 其它



EasyHub USB

30468768




终端延长电缆, 长度: 4.5 m

30300920

## 11.2 备件


备件是指与原始仪器一起交付的部件，但如果需要，可以在没有服务技术人员帮助的情况下进行更换。

### 11.2.1 天平

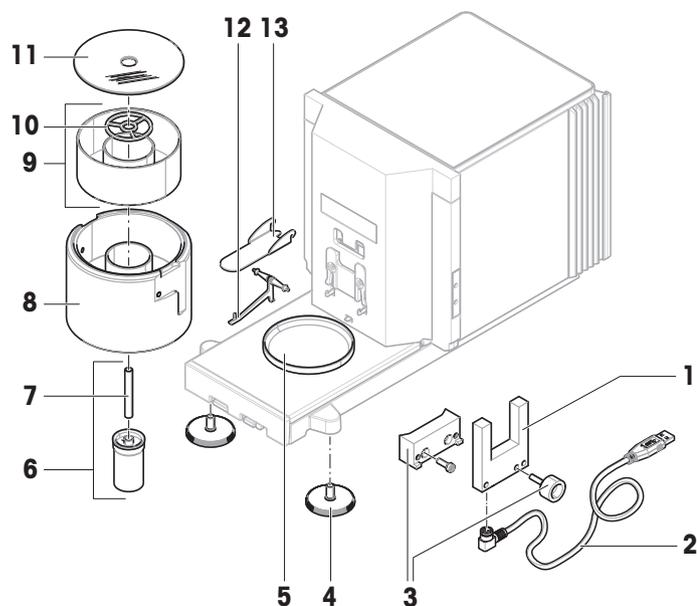


	订单号	指定	备注
1	30521637	光栅板	—
2	30460312	光栅板电缆	—
3	30521728	固定螺钉和光栅隔板	—
4	30460287	水平调节脚，组件	包括：2个水平调节脚
5	30521632	盛水盘	—
6	11107917	移液容器	包括：移液管
7	30521634	移液管	材料：玻璃
8	30521729	移液底座	—
9	30521635	防蒸发阱容器	—
10	30538437	定心环	—
11	30521636	防蒸发阱盖	材料：玻璃
12	30521633	用于移液容器的支架	—
13	30460313	防蒸发阱门	—

## 11.2.2 泵

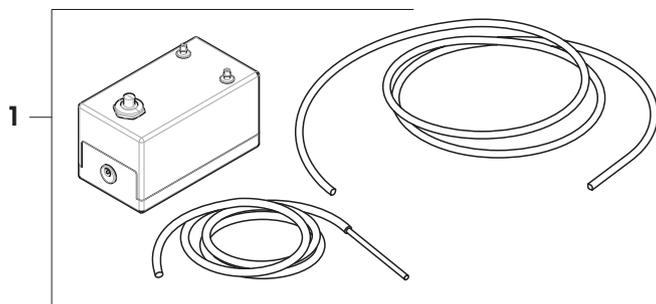


	订单号	指定	备注
1	30676828	吸液泵	包括：1条带金属管的软管，1条不带金属管的软管

### 11.2.3 杂项

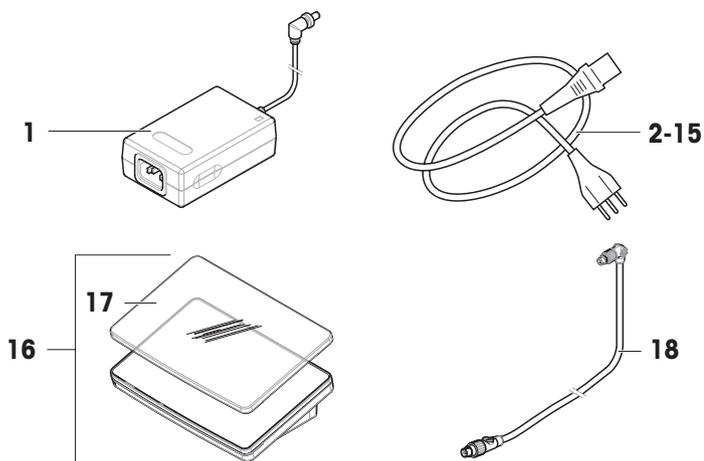

	订单号	指定	备注
1	30388323	交流/直流适配器	输出: 12 V DC, 5 A
2	88751	澳大利亚电力电缆	—
3	30015268	英国电缆	—
4	87920	瑞士电缆	—
5	30047293	中国电缆	—
6	87452	丹麦电缆	—
7	87925	欧盟电缆	—
8	89405	英国电缆	—
9	225297	以色列电缆	—
10	11600569	印度电缆	—
11	87457	意大利电缆	—
12	11107881	日本电缆	—
13	11107880	泰国电缆、秘鲁电缆	—
14	88668	美国电缆	—
15	89728	南非电缆	—
16	30134389	显示操作终端 PRAT	包括: 防护罩
17	30125377	显示操作终端保护罩	终端应用 (PRAT, PRPT)
18	30416123	显示操作终端电缆	—

## 11.2.4 包装

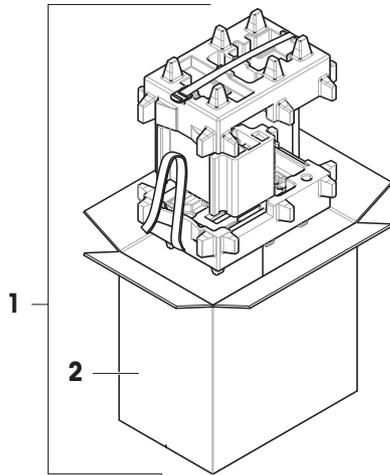

	订单号	指定	备注
1	30460297	打包	包括： 出口箱，内部保护材料
2	30460298	出口箱	不包括： 内部保护材料

## 12 附录

### 12.1 已审批天平

#### 12.1.1 定义

##### 已审批天平

已审批天平是指符合OIML R76中定义的"非自动称量仪器"当地法律要求的天平。对于已审批天平，净称量结果必须符合更高级别的控制。例如，已审批天平用于法定计量、基于重量的交易或法律应用中的质量测定。术语"已审批天平"包括符合计量标准（LFT）的天平、经认证的天平和经注册的天平。

这些天平的限制和特性会在本节以及本手册中的特定天平设置中进行说明。

要标识已审批天平，请将字符/M或/A附加至型号名称。

##### 实际分度值，**d**

该数值**d**表示"实际分度值"。根据OIML R76-1 [T.3.2.2]，它表示两个连续指示值之差。在某些国家，数值**d**定义为"分度值"或"分度值区间"。实际上，它通常称为"可读性"。

##### 检定分度值，**e**

该数值**e**表示"检定分度值"[OIML R76-1: T.3.2.3]。该数值用于仪器分类和检定。它表示仪器的绝对准确度，与市场监管相关。

检定分度值的最小值为1 mg。[OIML R76-1: 3.2]

#### 12.1.2 描述性标记

根据OIML R76-1 [7.1.4]，仪器的描述性标记位于型号标签上：

- **Min**: 最小称量
- **Max**: 最大称量（在本文中简称为"称量"）
- **e**: 检定分度值
- **d**: 实际分度值

产品铭牌还带有描述性标记，以及仪器的其他计量特性与限值。

#### 12.1.3 归零和去皮限制

##### 天平归零

- 开启天平时，执行初始化归零操作。如果在初始化归零操作期间，负载超过天平称量的20%，则无法归零，并且不显示称量值。[OIML R76-1: T.2.7.2.4和4.5.1]
- 在操作过程中，可执行归零操作的范围为天平称量的±2%。[OIML R76-1: 4.5.1]

##### 去皮

- 如果毛重为负值，则无法对天平去皮。[OIML R76-1: 4.6.4]

#### 12.1.4 出厂方法：General Weighing

所有天平出厂前都使用名为**General Weighing**的出厂方法。对于已审批天平：

- 无法删除出厂方法。
- 出厂方法**General Weighing**的单位设置为**g**且无法进行编辑。

- 开启天平时，不管关闭天平时运行的是哪种方法，称量屏幕上都会显示出厂方法。
- 对于出厂方法使用的公差配置文件，设置**显示器可读性**被设置为**1d**且无法进行编辑。

### 12.1.5 称量结果表示

已审批天平的称量结果表示遵循有关称量单位、重量值和砝码类型指示器的规则。这些规则将在以下段落中进行介绍。

#### 单位

- 提供有换算单位集供选择。
- 用户定义的单位（**定制单位**）仅限用于不会与其他标准单位混淆的字符。不允许采用以下数值（大写和小写字母）：
  - 所有常用单位、缩写或全称，如g、gram、kg、ct、oz等。
  - c、ca、car、cm、crt、cart、kt、gr、mgr、ugr、kgr、gra、mgra、ugra、kgra、grm、mgrm、ugrm、kgrm、mgram、ugram、kgram、k、kilo、to、tn、sh、tael、dram、dr、lboz、gramme、tonne、livre、once、lbt、cwt、dwt
  - 以字母"o"开头的所有常用单位，其中"o"替换为数字"0"，例如Oz、Ozi等。
  - 所有在末尾加上字母"s"的常用单位

#### 称量结果

如果实际分度值小于检定分度值（ $d < e$ ），则小于e的数字称为非检定数字。对于最多显示四位数字（ $d \geq 0.1$  mg）的天平，将标记非检定数字。例如，放置在 $e=1$  mg和 $d=0.1$  mg的天平上的100 mg砝码将打印为100.[0] mg。[OIML R76-1: 3.4.1, 3.4.2]

- 主称量屏幕上的主要重量值：非检定数字显示为灰色
- 主称量屏幕上的次要重量值（**信息重量**）：非检定数字显示为灰色
- **结果列表**，详细视图：非检定数字显示在括号内
- **Alibi内存**：非检定数字显示在括号内
- 打印结果：非检定数字显示在括号内
- 数据导出：无特殊标记

如果使用自定义单位，则不会标记非检定数字。

对重量值的描述不会影响称量结果的准确性。这符合法定计量要求。

#### 称量结果指示器

根据OIML R76-1 [T.5.2、T.5.3、4.6.5、4.6.11、4.7]标记称量结果的类型，例如**净重**、**皮重**或**毛重**。

指示器	称量主界面	结果列表	打印输出
净重	Net	净重	N
皮重	—	皮重	T
预置皮重	—	预置皮重	PT
毛重	—	毛重	G <sup>1</sup>
计算的质量	*	*	*
重量值不稳定	○	D	D

<sup>1</sup>如果打印输出仅包含毛重，则忽略指示器G。

## 打印输出示例

以下示例指的是 $e=1$  mg和 $d=0.1$  mg的天平。皮重或预设皮重值为200 mg，毛重为743.2 mg，净重为543.2 mg。

- 带手动去皮：

N	543.[2] mg
T	200.[0] mg
G	743.[2] mg

- 带预设皮重：

N	* 543.[2] mg
PT	200.0 mg
G	743.[2] mg

### 12.1.6 MT-SICS

以下命令不适用于已审批天平：

- **C0**
  - 无法更改校正类型。
- **TI**
  - 无法立即去皮。[OIML R76-1: 4.6.8]
- **ZI**
  - 无法立即归零。[OIML R76-1: 4.5.6]

### 12.1.7 参考文献

OIML R 76-1 Edition 2006 (E), Non-automatic weighing instruments, Part 1: Metrological and technical requirements – Tests



# 索引

## A

安全信息	10
安装	
泵	111
标准级	22
打印机	51, 52
ErgoSens	57
光栅板	27
RFID阅读器	55
安装	
开始操作	27
天平	26
终端	25

## B

包装	
天平	33
泵	
空容器	111, 112
压力	72
压力	72
装配	111
编辑	
方法	38

## C

测试砝码	41
测试	
校准套件	42, 45, 46
重复性	45
创建	42
灵敏度	46
准备	43
测试	19, 41
设置	101
拆开	
天平	22
产品铭牌	
概述	16

秤盘	
校准套件	43, 44, 45, 46, 50
称量辅助	
SmartTrac	17
称重屏幕	17
称量主界面	17
重复性测试	45
创建	42
重复性测试	
设置	101
重置	
密码	69
传感器	
光栅板	14, 27, 87
创建	
重复性测试	42
灵敏度测试	42
创建	
方法	36
用户组	67
用户	67
传输带	
RFID阅读器	55, 71, 87
存储	
天平	33

## D

打印机	51, 53, 87
安装	51, 52
测试	52, 54
删除	57
打印	
测试页	52, 54
结果	51, 52
待机	30
待机	15, 31
登录	28, 69
灯	
光栅板	14, 27, 87

StatusLight 状态指示灯	83	功能检查	29
电源		光学传感器	
查看交流/直流适配器	121	光栅板	14, 27, 87
disposal	125	归零	15, 32
<b>E</b>		<b>H</b>	
EasyScan		海拔	121
参见RFID阅读器	55	合规性信息	9
ErgoSens	57, 87	环境条件	22, 121
删除	57	<b>J</b>	
EULA	28	交流/直流适配器	121, 122
<b>F</b>		脚踏开关	87
方法	18	删除	57
防蒸发阱	14	校验砝码	41
安装	26	设置	100
排空	112	校准套件	45, 46, 50
填充	31	秤盘	43, 44
方法		功能检查	29
编辑	38	校正	19
创建	36	设置	107
克隆	39	加样头	
删除	39	编辑数据	71
型号	36	复制数据	71
执行	36	数据字段	71
标志		解锁	
警告	10	天平	70
符号	7	界面	
符合计量标准的天平		蓝牙	86
参见已审批天平	135	以太网	86
服务		警告标志	10
LabX	58, 88	经认证的天平	
MT-SICS	59, 88	参见已审批天平	135
web	61, 88	<b>K</b>	
<b>G</b>		开/关	28
概述		开/关	31
产品铭牌	16	克隆	
概览		方法	39
天平	13	<b>L</b>	
终端	15	LabX	58, 88

蓝牙		读取器	55, 71, 87
打印机	52, 87	智能芯片	55
蓝牙	86	容器	
LFT天平		安装	26
参见已审批天平	135	防蒸发阱	14, 112
亮度	83	排空	111
灵敏度测试	46	移液	13, 111
创建	42	软件	
灵敏度测试		版本	7
设置	104	<b>S</b>	
历史	73	删除	
<b>M</b>		RFID阅读器	57
门		设备	57
打开	14	删除	
打开	15	方法	39
密码		任务	39
重置	69	设备	
登录	28	编辑设置	57
新建用户	67	打印机	51, 53, 87
命令		ErgoSens	57, 87
MT-SICS	59, 88	光栅板	14, 27, 87
Web服务	61, 88	脚踏开关	87
MT-SICS	59, 88	删除	57
<b>N</b>		条形码阅读器	87
内部		外围设备	86
调整	49	设置	
<b>P</b>		一般称量	90
排空		盛水盘	14
泵	111	声音	
防蒸发阱	112	显示终端	83
移液容器	111	设置	
<b>Q</b>		测试	101
去皮	15, 32	重复性测试	101
<b>R</b>		校正	107
任务	39	灵敏度测试	104
RFID		湿度	121
标签	71	防蒸发阱	14
		时间	
		适应环境	28, 121

预热	28, 121
适应环境	
时间	28, 121
水平调节辅助装置	29, 73
水平调节脚	14
SmartTrac	17
StatusLight	15
StatusLight 状态指示灯	83

## T

填充	
防蒸发阱	31
天平信息	75
条形码阅读器	87
删除	57
调整	49
校准套件	50
内部	49
外部	49, 50

## U

USB	
参见设备	86
打印机	51, 87

## W

外部	
设备	86
调整	49, 50
Web服务	61, 88
位置	22
温度	121
升温时间	121
适应环境的时间:	121

## X

显示终端	
亮度	83
声音	83
StatusLight 状态指示灯	83

## Y

压力	
泵	72
压力	
泵	72
液位	
水平调节辅助装置	29, 73
水平调节脚	14
天平	29
指示灯	17
一般称量	
创建方法	37
设置	90
执行	38
溢出	
清洁	115
已审批天平	135
移液容器	13
安装	26
排空	111
以太网	86
用户	
创建	67
管理层	66
名称	28
删除	67
组	67
预热	
时间	28, 121
约定	7
运输	
长距离	33
短距离	33

## Z

智能芯片	55
执行方法	
一般称量	38
重量	
校验砝码	41

终端	15
安装	25
概览	15
装配	
泵	111
装配	
天平	26
注销	69
组合测试砝码	41
阻止	
天平	70





# GWP®

Good Weighing Practice™

---

GWP® 是全球称量标准，确保称量过程的一致性，可应用于任何制造商生产的称量设备。它有助于：

- 选择适当的天平或秤
- 安全地校准或操作称量设备
- 符合实验室和生产的质量及法规要求

 [www.mt.com/GWP](http://www.mt.com/GWP)

[www.mt.com/pipcal](http://www.mt.com/pipcal)

更多信息

**Mettler-Toledo GmbH**

Im Langacher 44  
8606 Greifensee, Switzerland  
[www.mt.com/contact](http://www.mt.com/contact)

保留技术修改权。

© 08/2022 METTLER TOLEDO. All rights reserved.

30419870C zh



30419870